



# DOCUMENTOS DA

**EMPRESA: STARKEY DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº  
04.216.059.0001/72.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO (SIGADOC) Nº SES-PRO-2023/00100.  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024/SES/MT.**

**OBJETO:** *“Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas para fornecimento de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) customizado (intra-auriculares, intracanalais, microcanais), AASI retroauriculares e Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM)”.*



247

JUCESP PROTOCOLO  
0.637.229/24-1

**ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA**  
**STARKEY DO BRASIL LTDA.**  
**CNPJ 04.216.059/0001-72**  
**NIRE 35.216.647.044**

**STARKEY LABORATORIES, INC.**, sociedade constituída segundo as leis do Estado de Minnesota, Estados Unidos da América do Norte, estabelecida em 6700 Washington Ave. South, doravante simplesmente denominada "Starkey", neste ato representada por seu procurador, **Sr. Marco Antonio Ferreira**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Campinas (SP), na Rua Olympio José Barreiros, nº 272, Cond. Luzern, Swiss Park, CEP 13049-469, portador da Cédula de Identidade - RG nº 21.499.499-49 SSP/SP e do CPF nº 171.111.111-8-46;

**AUDIBEL, INC.**, sociedade constituída segundo as leis do Estado de Minnesota, Estados Unidos da América do Norte, estabelecida em 6700 Washington Ave. South, simplesmente denominada "Audibel", neste ato representada por seu procurador, **Sr. Marco Antonio Ferreira**, acima qualificado;

únicos sócios da sociedade empresária limitada, **STARKEY DO BRASIL LTDA.**, com sede na Rua Fernão Pompeo de Camargo, nº 832, Jardim Leonor, CEP 13041-025, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 04.216.059/0001-72, com seu Contrato Social Constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o nº 35.216.647.044, em sessão de 30.11.2000, decidem proceder a Alterar do Contrato Social da sociedade como segue:

**“1. Os sócios ratificam o objeto constante na Cláusula 4ª, sendo:**

**Cláusula 4ª** – A sociedade tem por objeto:

- Prestação de serviço de Fonoaudiologia, treinamento para a utilização de prótese auditiva pelo deficiente auditivo, laboratório de assistência técnica com técnicos especializados, laboratório de transformação de insumos, bem como serviços de manutenção e adaptação de prótese auditiva.
- Comercialização, importação, exportação, fabricação de próteses auditivas, equipamentos audiológicos, aparelhos auditivos, correlatos e ou suas partes, peças e componentes, assim como importação de máquinas e equipamentos necessários ao reparo e manutenção desses produtos.

**Parágrafo único** - Para a consecução de seu objeto, a sociedade poderá constituir subsidiárias e participar do capital de outras empresas.”

**2.1.** Os sócios decidem ainda, incluir no objeto da filial localizada na cidade de **Campinas**, Estado de São Paulo, na Avenida Barão de Itapura, nº 1.236, CEP 13020-432, registrada sob NIRE nº 35903330872, CNPJ sob nº 04.216.059/0002-53, a atividade de prestação de serviço de fonoaudiologia.

**2.2** Assim, o Parágrafo único da Cláusula 2ª passa a ter a seguinte redação:

**“Cláusula 2ª** – A sociedade poderá abrir, manter e encerrar filiais, escritórios ou sucursais em qualquer parte do território nacional ou no exterior, e desde que, agregados à matriz, contribuam para que sejam atingidos os objetivos sociais, atribuindo-lhes, para fins legais, capital em separado, alocado daquele da matriz.

**Parágrafo único** – A sociedade possui as seguintes filiais:

Na cidade de **Campinas**, Estado de São Paulo, duas filiais, uma na Avenida Barão de Itapura, nº 1.236, CEP 13020-432, registrada sob NIRE nº 35903330872, CNPJ sob nº 04.216.059/0002-53, cujo objeto é o de comercialização de aparelhos auditivos, componentes, acessórios, prestação de serviço de reparos de aparelho auditivo, molde, tampão (pré moldagem de

orelha), e prestação de serviço de fonoaudiologia; e outra na Rua Argentina, nº 41, sala 08, Térreo, Jardim do Trevo, CEP 13040-017, cujo objeto é o de depósito de mercadorias próprias.”

3. Os sócios decidem ainda, consolidar o Contrato Social como segue:

## **CONTRATO SOCIAL DA STARKEY DO BRASIL LTDA.**

### **CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO**

**Cláusula 1ª** - A sociedade gira sob a denominação social de **STARKEY DO BRASIL LTDA.**, com sede e foro na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Fernão Pompeo de Camargo, nº 832, Jardim Leonor, CEP 13041-025, sendo uma sociedade empresária limitada, nos moldes do artigo 1.052 e seguintes do Novo Código Civil.

**Parágrafo único** - As sócias reconhecem que o nome **“Starkey”** é um ativo de importância, de propriedade da organização a que pertence a sócia Starkey, estando registrado em diversos países, inclusive no Brasil, como marca. Na hipótese da sócia Starkey ou qualquer de seus sucessores, desde que pertencente à mesma organização, deixar de ser titular de quotas representando 50% (cinquenta por cento), pelo menos, do capital da sociedade, este terá o direito de exigir a retirada do aludido nome da denominação social, salvo se de outra forma acordado entre as sócias.

**Cláusula 2ª** - A sociedade poderá abrir, manter e encerrar filiais, escritórios ou sucursais em qualquer parte do território nacional ou no exterior, e desde que, agregados à matriz, contribuam para que sejam atingidos os objetivos sociais, atribuindo-lhes, para fins legais, capital em separado, alocado daquele da matriz.

**Parágrafo único** - A sociedade possui as seguintes filiais:

Na cidade de **Campinas**, Estado de São Paulo, duas filiais, uma na Avenida Barão de Itapura, nº 1.236, CEP 13020-432, registrada sob NIRE nº 35903330872, CNPJ sob nº 04.216.059/0002-53, cujo objeto é o de comercialização de aparelhos auditivos, componentes, acessórios, prestação de serviço de reparos de aparelho auditivo, molde, tampão (pré moldagem de orelha), e prestação de serviço de fonoaudiologia; e outra na Rua Argentina, nº 41, sala 08, Térreo, Jardim do Trevo, CEP 13040-017, cujo objeto é o de depósito de mercadorias próprias.

**Cláusula 3ª** - A sociedade tem prazo indeterminado de duração.

## **CAPÍTULO II - OBJETO**

**Cláusula 4ª** - A sociedade tem por objeto:

- Prestação de serviço de Fonoaudiologia, treinamento para a utilização de prótese auditiva pelo deficiente auditivo, laboratório de assistência técnica com técnicos especializados, laboratório de transformação de insumos, bem como serviços de manutenção e adaptação de prótese auditiva.
- Comercialização, importação, exportação, fabricação de próteses auditivas, equipamentos audiológicos, aparelhos auditivos, correlatos e ou suas partes, peças e componentes, assim como importação de máquinas e equipamentos necessários ao reparo e manutenção desses produtos.

**Parágrafo único** - Para a consecução de seu objeto, a sociedade poderá constituir subsidiárias e participar do capital de outras empresas.

## **CAPÍTULO III - CAPITAL SOCIAL**

**Cláusula 5ª** - O capital social é de R\$ 1.808.358,00 (um milhão, oitocentos e oito mil e trezentos e cinquenta e oito reais), dividido em 1.808.358 (um milhão, oitocentas e oito mil e trezentas e cinquenta e oito) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

<b>SÓCIOS</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>VALOR - R\$</b>
STARKEY LABORATORIES, INC.	1.808.302	1.808.302,00
AUDIBEL, INC.	56	56,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.808.358</b>	<b>1.808.358,00</b>

**Parágrafo único** – As sócias declaram que a responsabilidade de cada uma é restrita ao valor de suas quotas, e solidariamente respondem pela integralização do capital social, em respeito às disposições contidas no artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10.01.2002.

#### **CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO**

**Cláusula 6ª** – A administração, gestão e representação da sociedade será exercida independentemente de caução, por prazo indeterminado, pela sócia Starkey, através de seu representante legal, que poderá representar a sociedade ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, usando da denominação social, podendo praticar todos os atos necessários ao regular funcionamento da sociedade. Ficando expresso que as sócias não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

**§1º** – Fica também autorizado a atribuição da administração da sociedade a pessoa não sócia, nos termos do artigo 1.061 da Lei 10.406 de 10.01.2002, neste ato designado como DIRETOR (não sócio) o **Sr. MARCO ANTONIO FERREIRA**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Campinas (SP), na Rua Fernandópolis, 135, Bairro Cidade Jardim, CEP 13050-422, portador da Cédula de Identidade – RG nº 21.338.949 SSP/SP e do CPF nº 171.918.288-46, por prazo indeterminado, independente de caução.

**§2º** – A sociedade somente se obriga:

- por ato ou assinatura da sócia Starkey através de seu representante legal; ou
- por ato ou assinatura do Diretor; ou

- por ato ou assinatura de um procurador, agindo isoladamente, respeitado sempre os poderes que lhe forem conferidos e estabelecidos pelos respectivos instrumentos de procuração.

**§3º** - As procurações outorgadas pela sociedade deverão ser sempre e exclusivamente assinadas pela sócia Starkey ou pelo Diretor não sócio, agindo isoladamente, devendo ser expressamente identificados os poderes outorgados e, com exceção daquelas com poderes "ad judícia", terão prazo de validade determinado.

**§4º** - Independente de prévia reunião deliberativa de sócias, as matérias elencadas abaixo, ficarão a cargo exclusivo da sócia majoritária Starkey, a saber:

- a-** a nomeação de procuradores com poderes para praticar os atos relacionados neste parágrafo quarto;
- b-** a outorga de fiança, aval ou garantia em negócios ou operações de terceiros, exceção feita aos negócios ou operações de suas subsidiárias ou coligadas, a constituição de subsidiárias, sua dissolução ou liquidação;
- c-** a aquisição, a alienação ou a oneração de qualquer participação societária, a votação das participações societárias detidas pela sociedade;
- d-** a celebração de qualquer acordo referente às participações societárias detidas pela sociedade;
- e-** a concessão ou a tomada de empréstimos em dinheiro, exceção feita a adiantamentos a fornecedores; bem como a abertura de conta corrente e/ou investimentos em qualquer instituição pública ou privada;
- f-** a aquisição, a alienação, o comodato ou a oneração de bens imóveis, a assinatura de contratos de locação de bens imóveis;
- g-** a celebração de qualquer contrato ou acordo envolvendo a transferência ou o recebimento de tecnologia ou o licenciamento de direitos de propriedade industrial;
- h-** a celebração de contratos bancários e de aquisição de bens para o ativo imobilizado cujo valor total seja superior ao equivalente a US\$ 100.000,00 (cem mil dólares norte americanos);

- i- a doação ou a contribuição a partidos e organizações políticas, quando permitida pela legislação vigente; e
- j- qualquer outro ato que venha a ser periodicamente determinado pelas sócias.

**§5º** - As deliberações das sócias, considerando que cada quota do capital social corresponderá a um voto, com relação às matérias elencadas no artigo 1.071 do Novo Código Civil, a seguir relacionadas, quando necessárias, serão tomadas em reunião de sócias, mediante prévia convocação, a ser realizada através de carta enviada pelo correio às sócias, mediante aviso de recebimento, com antecedência mínima de oito dias ou mediante carta encaminhada por meio eletrônico (e-mail), podendo, ainda, a convocação ser feita pessoalmente mediante contra-recibo, onde deverá constar na convocação a ordem do dia, hora, dia e local da reunião, dispensando qualquer publicação de anúncios. Ficando, ainda, dispensada a reunião, se todas as sócias decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto da mesma, nos moldes do disposto no artigo 1.072, parágrafo 3º, Lei 10.406/2002:

- a - a aprovação das contas da administração;
- b- a designação dos administradores quando feita em ato separado;
- c- a destituição dos administradores, o modo de sua remuneração, quando não estabelecido em contrato;
- d- a modificação do contrato social, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade ou a cessação do estado de liquidação;
- e- a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento de suas contas e o pedido de recuperação judicial;

**§6º** - A reunião das sócias será registrada em Livro de Atas de Reunião, que poderá ser lavrada em forma sumária, cuja cópia da ata de reunião será levada no prazo de 20 (vinte) dias a registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 1.075, parágrafo 2º, Lei 10.406/2002. Sendo que, no mínimo, uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social será realizada a reunião das sócias com o objetivo de tratar das matérias previstas no artigo 1.078 da Lei 10.406/2002, que será realizada

havendo um quorum mínimo de sócias presentes que detenham  $\frac{3}{4}$  do capital social, em primeira convocação, e em segunda convocação, com qualquer número.

**§7º** - Os administradores terão direito a uma retirada mensal a ser fixada de comum acordo entre as partes, dentro das possibilidades financeiras da sociedade, respeitando os limites e condições previstas pela legislação.

**§8º** - Por deliberação das sócias que representem mais da metade do capital social, poderá se decidir pela exclusão de sócia nos moldes do disposto no artigo 1.085 da Lei 10.406/2002, a ser determinada em reunião de sócias, e a ser especialmente convocada para este fim, dando ciência à sócia acusada, para que a mesma possa comparecer e apresentar o seu direito de defesa.

## **CAPÍTULO V - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS**

**Cláusula 7ª** - As quotas não poderão ser cedidas, alienadas ou transferidas, sem respeitar o direito de preferência das demais sócias e da sociedade, para adquirir as quotas da sócia cedente. Deverá a sócia cedente proceder com a necessária comunicação por escrito à sociedade e às demais sócias, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, tendo as sócias remanescentes em primeiro lugar preferência na aquisição, cabendo a sociedade o direito de preferência na aquisição de quotas, se as sócias remanescentes não o exercerem.

**§1º** - Caso a sociedade e as demais sócias não usem o seu direito de preferência que lhes é assegurado, deverão manifestar por escrito em um instrumento à parte ou no próprio instrumento da cessão a sua concordância quando da transferência das quotas pelo sócio à terceiro.

**§2º** - Considerar-se-á nula de pleno direito e não produzirá efeitos perante a sociedade e as demais sócias remanescentes, toda e qualquer alienação, cessão ou transferência realizada sem a observância desta cláusula.

## **CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS**

**Cláusula 8ª** - O exercício social inicia-se no dia 1º (primeiro) de janeiro e encerra-se no dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, data em que serão levantadas as demonstrações financeiras do exercício, com observância das prescrições legais, as quais deverão ser assinadas por um diretor e por um contador devidamente registrado perante os órgãos competentes. Cópia das demonstrações financeiras deverá ser distribuída às sócias no prazo de 3 (três) meses a contar do encerramento do exercício social.

**§1º** - Os resultados apurados ao final de cada exercício social deverão ter o destino que vier a ser determinado pelas sócias que representem a maioria do capital social. A distribuição de lucros, se houver, será feita às sócias na proporção de sua participação no capital social.

**§2º** - A sociedade, por deliberação das sócias que representem a maioria do capital social, poderá distribuir lucros à conta de lucros acumulados ou a conta de reserva de lucros existentes no mais recente balanço anual.

**§3º** - A sociedade, por deliberação das sócias que representem a maioria do capital social, poderá levantar balanços e distribuir lucros em períodos menores.

## **CAPÍTULO VII - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE**

**Cláusula 9ª** - A sociedade poderá entrar em liquidação por deliberação das sócias. Neste caso o liquidante será a sócia Starkey ou quem por esta vier a ser indicado. Os ativos da sociedade deverão ser divididos entre as sócias na proporção de sua participação no capital social.

**Parágrafo único** - No caso de exclusão de qualquer sócia, ou liquidação ou falência das sócias, a sociedade não se dissolverá, salvo se assim decidido pelas sócias remanescentes. A apuração e pagamento dos haveres da sócia

excluída, falecido, incapacitado, em liquidação ou falido seguirá as regras que serão estabelecidas pelas sócias remanescentes.

## **CAPÍTULO VIII - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**Cláusula 10ª** - As alterações que impliquem em modificação do contrato social, a incorporação, a fusão, a dissolução da sociedade, a cessação do estado de liquidação e a transformação da sociedade em outro tipo, dependem de deliberação das sócias que representem  $\frac{3}{4}$  do capital social. Sendo válido, para registro e demais efeitos legais, os instrumentos de alteração contratual subscritos pelas sócias respeitando o quorum de deliberações previstas no presente contrato e na legislação aplicável a espécie.

## **CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Cláusula 11ª** - Para todas as questões oriundas do presente contrato, fica eleito o foro da comarca de Campinas, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, o qual rege-se, em suas omissões e nos da Lei 10.406/02 (artigos 1.052 a 1.087 - Código Civil Brasileiro), de forma supletiva pela legislação das sociedades anônimas (Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações).

**Cláusula 12ª** - As sócias e/ ou administrador(es) declaram, sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenados ou encontrarem-se sob os efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, o qual será assinado eletronicamente, nos termos da Lei 14.063 de 23 de

setembro de 2020 e parágrafo 2º do artigo 1º da Medida Provisória 2.200-2/2001.

**Campinas, 05 de abril de 2024.**

**STARKEY LABORATORIES, INC.**  
p.p. Marco Antonio Ferreira

**AUDIBEL, INC.**  
p.p. Marco Antonio Ferreira





12 | Págs | 45 | Págs e | 10 | Códigos baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 30 de Abril de 2024, 09:07:33



Alteração do Contrato Social 05 04 2024 doc  
Código do documento b671afd0-b0c3-43fe-8977-d059c587f7fb



## Assinaturas



Marco Antonio Ferreira  
marco\_ferreira@starkey.com.br  
Assinou

*Marco Antonio Ferreira*

## Eventos do documento

### 15 Apr 2024, 09:28:39

Documento b671afd0-b0c3-43fe-8977-d059c587f7fb **criado** por ANA LUCIA SILVESTRE JULIANI (d6e6193e-9433-4d37-8aa5-88bec89a9104). Email: analucia.juliani@lemosadv.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-15T09:28:39-03:00

### 15 Apr 2024, 09:31:44

Assinaturas **iniciadas** por ANA LUCIA SILVESTRE JULIANI (d6e6193e-9433-4d37-8aa5-88bec89a9104). Email: analucia.juliani@lemosadv.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-15T09:31:44-03:00

### 30 Apr 2024, 09:05:18

MARCO ANTONIO FERREIRA **Assinou** (c24edbb5-bc81-458a-a3e8-2e2c2a1874a9) - Email: marco\_ferreira@starkey.com.br - IP: 200.182.232.196 (200.182.232.196 porta: 9954) - Geolocalização: -22.9217349 -47.0680438 - Documento de identificação informado: 171.918.288-46 - DATE\_ATOM: 2024-04-30T09:05:18-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):8579862f205ee7181db13d497be872c3c7d9af2156b4e2557d4ee7664c852f0e

(SHA512):89d694745fbd669a18d378633643736c3305c904e6bf923f1cc1ad3e780fd1a41d2f433dd09fd1a9c81374d7edf57245dc793b07b252c052baaab4f2933138db

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8210-7

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

34513966

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NAO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 21. [REDACTED] 49-6 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO 21/10/2014

NOME MARCO ANTONIO FERREIRA

FILIAÇÃO ALVANI ALVES FERREIRA  
NILVA MACHIAVELLI FERREIRA

NATURALIDADE CAMPINAS - SP DATA DE NASCIMENTO 10/01/1972

DOG ORIGEM CAMPINAS - SP TERCEIRO SUBDISTRITO CC:LV.B225/FLSº184/  
Nº36617

CPF 1719 [REDACTED] 8/46

Roberto Avlino  
Delegado de Polícia Divisão de Identificação TIRCD-SSP-SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 25

5º

CAMPINAS, 14 MAR 2023

Autentico a presente cópia reprográfica original a mim apresentada, de Ezequias Ferreira Neiva, Escrevente Autentico, em nome de [REDACTED].

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE





## PROCURAÇÃO

STARKEY DO BRASIL LTDA, sociedade com sede a Rua Fernão Pompeu de Camargo, 832, Jardim do Leonor – 13.041-025 – Campinas – S.P, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.216.059/0001-72, representada por seu Diretor **MARCO ANTONIO FERREIRA**, brasileiro, CPF 171.9[REDACTED]8.46 e RG. 21.[REDACTED]49 SSP/SP, com domicílio a Olympio José Barreiros, 272 – Swiss Park – Campinas – SP, pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui sua procuradora **TATIANA CAMILA DA ROSA TOBIAS**, brasileira, portadora do RG 29[REDACTED]6-8 SSP/SP e CPF 226.[REDACTED]28-93, a quem confere amplos poderes para representá-lo em órgãos públicos nas esferas federal, estadual e municipal, para credenciamento e licitações em qualquer de suas modalidades podendo para tanto, concordar em todos os seus termos, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de propostas e de documentos de habilitação, oferecer lances verbais, assinar ata, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, prestar declaração, assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

CLAUSULA ESPECIAL DE VALIDADE: A presente procuração terá validade até 30/06/2025.

  
  
**STARKEY DO BRASIL LTDA**  
**MARCO ANTONIO FERREIRA**  
**DIRETOR GERAL**



Starkey do Brasil Ltda - CNPJ 04.216.059/0001-72  
Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 832  
Jd. Leonor, Campinas/SP, 13041-025  
0800 772 0654

Pág. 1 / 1







# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**04.216.059/0001-72**  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
**30/11/2000**

NOME EMPRESARIAL  
**STARKEY DO BRASIL LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**STARKEY**

PORTE  
**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação**  
**33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente**  
**46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia**  
**47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos**  
**86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO  
**R FERNAO POMPEU DE CAMARGO**

NÚMERO  
**832**

COMPLEMENTO  
**\*\*\*\*\***

CEP  
**13.041-025**

BAIRRO/DISTRITO  
**JARDIM LEONOR**

MUNICÍPIO  
**CAMPINAS**

UF  
**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**LICITACAO@STARKEY.COM.BR**

TELEFONE  
**(19) 8195-3777**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
**\*\*\*\*\***

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**27/08/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
**\*\*\*\*\***

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
**\*\*\*\*\***

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/06/2024** às **10:03:59** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: STARKEY DO BRASIL LTDA**  
**CNPJ: 04.216.059/0001-72**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:31:13 do dia 05/03/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 01/09/2024.

Código de controle da certidão: **1122.3BD3.E7A0.056A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CND N° 0050353539**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **26/06/2024** Hora da emissão: **09:07:02**

Nome/denominação do sujeito passivo: **STARKEY DO BRASIL LTDA**

CNPJ: **04.216.059/0001-72**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidão válida até: **24/08/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2A22AU9277UU22AM**



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 04.216.059

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 58390176

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 25/06/2024 11:33:41

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.216.059/0001-72

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24060076685-10

Data e hora da emissão 03/06/2024 10:39:55

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# Prefeitura Municipal de Campinas

## Secretaria Municipal de Finanças

### CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

Razão Social: STARKEY DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.216.059/0001-72

A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, CERTIFICA, para fins de direito, que até a presente data a pessoa jurídica acima identificada não possui débitos exigíveis de qualquer origem tributária ou não tributária perante a Fazenda Pública Municipal, registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, relativos aos imóveis e inscrições mobiliárias vinculadas ao CNPJ supracitado.

Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos referentes aos itens abaixo:

1. De responsabilidade da pessoa jurídica, em virtude de processos de fusão, cisão, incorporação ou transformação;
2. Relativos a imóveis cujo cadastro não tenha sido atualizado junto à municipalidade, nos termos da legislação aplicável;
3. Relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, estando o contribuinte sob o regime do Simples Nacional, os quais devem ser verificados junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de exigir valores relativos a créditos tributários ou não tributários de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que porventura venham a ser lançados e/ou constituídos, e/ou a ele atribuídos em função de higienização cadastral, como contribuinte ou como responsável, nos termos da legislação aplicável, ainda que relativos a período abrangido por esta certidão.

A Secretaria Municipal de Finanças ressalta que a atualização cadastral junto aos Sistemas Informatizados da municipalidade, de imóveis e da própria pessoa jurídica, é de inteira responsabilidade do sujeito passivo, sujeitando-se às penalidades legais quando cabíveis, conforme legislação aplicável.

A Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza esta certidão via internet nos termos do Decreto nº 18.978 de 14 de janeiro de 2016 e das Instruções Normativas SMF nº 001/2011 de 04 de março de 2011 e SMF nº 08/2014 de 19 de Novembro de 2014, cuja autenticidade pode ser confirmada no endereço eletrônico: <https://certidoes-web.campinas.sp.gov.br>

#### DADOS DA CERTIDÃO

Data de emissão: 25/06/2024 - 11:24:40

Validade: 24/08/2024

Assinatura eletrônica: 000737.1204220.240625

Endereço IP: 200.182.232.196

Taxa de certidão: GRATUITA

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.216.059/0001-72  
**Razão Social:** STARKEY DO BRASIL LTDA  
**Endereço:** R DOUTOR FERNAO POMPEU DE CAMARGO 832 / JARDIM LEONOR / CAMPINAS / SP / 13041-025

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/06/2024 a 19/07/2024

**Certificação Número:** 2024062018490952271067

Informação obtida em 25/06/2024 11:20:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: STARKEY DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.216.059/0001-72

Certidão nº: 44742469/2024

Expedição: 25/06/2024, às 11:30:38

Validade: 22/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STARKEY DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.216.059/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



26/06/2024

0076720453

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 2130382**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 24/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**STARKEY DO BRASIL LTDA**, CNPJ: 04.216.059/0001-72, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 26 de junho de 2024.

PEDIDO Nº:

0076720453



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35216647044	CNPJ 04.216.059/0001-72	
NOME EMPRESARIAL STARKEY DO BRASIL LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 178
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EA.12.DE.C2.50.EA.BD.1E.12.E6.40.8F.9A.43.F4.2F.0F.81.93.E2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	069 [REDACTED] 80	DANIEL PERRONI: 06 [REDACTED] 45880	219663592902048377 794199655810549989 696329757022	13/06/2024 a 13/06/2027	Não
ADMINISTRADOR	1 [REDACTED] 846	MARCO ANTONIO FERREIRA: 1 [REDACTED] 846	386236965318217372 3	07/11/2023 a 06/11/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

EA.12.DE.C2.50.EA.BD.1E.12.E6.40.8  
F.9A.43.F4.2F.0F.81.93.E2-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 10:55:36

AC.AD.82.5F.86.08.7F.21  
20.7B.C6.63.26.E0.80.99

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	STARKEY DO BRASIL LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.216.059/0001-72
Número de Ordem do Livro:	178		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	STARKEY DO BRASIL LTDA.
NIRE	35216647044
CNPJ	04.216.059/0001-72
Número de Ordem	178
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Campinas
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/11/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	841474

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	STARKEY DO BRASIL LTDA.
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	178
Quantidade total de linhas do arquivo digital	841474
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.12.DE.C2.50.EA.BD.1E.12.E6.40.8F.9A.43.F4.2F.0F.81.93.E2-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: STARKEY DO BRASIL LTDA.  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.216.059/0001-72  
Número de Ordem do Livro: 178  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 41.805.138,83	R\$ 42.610.151,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 37.430.570,62	R\$ 39.039.694,13
DISPOBILIDADES		R\$ 1.804.200,28	R\$ 1.789.099,26
CLIENTES		R\$ 23.238.895,27	R\$ 24.499.557,94
ESTOQUE		R\$ 10.167.123,39	R\$ 10.492.718,64
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.119.757,78	R\$ 1.041.410,21
DESPESAS DO EXERCÍCI		R\$ 828.932,69	R\$ 851.196,52
OUTRAS CONTAS A RECE		R\$ 271.661,21	R\$ 365.711,56
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 52.915,50	R\$ 30.000,00
OUTROS ATIVOS DE LON		R\$ 52.915,50	R\$ 30.000,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 4.321.652,71	R\$ 3.540.457,39
IMOBILIZADO		R\$ 6.813.268,95	R\$ 6.839.857,29
DIREITO DE USO		R\$ 1.929.597,49	R\$ 1.929.597,49
(-) DEPRECIACAO ACUMULAD		R\$ (4.421.213,73)	R\$ (5.228.997,39)
PASSIVO		R\$ 41.805.138,83	R\$ 42.610.151,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 29.528.944,16	R\$ 30.277.250,15
FORNECEDORES		R\$ 24.393.059,56	R\$ 23.935.396,67
SALARIOS E ENCARGOS		R\$ 1.343.111,34	R\$ 1.161.648,49
IMPOSTOS E CONTRIBUI		R\$ 1.656.041,54	R\$ 1.918.951,05
PROVISAO PARA GARANT		R\$ 711.140,64	R\$ 772.543,22
ARRENDAMENTOS A PAGA		R\$ 418.492,79	R\$ 422.145,42
OUTRAS PROVISOES		R\$ 1.007.098,29	R\$ 2.066.565,30
PASSIVO NAO CIRCULAN		R\$ 8.198.876,96	R\$ 7.777.774,32
PROVISAO PARA CONTIN		R\$ 7.079.843,88	R\$ 7.079.843,88
ARRENDAMENTOS A PAGA		R\$ 1.119.033,08	R\$ 697.930,44
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.077.317,71	R\$ 4.555.127,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.808.358,00	R\$ 1.808.358,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.268.959,71	R\$ 2.746.769,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.12.DE.C2.50.EA.BD.1E.12.E6.40.8F.9A.43.F4.2F.0F.81.93.E2-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: STARKEY DO BRASIL LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.216.059/0001-72

Número de Ordem do Livro: 178

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
MERCADO INTERNO		R\$ 54.045.485,04	R\$ 62.035.683,24
(-) IMPOSTOS E DEMAIS DE		R\$ (5.061.588,60)	R\$ (4.722.237,22)
(=) RECEITA LIQUIDA		R\$ 48.983.896,44	R\$ 57.313.446,02
(-) (-) CUSTO DOS PRODUT		R\$ (24.381.156,83)	R\$ (31.439.999,64)
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 24.602.739,61	R\$ 25.873.446,38
(-) COM VENDAS		R\$ (12.118.812,65)	R\$ (14.064.409,19)
(-) GERAIS E ADMINISTRAT		R\$ (9.764.805,79)	R\$ (9.116.584,63)
LUCRO LIQUIDO OPERAC		R\$ 2.719.121,17	R\$ 2.692.452,56
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (438.172,64)	R\$ (492.575,76)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 153.522,47	R\$ 108.586,13
RECEITAS NAO OPERACI		R\$ (72.609,93)	R\$ 7.605,14
LUCRO ANTES DO IMPOS		R\$ 2.361.861,07	R\$ 2.316.068,07
(-) IMPOSTO DE RENDA E C		R\$ (1.638.692,83)	R\$ (1.838.258,73)
LUCRO LIQUIDO DO EXE		R\$ 723.168,24	R\$ 477.809,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.12.DE.C2.50.EA.BD.1E.12.E6.40.8F.9A.43.F4.2F.0F.81.93.E2-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

	CPF <b>069.888.3880</b>	RG <b>1756.888.888</b>	Diplomático <b>19/04/1997</b>
Título <b>BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS</b>			
Título Expedido por (ou Deed. Provisoriato) <b>FAC CIENC ECON ADMIN DE STO ANDRÉ</b>			

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.205 de 07/05/75

ASSINATURA DO CONTABILISTA

**POLEGAR - DIREITO**



**CARTeira DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO**

Nome <b>DANIEL PERRONI</b>	Nº DO REGISTRO <b>1SP154286/O-9</b>
Filiação <b>CARLOS AUGUSTO PERRONI</b>	Categoria <b>CONTADOR</b>
Nascimento <b>03/05/1957</b>	Nacionalidade <b>BRASILEIRA</b>
Expedição <b>07/04/2005</b>	Naturalidade <b>SANTO ANDRÉ - SP</b>

PRESIDENTE DO CRC

**Colégio Notarial**  
**COLEGIO DE NOTAS**  
**TIPOGRAFIA**  
**AUTENTICACAO**  
**AU-0188AH0301031**

**07 JAN 2019**

Autentico a presente cópia reprográfica conforme original a mim apresentado, do que dou fé  
Ludana Cristina Baldoni Lopes, Escrevente Autorizado  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

CÓPIA COLADA



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2024/043580**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME .....	DANIEL PERRONI
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....	1SP154286/O-9
CATEGORIA .....	CONTADOR
CPF .....	06[REDACTED].458-80

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 15/04/2024 às 08:20:15

Válido até: 14/07/2024

Código de Controle: 2849.9586.6225.0452

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



## COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

Cálculo dos índices a partir do Balanço 2023 apresentado, calculados pelas seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{AC+RLP}{PC+PNC} = \frac{39.069.694,13}{38.055.024,47} = 1,03$$

$$SG = \frac{AT}{PC+PNC} = \frac{42.610.151,52}{38.055.024,47} = 1,12$$

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{39.039.694,13}{30.277.250,15} = 1,29$$

onde:

AC = ATIVO CIRCULANTE

PC = PASSIVO CIRCULANTE

AT = ATIVO TOTAL

PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE

RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Campinas/SP, 26 de junho de 2024.

**STARKEY DO BRASIL LTDA**

Daniel Perroni

Controller - CRC 1SP154286/O-9

T: +55 19 3112 1220 | 3273 0023 R: 128

[daniel\\_perroni@starkey.com.br](mailto:daniel_perroni@starkey.com.br)

## ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atesto nos exatos termos e sob as penas da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que a empresa STARKEY DO BRASIL LTDA, CNPJ Nº 04.216.059/0001-72 estabelecida em Campinas/SP é fornecedora de Aparelhos Amplificação Sonora Individual – AASI a este ATESTANTE, desde 05/2010, tendo já fornecido cerca de 1.844,00 AASI no valor total de R\$ 1.138.911,00.

Até presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações.

Jundiaí – SP, 10 de Junho de 2015



NOME: Mariza Cavenagui Argentino Pomilio

CPF: 772.525.198-72

CARGO: Superintendente

TEL/CONTATO: 11 4523-4110

E-MAIL: [ateal@ateal.org.br](mailto:ateal@ateal.org.br)



CÓPIA COLORIDA

TABELÃO DE NOTAS DE JUNDIAÍ / SP  
Bel. José Fernandes da Silva - Tabelião  
Rua Onze de Junho, 142 - Centro - Jundiaí / SP - CEP: 13.201-125 - Fone: 4522-4200 - E-mail: [josefernandes@tabelao.com.br](mailto:josefernandes@tabelao.com.br)  
Reconhecido por SEMELHANÇA à firma de:  
MARIZA CAVENAGUI ARGENTINO POMILIO .....  
no documento sem valor econômico. Dou fé.  
Em teste munho de verdade.  
Jundiaí, 10/06/2015. Total: R\$ 4,83  
Por firme R\$ 4,83  
EVANILDO FERNANDES DA SILVA  
VALIDO



# HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA

CONDERG-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE  
GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

## ATESTADO DE QUALIFICACAO TECNICA

Por solicitação da parte interessada, atesto nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de QUALIFICACAO TECNICA, que a empresa STARKEY DO BRASIL LTDA, CNPJ n.º 04.216.059/0001-72, estabelecida na cidade de Campinas/SP, é fornecedora de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual-AASI a este ATESTANTE, desde (Outubro/2023), tendo já fornecido cerca de 308 unidades no valor total superior a R\$ 199.892,00 (cento e noventa e nove mil oitocentos e noventa e dois reais).

Até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações.

Divinolândia/SP, 07 de fevereiro de 2024.

Cristiane de Paiva Trevisan

Superintendente

CPF 276.███-███-96

E-mail: [superintendenteconderg@gmail.com](mailto:superintendenteconderg@gmail.com)

[52 356 268/0002-45]

Consórcio de Desenv. da Região  
de Governo de S. J. B Vista

Av. Leonor Mendes de Barros, 626

Centro - CEP 13.780-000

Divinolândia - SP



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III

### ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atesto nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que a Empresa STARKEY DO BRASIL LTDA, CNPJ N.º 04.216.059/0001-72 estabelecida em Campinas/SP é fornecedora de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual-AASI a este ATESTANTE, desde junho de 2007, tendo já fornecido cerca de 1.231 unidades no valor total superior a 800 mil Reais.

Até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações.

Maceió, 17 de julho de 2018.

*Janayna*  
Janayna Mara Silva Cajueiro  
Gerente Geral CER III UNCISAL  
Rua 44 501-7

Janayna Mara Silva Cajueiro  
Diretora Geral CER III  
CPF: 00842864407

Tel: 82 3315-8279 e 82 98833-8817  
Email: janacajueiro.uncisal@gmail.com



Rua Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra - CEP 57.010-300  
Maceió/AL.

<b>CERTIFICADO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA</b>			
DATA VALIDADE: 31/05/2025			
Razão Social BEEVOX SOLUCOES AUDITIVAS LTDA			
Representante Legal ODIL BENEDITO DOS SANTOS			
Nome Fantasia BEEVOX SOLUCOES AUDITIVAS			
Endereço RUA GAGO COUTINHO 350 SALA 02			
Bairro ARAES	CEP 78005730	Cidade CUIABA	UF MT
Horário de Funcionamento do Serviço de Fonoaudiologia 13:00 AS 17:00			
Registro no Conselho PJ-9277-6		CNPJ 17255334000109	
Responsável Técnico / CRFa No 13332 DEBORA PEREIRA LAPINSKI DOS SANTOS		Horário de 13:00 AS 17:00	

Certificamos que a Pessoa Juridica acima citada encontra-se regularmente inscrita junto ao Conselho Regional de Fonoaudiologia - 5a Região, nos Termos da Resolução CFFa de no 446 26/04/2014.

Declaração Digital - Código de Validação: 030560001233700022024  
Emitida eletronicamente via internet às 05/06/2024 de 17:00.  
Sua autenticidade poderá ser confirmada no site: [www.crefono5.org.br](http://www.crefono5.org.br)  
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



**ESTE CERTIFICADO DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL**

SEDE: Condomínio Absolut Business Style  
Avenida T-4, nº1478, Qd.169-A, Lt.1/2/17/18, Salas 61-A, Setor Bueno  
Cep: 74.230-030 / Goiânia – Goiás  
Fones: (62) 3293-6124 / 3233-3209 / 3233-3620 / 3233-3269  
[www.crefono5.org.br](http://www.crefono5.org.br) @crefono\_5

**CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA**  
**CARTÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**  
**VALE COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E TEM FÉ PÚBLICA**  
 Art. 1º da Lei nº 6.206 de 7 de maio de 1975

Nome  
**DEBORA PEREIRA LAPINSKI DOS SANTOS**



Inscrição 1ª  
 13332

Expedido em  
 21/03/2023

Validade  
 14/03/2025

Região  
 005 - Conselho Regional de Fonoaudiologia 5ª região

CPF  
 651.601-68

Região Geral - 1ª  
 80-5-0

Grupo Sanguíneo  
 B+

CRFa  
 5ª Região



Assinatura do Portador

**CÓPIA COLORIDA**

Filiação  
 Pai  
**GERALDO LAPINSKI**

Mãe  
**EVILDA PEREIRA LAPINSKI**

Nacionalidade  
**BRASILEIRA**

Naturalidade  
**NAVIRAÍ-MS**

Data de Nascimento  
**05/11/1972**




CHRISTIANE CASARDO FARIQUETE  
 PRESIDENTE DO CRFa 5ª REGIÃO



25597-05 GO

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO  
 IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ - CN - 06-3677  
 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 Av. Marechal Deodoro, 330, Bairro Santa Helena, Cuiabá, MT, CEP: 78015-015  
 Fone: (65) 3052-4232 - E-mail: contato@2oficiocuiaba.mt.gov.br

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico para os devidos efeitos que a presente fotocópia  
 é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.

CDT 45812 R\$4,05 Selo de Controle Digital

Cuiabá, MT, 26 de Junho de 2024

Em Tes: 

Miraci Leite de Almeida Nascimento  
 Escrevente Autorizada

Consulte [www.tnt.jus.br/seios](http://www.tnt.jus.br/seios)  
 Atendente: isabele Cruz




**EM  
 BRANCO**

# State of Minnesota - Secretary of State

This Certificate is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.

## Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. **Country (Pays): United States of America**

**This public document (Le présent acte public) Attested Copy**

2. **has been signed by (a été signé par) Adriane Elizabeth Heideman**

3. **acting in the capacity of (agissant en qualité de) Notary Public, State of Minnesota**

4. **bears the seal / stamp of (est revêtu du sceau / timbre de) Adriane Elizabeth Heideman, Notary Public, State of Minnesota**



Certified  
Attesté

5. **at (à) St. Paul, Minnesota**

6. **Date (Date) 12/14/2021**

7. **by (par) Secretary of State, State of Minnesota**

8. **File No (Sous nº) 1278314100054**

9. **Seal / Stamp (Sceau / Timbre):**

10. **Signature (Signature):**

Ezequias Ferreira Neiva  
Escrivente  
5º Tabelião de Notas de Campinas



*Steve Simon*

Steve Simon

Secretary of State  
State of Minnesota

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <https://apostille.sos.state.mn.us>.

This certificate does not constitute an Apostille under the Hague Convention of 5 October 1961, when it is presented in a country which is not a party to the convention. In such cases, the certificate should be presented to the consular section of the mission representing that country.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <https://apostille.sos.state.mn.us>. Ce certificat ne constitue pas une Apostille en vertu de la Convention de La Haye du 5 Octobre 1961, lorsque présenté dans un pays qui n'est pas partie à cette Convention. Dans ce cas, le certificat doit être présenté à la section consulaire de la mission qui représente ce pays.

Starkey

better. Live better.

6700 Washington Avenue S  
Eden Prairie, Minnesota 55344  
T: 1.800.328.8502

Starkey.com

Minnesota, 10 de Dezembro de 2021.

Starkey do Brasil Ltda  
Rua Fernão Pompeo de Camargo, 832 - Jardim Leonor  
Campinas - SP  
Brasil



Prezados Senhores,

Starkey Laboratories, Inc., fabrica aparelhos auditivos e produtos auditivos. A Starkey do Brasil está envolvida nas atividades de fabricação, adaptação e distribuição de aparelhos auditivos no Brasil. A Starkey Laboratories, Inc. autoriza a Starkey do Brasil Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 04.216.059/0001-72, a montar aparelhos auditivos Starkey personalizados e seguir os processos e materiais da Starkey Laboratories, e produzir, vender e distribuir aparelhos auditivos e produtos auditivos exclusivamente no Brasil com poderes para fornecer, distribuir e representantes em todos o Brasil. Isso inclui todos os modelos e marcas de aparelhos auditivos e produtos auditivos fabricados e distribuídos pela Starkey Laboratories, Inc., bem como os serviços e a distribuição ou a importação de acessórios e peças de reposição de aparelhos auditivos e produtos auditivos de qualquer marca distribuídas pela Starkey Laboratories, Inc.

Afirmamos também que possuímos os conhecimentos e aplicamos os requisitos de boas práticas de fabricação para a produção de produtos relacionados com a saúde, tal como estabelecido na resolução do Conselho de Vigilância em Saúde Agência Nacional - RDC 16, de 28 de Março de 2013.

Todos os aparelhos auditivos e produtos auditivos fornecidos pela Starkey Laboratories, Inc. atendem aos padrões e exigências do Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos.

Respeitosamente,

Starkey Laboratories, Inc.  
Brandon L. Sawalich  
Presidente e CEO

Esta autorização tem validade até Dezembro 2025.



Ezequias Ferreira Neiva  
Escrivente  
5º Tabelião de Notas de Campinas



## NOTARIAL CERTIFICATION

Minnesota

City of Hennepin

I, Adriane Elizabeth Heideman, Notary Public, duly authorized, admitted, and enrolled, commissioned in the State of Minnesota, U.S.A.

DO HEREBY CERTIFY on the basis of inspection of the documents of the company, Starkey Laboratories, Inc., that the following is a true and accurate copy of the original:

➤ CARTA DE EXCLUSIVIDADE

IN WITNESS WHEREOF, I have set my hand and affixed my Seal this 10<sup>th</sup> day of December, 2021.

(Notarial Seal)



A handwritten signature in cursive script, reading "Adriane E. Heideman", written over a horizontal line.

(Signature of Notary Public)

Title: Executive Assistant

My commission expires: January 31<sup>st</sup>, 2025

(Apostille in accordance with the Hague Convention of the 5<sup>th</sup> of October 1961)

Ezequias Ferreira Neiva  
Escrivente  
5º Tabelião de Notas de Campinas



# State of Minnesota - Secretary of State

This Certificate is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.

## Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country (Pays): **United States of America**

This public document (Le présent acte public) **Attested Copy**

2. has been signed by (a été signé par) **Adriane Elizabeth Heideman**

3. acting in the capacity of (agissant en qualité de) **Notary Public, State of Minnesota**

4. bears the seal / stamp of (est revêtu du sceau / timbre de)  
**Adriane Elizabeth Heideman, Notary Public, State of Minnesota**

Certified  
Atteste

5. at (à) **St. Paul, Minnesota**

6. Date (Date) **12/14/2021**

7. by (par) **Secretary of State, State of Minnesota**

8. File No (Sous n°) **1278314100041**

9. Seal / Stamp (Sceau / Timbre):

10. Signature (Signature):



*Steve Simon*

Steve Simon  
Secretary of State  
State of Minnesota



This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <https://apostille.sos.state.mn.us>.

This certificate does not constitute an Apostille under the Hague Convention of 5 October 1961, when it is presented in a country which is not a party to the convention. In such cases, the certificate should be presented to the consular section of the mission representing that country.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <https://apostille.sos.state.mn.us>. Ce certificat ne constitue pas une Apostille en vertu de la Convention de La Haye du 5 Octobre 1961, lorsque présenté dans un pays qui n'est pas partie à cette Convention. Dans ce cas, le certificat doit être présenté à la section consulaire de la mission qui représente ce pays.

Starkey

6700 Washington Avenue S  
Eden Prairie, Minnesota 55344  
T: 1.800.328.8602

Starkey.com

Live better. Live better.

Minnesota, December 10, 2021  
Starkey do Brasil Ltda  
Rua Fernão Pompeo de Camargo, 832 - Jardim Leonor  
Campinas - SP  
Brazil



Dear Sirs,

Starkey Laboratories, Inc., manufactures hearing aids and hearing instruments. Starkey of Brazil is involved in the activities of manufacturing, adapt, and distribute hearing aids and hearing instruments in Brazil.

Starkey Laboratories, Inc., hereby authorizes Starkey of Brasil Ltda, CNPJ under number 04.216.059/0001-72, to assemble Starkey designed hearing aids and hearing instruments following Starkey Laboratories, Inc. processes and materials and produce, sell and distribute hearing aids and hearing instruments exclusively in Brazil with powers to provide distributors and representatives throughout Brazil.

This also includes all models and brands of appliances hearing instruments manufactured and distributed by Starkey Laboratories, Inc., as well as the service and the distribution or importation of accessories and spare parts hearing aids and hearing instruments of any brand distributed by Starkey Laboratories, Inc. we also affirm that we possess the knowledge and apply the requirements of good manufacturing practices for the production of health-related products as set out in the resolution of the Board of the National Agency Health Surveillance - RDC 16 of March 28<sup>th</sup>, 2013.

All hearing aids and hearing instruments supplied by Starkey Laboratories, Inc, meets the FDA standards and requirements.

Your Sincerely,

Starkey Laboratories, Inc.  
Brandon L. Sawalich  
President and CEO

This authorization is valid until December 31<sup>st</sup>, 2025.



# NOTARIAL CERTIFICATION

State of Minnesota  
County of Hennepin


I, Adriane Elizabeth Heideman, Notary Public, duly authorized, admitted, and enrolled, commissioned in the State of Minnesota, U.S.A.

DO HEREBY CERTIFY on the basis of inspection of the documents of the company, Starkey Laboratories, Inc., that the following is a true and accurate copy of the original:

## ➤ CARTA DE EXCLUSIVIDADE

IN WITNESS WHEREOF, I have set my hand and affixed my Seal this 10<sup>th</sup> day of December, 2021.

(Notarial Seal)

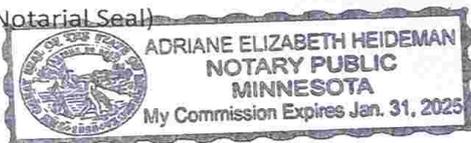

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Adriane E. Heideman", written over a horizontal line.

(Signature of Notary Public)

Title: Executive Assistant

My commission expires: January 31<sup>st</sup>, 2025

(Apostille in accordance with the Hague Convention of the 5<sup>th</sup> of October 1961)





Sistema Estadual de Vigilância Sanitária  
Prefeitura Municipal de CAMPINAS

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 350950240-466-000011-1-2

DATA DE VALIDADE: 27/11/2024

Nº PROCESSO: 11/70/04918 PS  
Nº PROTOCOLO: PMC.2023.00060676-57 DATA DO PROTOCOLO: 20/06/2023  
SUBGRUPO: DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA  
AGRUPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE  
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4664-8/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTE E PEÇAS  
OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL: STARKEY DO BRASIL LTDA CNPJ ALBERGANTE:  
NOME FANTASIA: STARKEY  
CNPJ / CPF: 04.216.059/0001-72  
LOGRADOURO: Rua FERNÃO POMPEU DE CAMARGO NÚMERO: 832  
COMPLEMENTO:  
BAIRRO: JARDIM LEONOR  
MUNICÍPIO: CAMPINAS  
CEP: 13041-025 UF: SP  
PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: MARCO ANTONIO FERREIRA

CPF: 1 [REDACTED] 846

Nº INSCR. CONSELHO PROF: 00000

CONSELHO REGIONAL: N/A

UF: SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PRISCILA APARECIDA SOLERA

CPF: 1 [REDACTED] 850

Nº INSCR. CONSELHO PROF: 11288

CONSELHO REGIONAL: CRFA

UF: SP

# LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: 350950240-466-000011-1-2

DATA DE VALIDADE: 27/11/2024

## CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

### CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

EMBALAR

EXPEDIR

EXPORTAR

IMPORTAR

### CATEGORIA:

ACESSÓRIOS

APARELHOS

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CAMPINAS

CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRIR-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS.

ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

CAMPINAS

LOCAL

27/11/2023

DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1701185081895

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: <https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/>

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES.  
 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024/SES/MT.  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGADOC Nº SES-PRO-2023/00100

<b>DADOS DA LICITANTE</b>	<b>STARKEY DO BRASIL LTDA</b> CNPJ: 04.216059/0001-72 - IE.: 244.882.385.111 - IM: 69026-0 Rua Fernão Pompeu de Camargo, 832 - Jardim Leonor – Campinas/SP – CEP 13041-025 Fone: (19) 3273-0023 - e-mail: <a href="mailto:licitacao@starkey.com.br">licitacao@starkey.com.br</a>
---------------------------	---

**PROPOSTA COMERCIAL**

ITEM	CÓDIGO SIAG	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN	QTD/ ANUAL	VALOR TABELA SUS (UNITÁRIO)	VALOR TABELA SUS (TOTAL)
01	1114334	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO INTRA-CANAL TIPO A - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030062 Marca: <b>NUEAR</b> Modelo: <b>SAVANT AI 1000 CIC 312</b>	UN	81	R\$ 525,00	42.525,00
02	1114335	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO INTRA-CANAL TIPO B - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030070 Marca: <b>NUEAR</b> Modelo: <b>SAVANT AI 1200 CIC 312</b>	UN	57	R\$ 700,00	39.900,00
03	1114336	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO INTRA-CANAL DO TIPOC - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030089 Marca: <b>NUEAR</b> Modelo: <b>SAVANT AI 1600 CIC 312</b>	UN	25	R\$ 1.100,00	27.500,00
04	1114337	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO MICROCANAL TIPO A - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030097 Marca: <b>NUEAR</b> Modelo: <b>SAVANT AI 1000 CIC 10</b>	UN	95	R\$ 525,00	49.875,00
05	1114338	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO MICROCANAL TIPO B - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030100 Marca: <b>NUEAR</b> Modelo: <b>SAVANT AI 1200 CIC 10</b>	UN	66	R\$ 700,00	46.200,00
06	1114339	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO MICROCANAL TIPO C - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030119	UN	29	R\$ 1.100,00	31.900,00

		Marca: <b>NUEAR</b> Modelo: <b>SAVANT AI 1600 CIC 10</b>				
07	1114340	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO A - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030127  Marca: <b>NUEAR</b> Modelos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SAVANT AI 1000 BTE</b></li> <li>• <b>SAVANT AI 1000 POWER PLUS</b></li> <li>• <b>SAVANT AI 1000 RIC</b></li> </ul>	UN	1.183	R\$ 525,00	621.075,00
08	1114341	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO B - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030135  Marca: <b>NUEAR</b> Modelos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SAVANT AI 1200 BTE</b></li> <li>• <b>SAVANT AI 1200 POWER PLUS</b></li> <li>• <b>SAVANT AI 1200 RIC</b></li> </ul>	UN	828	R\$ 700,00	579.600,00
09	1114342	APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO RETRO AURICULAR TIPO C - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030143  Marca: <b>NUEAR</b> Modelos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SAVANT AI 1600 BTE</b></li> <li>• <b>SAVANT AI 1600 POWER PLUS</b></li> <li>• <b>SAVANT AI 1600 RIC</b></li> <li>• <b>SAVANT AI CROS BTE</b></li> </ul>	UN	355	R\$ 1.100,00	390.500,00
10	1114350	REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO INTRACANAL TIPO A - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030216	UN	14	R\$ 525,00	7.350,00
11	1114351	REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO INTRACANAL TIPO B - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030224	UN	10	R\$ 700,00	7.000,00
12	1114352	REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO INTRACANAL TIPO C - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030232	UN	05	R\$ 1.100,00	5.500,00
13	1114353	REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO MICROCANAL TIPO A - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030240	UN	17	R\$ 525,00	8.925,00
14	1114354	REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO MICRO CANAL TIPO B - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030259	UN	12	R\$ 700,00	8.400,00
15	1114355	REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO MICRO CANAL TIPO C - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030267	UN	05	R\$ 1.100,00	5.500,00

16	1114356	REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO A - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030275	UN	209	R\$ 525,00	109.725,00
17	1114357	REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO B - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030283	UN	146	R\$ 700,00	102.200,00
18	1114358	REPOSIÇÃO DE AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO C - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030291	UN	63	R\$ 1.100,00	69.300,00
19	1114359	SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULADA PESSOAL (FM) - PROCEDIMENTO SIGTAP 0701030321	UN	30	<b>NÃO COTADO</b>	<b>NÃO COTADO</b>
<b>TOTAL GERAL DE APARELHOS AUDITIVOS: 3.200 UNIDADES</b>					<b>2.152.975,00</b>	

Campinas, 09 de julho de 2024.

TATIANA CAMILA DA ROSA  
TOBIAS:22[REDACTED]2893

Assinado de forma digital por TATIANA  
CAMILA DA ROSA  
TOBIAS:6402893  
Dados: 2024.07.09 14:23:17 -03'00'

**Assinatura do representante legal da pessoa jurídica**

Nome: Tatiana Camila da Rosa Tobias  
RG 29.8[REDACTED]6-8 e CPF: 226.[REDACTED]28-93

## ANEXO IV –DECLARAÇÕES

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024/SES/MT.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGADOC Nº SES-PRO-2023/00100

Starkey do Brasil Ltda, CNPJ Nº. 04.216.059/0001-72, sediada na Rua Fernão Pompeu de Camargo, nº 832, bairro Jardim Leonor, CEP 13041-025, Campinas/SP, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da presente licitação, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

- o material a ser fornecido não é reutilizado.
- fornecerá o AASI, cuja potência esteja compatível com o tipo e grau da perda auditiva de cada usuário, identificado na audiometria ou exames similares e indicados pelo CER III/CRIDAC, acompanhados de 03 (três) pilhas por unidade; 01 (um) kit de protetor de cerúmen e 01 (um) kit de limpeza por unidade de AASI intra; 01 (um) desumidificador para cada par de AASI fornecido e 01 (um) kit Infante-Juvenil para cada usuário com idade até 16 anos;
- a garantia do material fornecido será por um período será de 01 (um) ano, inclusive das cápsulas de AASI intra, contados a partir da concessão do AASI para o paciente;
- apresentará, anexa, declaração contendo a relação de cada aparelho a ser credenciado, com suas respectivas marcas e especificações, valor conforme tabela SAS/SUS, acompanhada do registro do produto ou certificado de isenção fornecido pelo Ministério da Saúde através de seu órgão competente e do manual ou prospecto contendo todas as especificações dos AASI a serem credenciados, obrigatoriamente, em idioma português, acompanhado das amostras devidamente identificadas com o nome do representante, item credenciado e tipo de aparelho;
- as amostras cedidas para a análise da equipe técnica do CER III/CRIDAC corresponderão exatamente, ao material que será fornecido para o usuário, e que está ciente que as referidas amostras ficarão retidas como parâmetro de avaliação do produto ofertado durante todo o período do credenciamento;
- não possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos executando trabalho no período noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos (Art. 68, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021);
- não possui em seu quadro de pessoal, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pelo chamamento público;
- inexistente superveniência de fato impeditivo de habilitação, que não foi declarado inidôneo e nem está impedido em nenhum órgão público federal, estadual e/ou municipal, assinada por seu representante legal, nos termos do art. 65 da Lei 14.133/2021 c/c art. 137 do Decreto nº 1.525/2022;
- não se encontra apenas com suspensão ou impedimento de contratar com a Administração, nos termos do inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93, nem declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do mesmo dispositivo legal, bem como que irá

---

**Starkey do Brasil Ltda - CNPJ 04.216.059/0001-72**

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 832

Jd. Leonor, Campinas/SP, 13041-025

0800 772 0654

comunicar qualquer fato ou evento superveniente que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.

Campinas, 09 de julho de 2024.

TATIANA CAMILA DA ROSA  
TOBIAS:22[REDACTED]402893

Assinado de forma digital por  
TATIANA CAMILA DA ROSA  
TOBIAS:2[REDACTED]402893  
Dados: 2024.07.09 14:24:59 -03'00'

**Assinatura do representante legal da pessoa jurídica**

Nome: Tatiana Camila da Rosa Tobias

RG 29.[REDACTED]266-8 e CPF: 226.[REDACTED]28-93

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	STARKEY DO BRASIL LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04.216.059/0001-72
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.01.791-5
Nome do Dispositivo Médico	Aparelho Digital para Surdez Intra Auricular (ITE) e Intra Canal (ITC)
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Aparelho Auditivo
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80179159001
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351042711202054
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: STARKEY LABORATORIES, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Endereço: 1 , FABRICANTE: STARKEY MÉXICO, S.A. DE C.V. - MÉXICO
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	08/10/2020
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL - Custom R Opman Microtech.pdf	2392248222 - 13/04/2022 12:04:09
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL - Custom R Opman Starkey.pdf	2392248222 - 13/04/2022 12:04:09
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL - Custom R Opman Nuear.pdf	2392248222 - 13/04/2022 12:04:08

Modelo Produto Médico
Circa AI 1000 ITC R
Circa AI 1000 ITE R
Circa AI 1200 ITC R
Circa AI 1200 ITE R
Circa AI 1600 ITC R
Circa AI 1600 ITE R
Circa AI 2000 ITC R
Circa AI 2000 ITE R
Circa AI 2400 ITC R

Circa AI 2400 ITE R
Circa Edge AI 1000 ITC R
Circa Edge AI 1000 ITE R
Circa Edge AI 1200 ITC R
Circa Edge AI 1200 ITE R
Circa Edge AI 1600 ITC R
Circa Edge AI 1600 ITE R
Circa Edge AI 2000 ITC R
Circa Edge AI 2000 ITE R
Circa Edge AI 2400 ITC R
Circa Edge AI 2400 ITE R
Circa 1000 ITC R
Circa 1000 ITE R
Circa 1200 ITC R
Circa 1200 ITE R
Circa 1600 ITC R
Circa 1600 ITE R
Circa 2000 ITC R
Circa 2000 ITE R
Circa 2400 ITC R
Circa 2400 ITE R
Envy AI 1000 CIC
Envy AI 1000 IIC
Envy AI 1000 ITC R
Envy AI 1000 ITE R
Envy AI 1000 Wireless CIC
Envy AI 1200 CIC
Envy AI 1200 IIC
Envy AI 1200 ITC R
Envy AI 1200 ITE R
Envy AI 1200 Wireless CIC
Envy AI 1600 CIC
Envy AI 1600 IIC
Envy AI 1600 ITC R
Envy AI 1600 ITE R
Envy AI 1600 Wireless CIC
Envy AI 2000 CIC
Envy AI 2000 IIC

Envy AI 2000 ITC R
Envy AI 2000 ITE R
Envy AI 2000 Wireless CIC
Envy AI 2400 CIC
Envy AI 2400 IIC
Envy AI 2400 ITC R
Envy AI 2400 ITE R
Envy AI 2400 Wireless CIC
Esentia AI 1000 ITC R
Esentia AI 1000 ITE R
Esentia AI 1200 ITC R
Esentia AI 1200 ITE R
Esentia AI 1600 ITC R
Esentia AI 1600 ITE R
Esentia AI 2000 ITC R
Esentia AI 2000 ITE R
Esentia AI 2400 ITC R
Esentia AI 2400 ITE R
Esentia Edge AI 1000 ITC R.
Esentia Edge AI 1000 ITE R
Esentia Edge AI 1200 ITC R
Esentia Edge AI 1200 ITE R
Esentia Edge AI 1600 ITC R
Esentia Edge AI 1600 ITE R
Esentia Edge AI 2000 ITC R
Esentia Edge AI 2000 ITE R
Esentia Edge AI 2400 ITC R
Esentia Edge AI 2400 ITE R
Esentia 1000 ITC R
Esentia 1000 ITE R
Esentia 1200 ITC R
Esentia 1200 ITE R
Esentia 1600 ITC R
Esentia 1600 ITE R
Esentia 2000 ITC R
Esentia 2000 ITE R
Esentia 2400 ITC R
Esentia 2400 ITE R

Evolv AI 1000 CIC
Evolv AI 1000 IIC
Evolv AI 1000 ITC R
Evolv AI 1000 ITE R
Evolv AI 1000 Wireless CIC
Evolv AI 1200 CIC
Evolv AI 1200 IIC
Evolv AI 1200 ITC R
Evolv AI 1200 ITE R
Evolv AI 1200 Wireless CIC
Evolv AI 1600 CIC
Evolv AI 1600 IIC
Evolv AI 1600 ITC R
Evolv AI 1600 ITE R
Evolv AI 1600 Wireless CIC
Evolv AI 2000 CIC
Evolv AI 2000 IIC
Evolv AI 2000 ITC R
Evolv AI 2000 ITE R
Evolv AI 2000 Wireless CIC
Evolv AI 2400 CIC
Evolv AI 2400 IIC
Evolv AI 2400 ITC R
Evolv AI 2400 ITE R
Evolv AI 2400 Wireless CIC
Livio AI 1000 ITC R
Livio AI 1000 ITE R
Livio AI 1200 ITC R
Livio AI 1200 ITE R
Livio AI 1600 ITC R
Livio AI 1600 ITE R
Livio AI 2000 ITC R
Livio AI 2000 ITE R
Livio AI 2400 ITC R
Livio AI 2400 ITE R
Livio Edge AI 1000 ITC R
Livio Edge AI 1000 ITE R
Livio Edge AI 1200 ITC R

Livio Edge AI 1200 ITE R
Livio Edge AI 1600 ITC R
Livio Edge AI 1600 ITE R
Livio Edge AI 2000 ITC R
Livio Edge AI 2000 ITE R
Livio Edge AI 2400 ITC R
Livio Edge AI 2400 ITE R
Livio 1000 ITC R
Livio 1000 ITE R
Livio 1200 ITC R
Livio 1200 ITE R
Livio 1600 ITC R
Livio 1600 ITE R
Livio 2000 ITC R
Livio 2000 ITE R
Livio 2400 ITC R
Livio 2400 ITE R
<b>Savant AI 1000 CIC</b>
Savant AI 1000 IIC
Savant AI 1000 ITC R
Savant AI 1000 ITE R
<b>Savant AI 1000 Wireless CIC</b>
<b>Savant AI 1200 CIC</b>
Savant AI 1200 IIC
Savant AI 1200 ITC R
Savant AI 1200 ITE R
<b>Savant AI 1200 Wireless CIC</b>
<b>Savant AI 1600 CIC</b>
Savant AI 1600 IIC
Savant AI 1600 ITC R
Savant AI 1600 ITE R
<b>Savant AI 1600 Wireless CIC</b>
Savant AI 2000 CIC
Savant AI 2000 IIC
Savant AI 2000 ITC R
Savant AI 2000 ITE R
Savant AI 2000 Wireless CIC
Savant AI 2400 CIC

Savant AI 2400 IIC
Savant AI 2400 ITC R
Savant AI 2400 ITE R
Savant AI 2400 Wireless CIC

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	STARKEY DO BRASIL LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04.216.059/0001-72
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.01.791-5
Nome do Dispositivo Médico	Aparelhos Auditivos Retroauriculares (BTEs)
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Aparelho Auditivo
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80179150079
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351325522201981
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: STARKEY DO BRASIL LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 04216059000172 - Endereço: RUA FERNÃO POMPEU DE CAMARGO Nº 832 JARDIM LEONOR 13041025
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	12/08/2019
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-07-EE-XX - BTE - Power Plus BTE Opman - Starkey.pdf	2393756221 - 13/04/2022 12:22:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3028-01-EE-XX - Smartphone Compatible and Universal Connectivity BTE R (1).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3028-01-EE-XX - Smartphone Compatible and Universal Connectivity BTE R (2).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3028-01-EE-XX - Smartphone Compatible and Universal Connectivity BTE R (3).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:33
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-05-EE-XX - Smartphone Compatible & Universal Connectivity BTE (1).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:32
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-05-EE-XX - Smartphone Compatible & Universal Connectivity BTE (2).PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:32
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-05-EE-XX - Smartphone Compatible & Universal Connectivity BTE.PDF	2393756221 - 13/04/2022 12:22:32
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3004-07-EE-XX - BTE - Power Plus BTE Opman - MicroTech.pdf	2393756221 - 13/04/2022 12:22:32

## Modelo Produto Médico

Circa AI Cros BTE R
Circa Ai Cros BTE
Circa AI 1000 BTE
Circa AI 1000 BTE R
Circa AI 1200 BTE
Circa AI 1200 BTE R
Circa AI 1600 BTE
Circa AI 1600 BTE R
Circa AI 2000 BTE
Circa AI 2000 BTE R
Circa Ai 2400 BTE
Circa AI 2400 BTE R
Circa Cros BTE
Circa Cros BTE R
Circa Edge AI Cros BTE
Circa Edge AI Cros BTE R
Circa Edge AI 1000 BTE
Circa Edge AI 1000 BTE R
Circa Edge AI 1200 BTE
Circa Edge AI 1200 BTE R
Circa Edge AI 1600 BTE
Circa Edge AI 1600 BTE R
Circa Edge AI 2000 BTE
Circa Edge AI 2000 BTE R
Circa Edge AI 2400 BTE
Circa Edge AI 2400 BTE R
Circa 1000 BTE
Circa 1000 BTE R
Circa 1000a BTE
Circa 1200 BTE
Circa 1200 BTE R
Circa 1600 BTE
Circa 1600 BTE R
Circa 2000 BTE
Circa 2000 BTE R
Circa 2400 BTE
Circa 2400 BTE R
Envy AI Cros BTE

Envy AI Cros BTE R
Envy AI Cros Power Plus BTE
Envy AI 1000 BTE
Envy AI 1000 BTE R
Envy AI 1000 Power Plus BTE
Envy AI 1200 BTE
Envy AI 1200 BTE R
Envy AI 1200 Power Plus BTE
Envy AI 1600 BTE
Envy AI 1600 BTE R
Envy AI 1600 Power Plus BTE
Envy AI 2000 BTE
Envy AI 2000 BTE R
Envy AI 2000 Power Plus BTE
Envy AI 2400 BTE
Envy AI 2400 BTE R
Envy AI 2400 Power Plus BTE
Esentia Ai Cros BTE
Esentia AI Cros BTE R
Esentia AI 1000 BTE
Esentia AI 1000 BTE R
Esentia AI 1200 BTE
Esentia AI 1200 BTE R
Esentia AI 1600 BTE
Esentia AI 1600 BTE R
Esentia AI 2000 BTE
Esentia AI 2000 BTE R
Esentia Ai 2400 BTE
Esentia AI 2400 BTE R
Esentia Cros BTE
Esentia Cros BTE R
Esentia Edge AI Cros BTE
Esentia Edge AI Cros BTE R
Esentia Edge AI 1000 BTE
Esentia Edge AI 1000 BTE R
Esentia Edge AI 1200 BTE
Esentia Edge AI 1200 BTE R
Esentia Edge AI 1600 BTE

Esentia Edge AI 1600 BTE R
Esentia Edge AI 2000 BTE
Esentia Edge AI 2000 BTE R
Esentia Edge AI 2400 BTE
Esentia Edge AI 2400 BTE R
Esentia 1000 BTE
Esentia 1000 BTE R
Esentia 1000a BTE
Esentia 1200 BTE
Esentia 1200 BTE R
Esentia 1600 BTE R
Esentia 2000 BTE
Esentia 2000 BTE R
Esentia 2400 BTE
Esentia 2400 BTE R
Esentia1600 BTE
Evolv AI Cros BTE
Evolv AI Cros BTE R
Evolv AI Cros Power Plus BTE
Evolv AI 1000 BTE
Evolv AI 1000 BTE R
Evolv AI 1000 Power Plus BTE
Evolv AI 1200 BTE
Evolv AI 1200 BTE R
Evolv AI 1200 Power Plus BTE
Evolv AI 1600 BTE
Evolv AI 1600 BTE R
Evolv AI 1600 Power Plus BTE
Evolv AI 2000 BTE
Evolv AI 2000 BTE R
Evolv AI 2000 Power Plus BTE
Evolv AI 2400 BTE
Evolv AI 2400 BTE R
Evolv AI 2400 Power Plus BTE
Livio Ai Cros BTE
Livio AI Cros BTE R
Livio AI 1000 BTE
Livio AI 1000 BTE R

Livio AI 1200 BTE
Livio AI 1200 BTE R
Livio AI 1600 BTE
Livio AI 1600 BTE R
Livio AI 2000 BTE
Livio AI 2000 BTE R
Livio Ai 2400 BTE
Livio AI 2400 BTE R
Livio Cros BTE
Livio Cros BTE R
Livio Edge AI Cros BTE
Livio Edge AI Cros BTE R
Livio Edge AI 1000 BTE
Livio Edge AI 1000 BTE R
Livio Edge AI 1200 BTE
Livio Edge AI 1200 BTE R
Livio Edge AI 1600 BTE
Livio Edge AI 1600 BTE R
Livio Edge AI 2000 BTE
Livio Edge AI 2000 BTE R
Livio Edge AI 2400 BTE
Livio Edge AI 2400 BTE R
Livio 1000 BTE
Livio 1000 BTE R
Livio 1000a BTE
Livio 1200 BTE
Livio 1200 BTE R
Livio 1600 BTE
Livio 1600 BTE R
Livio 2000 BTE
Livio 2000 BTE R
Livio 2400 BTE
Livio 2400 BTE R
Model M2 BTE
Model M3 BTE
Model N2 BTE
Model N3 BTE
Model S2 BTE

Model S3 BTE
Savant AI Cros BTE
Savant AI Cros BTE R
Savant AI Cros Power Plus BTE
Savant AI 1000 BTE
Savant AI 1000 BTE R
Savant AI 1000 Power Plus BTE
Savant AI 1200 BTE
Savant AI 1200 BTE R
Savant AI 1200 Power Plus BTE
Savant AI 1600 BTE
Savant AI 1600 BTE R
Savant AI 1600 Power Plus BTE
Savant AI 2000 BTE
Savant AI 2000 BTE R
Savant AI 2000 Power Plus BTE
Savant AI 2400 BTE
Savant AI 2400 BTE R
Savant AI 2400 Power Plus BTE

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	STARKEY DO BRASIL LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04.216.059/0001-72
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.01.791-5
Nome do Dispositivo Médico	Aparelhos Auditivos Receptores de Canal (RICs)
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Aparelho Auditivo
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80179150080
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351325523201925
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: STARKEY DE MEXICO, S.A. DE C.V - MÉXICO
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	12/08/2019
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3046-02-EE-XX - SPI19 RIC Rechargeable Operations Manual (6).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:57
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-04-EE-XX - SPI19 Smartphone Compatible & Universal Connectivity (5).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-04-EE-XX - SPI19 Smartphone Compatible & Universal Connectivity (6).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-04-EE-XX - SPI19 Smartphone Compatible & Universal Connectivity (7).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-06-EE-XX - RIC Opman - MicroTech.pdf	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3005-06-EE-XX - RIC Opman - Starkey.pdf	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3046-02-EE-XX - SPI19 RIC Rechargeable Operations Manual (4).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BKLT3046-02-EE-XX - SPI19 RIC Rechargeable Operations Manual (5).PDF	2392390223 - 13/04/2022 12:18:56

Modelo Produto Médico
Evolv AI 2000 RIC R

Evolv AI 2400 mRIC
Evolv AI 2400 RIC
Evolv AI 2400 RIC R
Livio AI Cros mRIC
Livio Ai Cros RIC
Livio Ai Cros RIC R
Livio Ai 1000 mRIC
Livio AI 1000 RIC
Livio Ai 1000 RIC R
Circa AI Cros mRIC
Circa Ai Cros RIC
Circa Ai Cros RIC R
Circa Ai 1000 mRIC
Circa AI 1000 RIC
Circa Ai 1000 RIC R
Circa Ai 1200 mRIC
Circa AI 1200 RIC
Circa Ai 1200 RIC R
Circa Ai 1600 mRIC
Circa AI 1600 RIC
Circa Ai 1600 RIC R
Circa Ai 2000 mRIC
Circa AI 2000 RIC
Circa Ai 2000 RIC R
Circa Ai 2400 mRIC
Circa AI 2400 RIC
Circa Ai 2400 RIC R
Circa Cros mRIC
Circa Cros RIC
Circa Cros RIC R
Circa Edge AI Cros mRIC
Circa Edge AI Cros RIC
Circa Edge AI Cros RIC R
Circa Edge AI 1000 mRIC
Circa Edge AI 1000 RIC
Circa Edge AI 1000 RIC R
Circa Edge AI 1200 mRIC
Circa Edge AI 1200 RIC

Circa Edge AI 1200 RIC R
Circa Edge AI 1600 mRIC
Circa Edge AI 1600 RIC
Circa Edge AI 1600 RIC R
Circa Edge AI 2000 mRIC
Circa Edge AI 2000 RIC
Circa Edge AI 2000 RIC R
Circa Edge AI 2400 mRIC
Circa Edge AI 2400 RIC
Circa Edge AI 2400 RIC R
Circa 1000 mRIC
Circa 1000 RIC
Circa 1000 RIC R
Circa 1000a mRIC
Circa 1000a RIC
Circa 1000a RIC R
Circa 1200 mRIC
Circa 1200 RIC
Circa 1200 RIC R
Circa 1600 mRIC
Circa 1600 RIC
Circa 1600 RIC R
Circa 2000 mRIC
Circa 2000 RIC
Circa 2000 RIC R
Circa 2400 mRIC
Circa 2400 RIC
Circa 2400 RIC R
Envy AI Cros mRIC
Envy AI Cros RIC
Envy AI Cros RIC R
Envy AI 1000 mRIC
Envy AI 1000 RIC
Envy AI 1000 RIC R
Envy AI 1200 mRIC
Envy AI 1200 RIC
Envy AI 1200 RIC R
Envy AI 1600 mRIC

Envy AI 1600 RIC
Envy AI 1600 RIC R
Envy AI 2000 mRIC
Envy AI 2000 RIC
Envy AI 2000 RIC R
Envy AI 2400 mRIC
Envy AI 2400 RIC
Envy AI 2400 RIC R
Esentia Ai Cros mRIC
Esentia Ai Cros RIC
Esentia Ai Cros RIC R
Esentia Ai 1000 mRIC
Esentia AI 1000 RIC
Esentia Ai 1000 RIC R
Esentia Ai 1200 mRIC
Esentia AI 1200 RIC
Esentia Ai 1200 RIC R
Esentia Ai 1600 mRIC
Esentia AI 1600 RIC
Esentia Ai 1600 RIC R
Esentia Ai 2000 mRIC
Esentia AI 2000 RIC
Esentia Ai 2000 RIC R
Esentia Ai 2400 mRIC
Esentia AI 2400 RIC
Esentia Ai 2400 RIC R
Esentia Cros mRIC
Livio Ai 1200 mRIC
Livio AI 1200 RIC
Livio Ai 1200 RIC R
Livio Ai 1600 mRIC
Livio AI 1600 RIC
Livio Ai 1600 RIC R
Livio Ai 2000 mRIC
Livio AI 2000 RIC
Livio Ai 2000 RIC R
Livio Ai 2400 mRIC
Livio AI 2400 RIC

Livio Ai 2400 RIC R
Livio Cros mRIC
Livio Cros RIC
Livio Cros RIC R
Livio Edge AI Cros mRIC
Livio Edge AI Cros RIC
Livio Edge AI Cros RIC R
Livio Edge AI 1000 mRIC
Livio Edge AI 1000 RIC
Livio Edge AI 1000 RIC R
Livio Edge AI 1200 mRIC
Livio Edge AI 1200 RIC
Livio Edge AI 1200 RIC R
Livio Edge AI 1600 mRIC
Livio Edge AI 1600 RIC
Livio Edge AI 1600 RIC R
Livio Edge AI 2000 mRIC
Livio Edge AI 2000 RIC
Livio Edge AI 2000 RIC R
Livio Edge AI 2400 mRIC
Livio Edge AI 2400 RIC
Livio Edge AI 2400 RIC R
Livio 1000 mRIC
Livio 1000 RIC
Livio 1000 RIC R
Livio 1000a mRIC
Livio 1000a RIC
Livio 1000a RIC R
Livio 1200 mRIC
Livio 1200 RIC
Livio 1200 RIC R
Livio 1600 mRIC
Livio 1600 RIC
Livio 1600 RIC R
Livio 2000 mRIC
Livio 2000 RIC
Livio 2000 RIC R
Livio 2400 mRIC

Livio 2400 RIC
Livio 2400 RIC R
Marca - Microtech
Marca - Nuear
Model M2 RIC
Model M3 RIC
Model N2 RIC
Model N3 RIC
Model S2 RIC
Model S3 RIC
Savant AI Cros mRIC
Savant AI Cros RIC
Savant AI Cros RIC R
Savant AI 1000 mRIC
<b>Savant AI 1000 RIC</b>
Savant AI 1000 RIC R
Savant AI 1200 mRIC
<b>Savant AI 1200 RIC</b>
Savant AI 1200 RIC R
Savant AI 1600 mRIC
<b>Savant AI 1600 RIC</b>
Savant AI 1600 RIC R
Savant AI 2000 mRIC
Savant AI 2000 RIC
Savant AI 2000 RIC R
Savant AI 2400 mRIC
Savant AI 2400 RIC
Savant AI 2400 RIC R
Esentia Cros RIC
Esentia Cros RIC R
Esentia Edge AI Cros mRIC
Esentia Edge AI Cros RIC
Esentia Edge AI Cros RIC R
Esentia Edge AI 1000 mRIC
Esentia Edge AI 1000 RIC
Esentia Edge AI 1000 RIC R
Esentia Edge AI 1200 mRIC
Esentia Edge AI 1200 RIC

Esentia Edge AI 1200 RIC R
Esentia Edge AI 1600 mRIC
Esentia Edge AI 1600 RIC
Esentia Edge AI 1600 RIC R
Esentia Edge AI 2000 mRIC
Esentia Edge AI 2000 RIC
Esentia Edge AI 2000 RIC R
Esentia Edge AI 2400 mRIC
Esentia Edge AI 2400 RIC
Esentia Edge AI 2400 RIC R
Esentia 1000 mRIC
Esentia 1000 RIC
Esentia 1000 RIC R
Esentia 1000a mRIC
Esentia 1000a RIC
Esentia 1000a RIC R
Esentia 1200 mRIC
Esentia 1200 RIC
Esentia 1200 RIC R
Esentia 1600 mRIC
Esentia 1600 RIC
Esentia 1600 RIC R
Esentia 2000 mRIC
Esentia 2000 RIC
Esentia 2000 RIC R
Esentia 2400 mRIC
Esentia 2400 RIC
Esentia 2400 RIC R
Evolv AI Cros mRIC
Evolv AI Cros RIC
Evolv AI Cros RIC R
Evolv AI 1000 mRIC
Evolv AI 1000 RIC
Evolv AI 1000 RIC R
Evolv AI 1200 mRIC
Evolv AI 1200 RIC
Evolv AI 1200 RIC R
Evolv AI 1600 mRIC

Evolv AI 1600 RIC
Evolv AI 1600 RIC R
Evolv AI 2000 mRIC
Evolv AI 2000 RIC

Deteccao ou Quantif.de Processos Auto Imunes 25000.003972/99-81  
ANTICORPO ENDOMISIAL IgA (Em A) IMUNOFLUORESCENCIA VIRGO  
FABRICANTE : HEMAGEN DIAGNÓSTICOS COM IMP EXP LTDA - ESTADOS UNIDOS  
Kit para 48 ou 96 testes.  
CLASSE : B 10280220138  
8014 - Revalidação de Registro de Reagentes para diagnósticos de Uso In Vitro Nacional e Importado

-----  
Total de Empresas :1

#### RESOLUÇÃO-RE Nº 361, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria nº 327, de 16 de maio de 2003, considerando o inciso III do art. 44 e o § 3º do art. 111 do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 593, de 25 de agosto de 2000, republicada em 22 de dezembro de 2000, resolve:

Art. 1º Conceder o Registro dos Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES

#### ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO  
NOME TÉCNICO NÚMERO DO PROCESSO  
NOME COMERCIAL  
LOCAL DE FABRICAÇÃO  
MODELO(S) DO PRODUTO  
CLASSE REGISTRO  
PETIÇÃO(ÕES)

ALAMAR TECNO-CIENTIFICA LTDA 8.00491-2  
Reagentes P/ Avaliacao da Coagulacao Sanguinea  
25351.026796/2003-22  
KONTACT APTT REAGENT  
FABRICANTE : FISHER DIAGNOSTICS - ESTADOS UNIDOS  
10 frascos x 4ml; 10 frascos x 10ml.  
CLASSE : B 10252080081  
8002 - Registro de Reagentes para Diagnósticos de Uso In Vitro Importado  
Reagentes P/ Avaliacao da Coagulacao Sanguinea  
25351.026800/2003-52  
FIBRINOGEN ASSAY KIT  
FABRICANTE : FISHER DIAGNOSTICS - ESTADOS UNIDOS  
Kit para 100 determinações  
Kit para 300 determinações  
CLASSE : B 10252080082  
8002 - Registro de Reagentes para Diagnósticos de Uso In Vitro Importado

BAYDIAG LTDA 1.03451-6  
Tampoes,Solucoes Eletrol.Diluentes/Demais Solucoes  
25351.026041/2003-28  
TECHNICON RA/OPERA SYSTEMS CLEANSING SOLUTION  
FABRICANTE : BAYER CO - ESTADOS UNIDOS  
2 x 4000ml  
CLASSE : A 10345160420  
8002 - Registro de Reagentes para Diagnósticos de Uso In Vitro Importado  
Tampoes,Solucoes Eletrol.Diluentes/Demais Solucoes  
25351.025151/2003-72  
TECHNICON H SYSTEMS RINSE 1  
FABRICANTE : BAYER CO - ESTADOS UNIDOS  
6 x 2300 ml  
CLASSE : A 10345160421  
8002 - Registro de Reagentes para Diagnósticos de Uso In Vitro Importado

BAYER S.A. 8.01356-3  
Tampoes,Solucoes Eletrol.Diluentes/Demais Solucoes  
25351.026034/2003-26  
ADVIA 120 EZ KLEEN  
FABRICANTE : BAYER CO - ESTADOS UNIDOS  
4 x 810ml  
CLASSE : A 80135630163  
8002 - Registro de Reagentes para Diagnósticos de Uso In Vitro Importado

BECKMAN COULTER DO BRAZIL LTDA 1.00331-2  
Tampoes,Solucoes Eletrol.Diluentes/Demais Solucoes  
25351.028347/2003-19  
PROBE RINSE  
FABRICANTE : BECKMAN COULTER - ESTADOS UNIDOS  
6 frascos x 13,8ml  
CLASSE : A 10033120379  
8002 - Registro de Reagentes para Diagnósticos de Uso In Vitro Importado

PHOENIX IND E COM EQUIP CIENTIFICOS LTDA 8.00047-1  
Monitor Fetal 25351.027583/2003-18

AUTOCLAVE HORIZONTAL LINHA LUFERCO  
FABRICANTE : PHOENIX IND E COM EQUIP CIENTIFICOS LTDA - BRASIL  
39206  
39209  
39205  
CLASSE : II 80004710003  
8006 - Registro de Famílias de Artigo de Uso Médico ou de Equipamentos de Médio e Pequeno Porte Importado para Diagnóstico ou Terapia, Artigos, Materiais e demais Produtos

TECNOSUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1.01884-1  
Deteccao Quantif.de Erros Inatos de Metabolismo  
25351.028108/2003-69  
UMTEST GAL  
FABRICANTE : CENTRO DE INMUNOENSAYO - CUBA  
Kit para 288 testes  
CLASSE : B 10188410020  
8002 - Registro de Reagentes para Diagnósticos de Uso In Vitro Importado

-----  
Total de Empresas :6

#### RESOLUÇÃO-RE Nº 362, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria nº 327, de 16 de maio de 2003, considerando o inciso III do art. 44 e o § 3º do art. 111 do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 593, de 25 de agosto de 2000, republicada em 22 de dezembro de 2000, resolve:

Art. 1º Conceder o Cadastramento, a Alteração e a Retificação de Cadastramento dos Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES

#### ANEXO

ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA  
RELATORIO DE EMPRESAS E PRODUTOS

Nome Empresa Autorizacao  
Nome Tecnico No. Processo  
Nome Comercial  
Local de Fabricacao  
Apresentacao do Produto  
Classe Cadastramento  
Peticao (coes)

FLEX LAB COM.DE MATERIAL CIRURGICOS E HOSP. LTDA 8008135  
Containers em Geral(Caixas, Bandejas, Cubas, etc) 25351002090/03-75  
CONTAINERS PARA ESTERILIZACAO COM ACESSORIOS REDA  
REDA INSTRUMENTE GMBH - ALEMANHA  
Classe: 1 80081359001  
04 - Cadastramento (Isencao) de Produtos

GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1038916  
Roupa de Cama Hospitalar 25351037035/01-45  
GRANDESC LENCOL DESCARTAVEL GRANMED  
GRNMED IND COM. LTDA - BRASIL  
Embalado em saco plastico individualmente, com 10 ou 50 unidades de  
Grandesc Lencol Descartavel GRANMED, e acondicionado em caixa com  
10 pacotes  
Classe: 1 10389169005  
06 - Alteracao da Composicao do Produto

KODAK BRASILEIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1021618  
Filmes Para Raios X 25000012906/98-67  
FILMES ESPECIAIS PARA MAMOGRAFIA MIN-RM KODAK  
KODAK BRASILEIRA COM IND LTDA - BRASIL  
Classe: 1 10216189007  
13 - Retificacao da Apresentacao Comercial  
38 - Alteracao da Razao Social do Fabricante

#### RESOLUÇÃO-RE Nº 364, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003

O Diretor de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria nº 327, do Diretor-Presidente, de 16 de maio de 2003, considerando o inciso V do art. 44 e o § 3º do Art. 111 do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000; considerando o art. 2º, da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder os pedidos de autorização de funcionamento das empresas constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES

#### ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE  
EMPRESA: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA  
CNPJ: 05.351.445/0001-30  
PROCESSO: 25351.044960/2003-83 AUTORIZ/MS: PYY4XMXM2LM6  
RP. TECNICO: JOSEANE ZANELLA  
RP. LEGAL : ESTHER ALEIXO MALTA  
ENDERECO: AV DUQUE DE CAXIAS 394 SALAS 2 E 107  
BAIRRO: SÃO BRAZ CEP: 66093400 - BELEM/PA  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
EMPRESA: CLOROVALE DIAMANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP  
CNPJ: 65.478.018/0001-49  
PROCESSO: 25351.058253/2003-74 AUTORIZ/MS: Y8W300X4515H  
RP. TECNICO: KIYOUE UMEDA  
RP. LEGAL : JOÃO ROBERTO MORO  
ENDERECO: ESTRADA PRINCIPAL DO TORRÃO DE OURO 500  
BAIRRO: TORRÃO DE OURO CEP: 12230000 - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP  
ATIVIDADE/CLASSE  
FABRICAR: CORRELATO  
EMPRESA: DELTA HOSPITALAR LTDA  
CNPJ: 00.080.120/0001-46  
PROCESSO: 25351.060206/2003-91 AUTORIZ/MS: PP21687X29H2  
RP. TECNICO: ALOMA SILVA BONIFÁCIO  
RP. LEGAL : NELSON CASTRO ALVES TRAD  
ENDERECO: RUA P-13 Nº 118, QD P-78, LOTE 14, SALA 06  
BAIRRO: SETOR DOS FUNCIONARIOS CEP: 74543260 - GOIANIA/GO  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
EMPRESA: GLOBALCOM TRADING HQ LTDA  
CNPJ: 04.504.200/0001-32  
PROCESSO: 25351.058113/2003-04 AUTORIZ/MS: P814Y37W482W  
RP. TECNICO: RAFAEL PASSAMANI NAJAR  
RP. LEGAL : CLAUDIO MORENO  
ENDERECO: AV. JERONIMO MONTEIRO 1000, SALAS 1106/1108  
BAIRRO: CENTRO CEP: 29010004 - VITORIA/ES  
ATIVIDADE/CLASSE  
IMPORTAR: CORRELATO  
EMPRESA: MAKARIOS LTDA.  
CNPJ: 01.744.881/0001-18  
PROCESSO: 25351.037194/2003-09 AUTORIZ/MS: P69130346WH1  
RP. TECNICO: CARLOS HENRIQUE PALMA  
RP. LEGAL : AURO LIBERATI  
ENDERECO: ALAMEDA ARAGUACEMA 138  
BAIRRO: TAMBORE CEP: 06460070 - BARUERI/SP  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
EXPORTAR: CORRELATO  
FABRICAR: CORRELATO  
EMPRESA: MIGUEL FROTA VINAS  
CNPJ: 23.535.727/0001-79  
PROCESSO: 25016.337229/2003-18 AUTORIZ/MS: 76515X6Y37XW  
RP. TECNICO: DAVI HELDER DE VASCONCELOS  
RP. LEGAL : MIGUEL FROTA VINAS  
ENDERECO: AVENIDA JOHN SANFORD 1661  
BAIRRO: JUNCO CEP: 62030500 - SOBRAL/CE  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO  
EMPRESA: PEROXIDOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA  
CNPJ: 03.850.628/0001-74  
PROCESSO: 25351.056872/2003-24 AUTORIZ/MS: P08305W8HX96  
RP. TECNICO: MARIA ELIZABETH COTTA PINHEIRO PIRES  
RP. LEGAL : RAUL MORCILLO GUILLAN  
ENDERECO: AV. MINISTRO IVAN LINS 460, SALA 103  
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22620110 - RIO DE JANEIRO/RJ  
ATIVIDADE/CLASSE  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EXPORTAR: CORRELATO  
IMPORTAR: CORRELATO  
EMPRESA: PIRADENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME  
CNPJ: 04.053.715/0001-63  
PROCESSO: 25351.056356/2003-08 AUTORIZ/MS: PMX3H34Y36W1  
RP. TECNICO: LARISSA ORSINI BARBIN  
RP. LEGAL : ALEXANDRE DONIZETI MORAES  
ENDERECO: RUA 15 DE NOVEMBRO 2441



BAIRRO: CENTRO CEP: 13630145 - PIRASSUNUNGA/SP  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 FABRICAR: CORRELATO  
 EMPRESA: STAR ODONTOMÉDICA LTDA  
 CNPJ: 05.567.724/0001-35  
 PROCESSO: 25351.060565/2003-48 AUTORIZ/MS: P01563657831  
 RP. TECNICO: ELIANE RODRIGUES DA CRUZ  
 RP. LEGAL : TULIO DA CUNHA ALVES  
 ENDEREÇO: RUA C 104 N. 936 QD. 300 LT 04  
 BAIRRO: JARDIM AMÉRICA CEP: 74250030 - GOIANIA/GO  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EXPEDIR: CORRELATO  
 EMPRESA: STARKEY DO BRASIL LTDA  
 CNPJ: 04.216.059/0001-72  
 PROCESSO: 25351.057032/2003-89 AUTORIZ/MS:  
 PSY32W0XL65M  
 RP. TECNICO: SIMON JOHN MCMILLAN  
 RP. LEGAL : PRISCILLA APARECIDA SOLERA DIAS  
 ENDEREÇO: RUA MANOEL FRANCISCO MENDES, 347  
 BAIRRO: JARDIM DO TREVO CEP: 13030280 - CAMPINAS/SP  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 EXPEDIR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 FABRICAR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: ZIEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO  
 LTDA  
 CNPJ: 05.531.336/0001-02  
 PROCESSO: 25351.056132/2003-98 AUTORIZ/MS:  
 U70515YY6624  
 RP. TECNICO: JURGEN JACOBSEN  
 RP. LEGAL : KARIN MARIANNE JACOBSEN  
 ENDEREÇO: RUA BARAO DO TRIUNFO 375 SALAS 106-115  
 BAIRRO: BROOKLIN CEP: 04602000 - SAO PAULO/SP  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO

-----  
 Total de Empresas :11

#### RESOLUÇÃO-RE Nº 365, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003

O Diretor de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria n.º 327, do Diretor-Presidente, de 16 de maio de 2003, considerando o inciso V do art. 44 e o § 3º do Art. 111 do Regimento Interno aprovado pela Portaria n.º 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000; considerando o art. 2º, da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder os pedidos de alteração na autorização de funcionamento das empresas constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES

ANEXO

ALTERAÇÃO NA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS  
 DE PRODUTOS PARA SAÚDE  
 EMPRESA: ARTMEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
 CNPJ: 03.950.712/0001-60  
 PROCESSO: 25351.018547/0130- AUTORIZ/MS: 8.00768.0  
 RP. TECNICO: CELIA LINDA CATACHE ZACCAI  
 RP. LEGAL : PATRICIA SIMONE MESSER  
 ENDEREÇO: RUA GUARARÁ 529, CJ 73/74  
 BAIRRO: JARDIM PAULISTA CEP: 01425001 - SAO PAULO/SP  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: BIO IMAGEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
 CNPJ: 03.830.607/0001-97  
 PROCESSO: 25351.003307/0112- AUTORIZ/MS: 8.00595.2  
 RP. TECNICO: DENIS ANGELO FARIA COLA  
 RP. LEGAL : MAURO JANKELVICIUS  
 ENDEREÇO: RUA DONA GERMAINE BURCHARD 652  
 BAIRRO: AGUA BRANCA CEP: 05002061 - SAO PAULO/SP  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: DANIMED COML. HOSPITALAR LTDA.  
 CNPJ: 02.599.224/0001-97  
 PROCESSO: 25023.170046/0002- AUTORIZ/MS: 8.00215.1  
 RP. TECNICO: MARILZA CELINA DA SILVA  
 RP. LEGAL : NILCEU GONÇALVES FERREIRA  
 ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO 35  
 BAIRRO: PARQUE SÃO JORGE CEP: 86185590 - CAMBE/PR  
 ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATO  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EMPRESA: ECOMED COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
 CNPJ: 29.992.682/0001-48  
 PROCESSO: 25000.017513/9741- AUTORIZ/MS: 1.03378.5  
 RP. TECNICO: ALEC FLINTE / RUDOLF PETER VORBAU  
 RP. LEGAL : DEREK FLINTE KIRCHER  
 ENDEREÇO: LARGO DO MACHADO, 54 SLS. 105-107  
 BAIRRO: CATETE CEP: 22221020 - RIO DE JANEIRO/RJ  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 REEMBALAR: CORRELATO  
 EMPRESA: EDUARDO PAULO GDIKIAN EPP  
 CNPJ: 73.013.237/0001-80  
 PROCESSO: 00827.97/- AUTORIZ/MS: 1.03497.6  
 RP. TECNICO: EDUARDO PAULO GDIKIAN  
 RP. LEGAL : EDUARDO PAULO GDIKIAN  
 ENDEREÇO: RUA VERISSIMO GLORIA 112  
 BAIRRO: PACAEMBÚ CEP: 01241140 - SAO PAULO/SP  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA  
 CNPJ: 33.482.241/0001-73  
 PROCESSO: 25004.072472/96- AUTORIZ/MS: 1.03106.5  
 RP. TECNICO: LUIZ CARLOS CONTE  
 RP. LEGAL : PAULA RITA CHERIN DE NÓBREGA  
 ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO 5229, 10º ANDAR  
 BAIRRO: JARDIM EUROPA CEP: 01407907 - SAO PAULO/SP  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EXPEDIR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 TRANSPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: GLICOMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT-  
 DA  
 CNPJ: 68.710.557/0001-50  
 PROCESSO: 25000.027573/9880- AUTORIZ/MS: 1.03851.8  
 RP. TECNICO: MARCOS EDUARDO DA SILVA JORDAO  
 RP. LEGAL : JOÃO DA FÁTIMA DA SILVA JORDÃO  
 ENDEREÇO: RUA DA QUITANDA 185, SALAS 301/302  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 20091000 - RIO DE JANEIRO/RJ  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: GRAFICOS ESPECIAIS LTDA  
 CNPJ: 25.456.112/0001-82  
 PROCESSO: 25351.013983/0013- AUTORIZ/MS: 8.00339.9  
 RP. TECNICO: SUZEN TEIXEIRA  
 RP. LEGAL : MARIA ELIZABETH MASCARENHAS DINIZ  
 ENDEREÇO: RUA DR. BALEEIRO 139  
 BAIRRO: JARDIM MONTANHES CEP: 30750040 - BELO HO-  
 RIZONTE/MG  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EMPRESA: MEDIPHACOS LTDA  
 CNPJ: 21.998.885/0001-30  
 PROCESSO: 25000.002052/8875- AUTORIZ/MS: 1.01610.2  
 RP. TECNICO: ADALBERTO MARQUES PINTO NETO  
 RP. LEGAL : MARCELO FRANCISCO PESSOA SOARES  
 ENDEREÇO: RUA MESTRE LUIZ 31  
 BAIRRO: SAO PEDRO CEP: 30330070 - BELO HORIZON-  
 TE/MG  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EMBALAR: CORRELATO  
 EXPEDIR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 FABRICAR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 REEMBALAR: CORRELATO  
 EMPRESA: NATURA COSMÉTICOS S/A  
 CNPJ: 71.673.990/0001-77  
 PROCESSO: 25351.165301/02- AUTORIZ/MS: 8.01066.1  
 RP. TECNICO: PETER JOSÉ FRIAS PASCHOAL  
 RP. LEGAL : ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA DA SILVA  
 ENDEREÇO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT S/Nº., KM 293  
 BAIRRO: POTUVERA CEP: 06882700 - ITAPECERICA DA SER-  
 RA/SP  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EXPEDIR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: PRODUTOS ORTOPÉDICOS CHANTAL LTDA  
 CNPJ: 56.216.781/0001-00  
 PROCESSO: 25351.018346/0005- AUTORIZ/MS: 8.00412.1  
 RP. TECNICO: MARA ROSANE FERREIRA DE FARIA SU-  
 RIAN  
 RP. LEGAL : MARCELO LUIS REIS  
 ENDEREÇO: AVENIDA GENERAL CHAGAS SANTOS 62

BAIRRO: JARDIM SAÚDE CEP: 04146050 - SAO PAULO/SP  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 FABRICAR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITA-  
 LAR LTDA  
 CNPJ: 54.446.810/0001-03  
 PROCESSO: 25004.027043/96- AUTORIZ/MS: 1.03183.9  
 RP. TECNICO: LEONILDA SILVESTREIN  
 RP. LEGAL : EDMUNDO DAMIAN FAINBRUM  
 ENDEREÇO: AV MOEMA 863  
 BAIRRO: MOEMA CEP: 04077023 - SAO PAULO/SP  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA  
 CNPJ: 01.107.391/0001-00  
 PROCESSO: 25000.000778/0078- AUTORIZ/MS: 8.00153.5  
 RP. TECNICO: DHALIA GUTEMBERG  
 RP. LEGAL : CARLOS EDUARDO PAULA LEITE GOUVEA  
 ENDEREÇO: ALAMEDA VICENTE PINZON, N° 173, 2º ANDAR,  
 CONJUNTO 21  
 BAIRRO: VILA OLÍMPIA CEP: 04547130 - SAO PAULO/SP  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA  
 CNPJ: 50.649.003/0001-29  
 PROCESSO: 25991.008757/79- AUTORIZ/MS: 1.01833.3  
 RP. TECNICO: TATIANA ROCHA LEONARDO  
 RP. LEGAL : MANOEL SIMPLICIO NETO  
 ENDEREÇO: AV. DOS CARINAS, 525  
 BAIRRO: INDIANÓPOLIS CEP: 04086011 - SAO PAULO/SP  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: VIDEOMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO  
 HOSPITALAR LTDA  
 CNPJ: 01.486.078/0001-20  
 PROCESSO: 25351.171163/2002-97 AUTORIZ/MS: 8.01088.8  
 RP. TECNICO: MARCIA REGINA FERNANDES DE NÓBREGA  
 INGLEZ  
 RP. LEGAL : ELAINE CRISTINA DOS SANTOS  
 ENDEREÇO: RUA PROF ª LYGIA AZEVEDO SA 26  
 BAIRRO: PRACA DA ARVORE CEP: 04141110 - SAO PAU-  
 LO/SP  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO

-----  
 Total de Empresas :15

#### RESOLUÇÃO-RE Nº 1.800, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003

O Adjunto da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria n.º 238, de 31 de março de 2003, considerando o art. 12 da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976;

considerando o inciso IV do art. 50 e o § 3º do art. 111 do Regimento Interno aprovado pela Portaria n.º 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no D.O.U. de 22 de dezembro de 2000, resolve:

Art. 1º Conceder o Registro de Apresentações Associadas (Kits), Novo Acondicionamento, Alteração no Texto de Bula, Alteração do Prazo de Validade, Renovação de Registro de Medicamento Similar, Cancelamento de Registro do Medicamento por Transferência de Titularidade, Alteração Titular de Registro (incorporação de empresa), Cancelamento de Registro da Apresentação do Medicamento a Pedido, Retificação de Publicação de Registro, de produtos farmacêuticos, conforme na relação em anexo.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DAVI RUMEL

ANEXO

ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS S/A 1.00573-9  
 RIBOFLAVINA 5-FOSFATO SÓDICA + CLORIDRATO DE PIRI-  
 DOXINA + ÁCIDO ASCÓRBICO + PANTOTENATO DE SÓDIO +  
 GLICOSE ANIDRA  
 POLIVITAMINICOS SEM MINERAIS  
 DEXTROVITASE 25991.000369/78- 04/2005  
 COMERCIAL 1.0573.0016.002-9 18 Meses  
 SOL INJ CT AMP VD INC X 10 ML  
 DEXTROVITASE  
 138 Alteração no Texto de Bula  
 COMERCIAL 1.0573.0016.003-7 18 Meses  
 SOL INJ CT AMP VD INC X 20 ML  
 DEXTROVITASE  
 138 Alteração no Texto de Bula

ENDEREÇO: RUA CORONEL CABRITA, Nº 75/83/85/95  
BAIRRO: JARDIM DA GLÓRIA CEP: 01545030 - SÃO PAULO/SP  
CNPJ: 57.884.835/0001-79  
PROCESSO: 0366490 AUTORIZ/MS: 1.01748.0  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
FRACIONAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS  
EMPRESA: NORDESTE COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA  
ENDEREÇO: RUA HAROLDO TORRES Nº. 1305  
BAIRRO: PRESIDENTE KENNEDY CEP: 60355485 - FORTALEZA/CE  
CNPJ: 23.455.090/0001-00  
PROCESSO: 25351.000908/00 AUTORIZ/MS: 1.04688.2  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO  
EMPRESA: MARKA COMÉRCIO LTDA  
ENDEREÇO: RUA ABRAHIM S. FARHAT, Nº 57  
BAIRRO: VILA IVONETE CEP: 69909710 - RIO BRANCO/AC  
CNPJ: 63.595.490/0001-36  
PROCESSO: 25351.026875/00-83 AUTORIZ/MS: 1.04930.7  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EMPRESA: FEDCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
ENDEREÇO: RUA ESPLANADA SILVA JARDIM, Nº 86  
BAIRRO: RIBEIRA CEP: 59012090 - NATAL/RN  
CNPJ: 40.809.626/0001-68  
PROCESSO: 25000.024378/94-74 AUTORIZ/MS: 1.02702.7  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
IMPORTAR: MEDICAMENTO  
EMPRESA: EQUILIBRIO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA  
ENDEREÇO: SHCGN CR QUADRA 714/715, BLOCO D, LOJA 40, PARTÊ SUBSOLO  
BAIRRO: ASA NORTE CEP: 70761640 - BRASÍLIA/DF  
CNPJ: 05.215.461/0001-03  
PROCESSO: 25351.310464/2006-76 AUTORIZ/MS: 1.06713.1  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO  
EMPRESA: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
ENDEREÇO: SIA/SUL TRECHO 03, LOTE 625/695, LOJA 29, 30 E 32  
BAIRRO: SIA/SUL CEP: 71200030 - BRASÍLIA/DF  
CNPJ: 06.081.203/0001-36  
PROCESSO: 25351.199666/2004-99 AUTORIZ/MS: 1.05977.7  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: MEDICAMENTO  
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO  
EXPEDIR: MEDICAMENTO  
EXPORTAR: MEDICAMENTO

#### RESOLUÇÃO-RE Nº 1.010, DE 10 DE MARÇO DE 2011

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 26 de agosto de 2010, do Presidente da República, publicado no DOU de 27 de agosto de 2010, o inciso VIII do art. 15, o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 29, de 11 de janeiro de 2011, considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 354, de 2006, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Concessão de Autorização de Funcionamento para Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA

ANEXO

EMPRESA: J.C.T MESQUITA COMERCIO LTDA  
ENDEREÇO: AV.JONES DOS SANTOS NEVES Nº 324  
BAIRRO: CENTRO CEP: 29930000 - SÃO MATEUS/ES  
CNPJ: 39.392.055/0001-20  
PROCESSO: 25351.801037/2010-16  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: A relação dos produtos comercializados pela empresa indica fornecimento para estabelecimentos assistenciais de saúde e/ou profissionais de saúde, configurando atividade de comércio atacadista, não estando compreendidos no CNAE constante no CNPJ da empresa, bem como apresentar como responsável técnico profissional economista, em desacordo com o previsto na legislação vigente.  
EMPRESA: MÍCROLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.  
ENDEREÇO: RUA LATTES QD.06 LOTE 09 Nº 222  
BAIRRO: JD. PLANALTO CEP: 74333060 - GOIÂNIA/GO

CNPJ: 03.469.129/0001-31  
PROCESSO: 25351.001993/2011-08  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Considerando a natureza dos produtos, os quais não são destinados ao público em geral e sim a serviços de saúde ou profissionais, e tendo em vista as definições de comércio varejista e de comércio atacadista conforme Resolução CONCLA nº 3, de 16/05/2007, a atividade pretendida não se caracteriza como comércio varejista. A empresa deverá peticionar solicitação de Autorização de Funcionamento para a atividade de distribuição.  
EMPRESA: EXPANSÃO MEDICA LTDA-ME  
ENDEREÇO: RUA MARECHAL ALMEIDA BARRETO, 278  
BAIRRO: CENTRO CEP: 58013460 - JOÃO PESSOA/PB  
CNPJ: 11.392.682/0001-41  
PROCESSO: 25351.075768/2011-08  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Considerando a natureza dos produtos, os quais não são destinados ao público em geral e sim a serviços de saúde ou profissionais, e tendo em vista as definições de comércio varejista e de comércio atacadista conforme Resolução CONCLA nº 3, de 16/05/2007, a atividade pretendida não se caracteriza como comércio varejista. A empresa deverá obter de Autorização de Funcionamento para a atividade de distribuição.  
EMPRESA: MARVEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. ME  
ENDEREÇO: ALAMEDA DA VARZEA, 819  
BAIRRO: PALMARES CEP: 26950000 - PATY DO ALFERES/RJ  
CNPJ: 10.298.038/0001-46  
PROCESSO: 25351.075372/2011-11  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Considerando a natureza dos produtos, os quais não são destinados ao público em geral e sim a serviços de saúde ou profissionais, e tendo em vista as definições de comércio varejista e de comércio atacadista conforme Resolução CONCLA nº 3, de 16/05/2007, a atividade pretendida não se caracteriza como comércio varejista. A empresa deverá peticionar solicitação de Autorização de Funcionamento para a atividade de distribuição.  
EMPRESA: CAITHEC INDUSTRIAL LTDA EPP  
ENDEREÇO: R DOS VEREADORES, 87  
BAIRRO: ITROUPAVA CEP: 89160000 - RIO DO SUL/SC  
CNPJ: 08.053.383/0001-78  
PROCESSO: 25024.001243/2006-11  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Fica indeferida a alteração peticionada em razão da empresa ter solicitado a Ampliação ou Redução de atividades de Saneantes Domissanitários porém, a empresa não possui Autorização de Funcionamento (AFE) para a fabricação destes produtos. Portanto, deve a empresa primeiramente encaminhar o Peticionamento de Concessão de AFE correspondente.  
EMPRESA: CONTROLL PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, 193  
BAIRRO: SANTA CRUZ CEP: 13974345 - ITAPIRA/SP  
CNPJ: 11.144.448/0001-03  
PROCESSO: 25351.786720/2010-16  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O indeferimento se dá em razão do não cumprimento da Notificação de Exigência Nº 122067/11, exarada em 21/01/2011, conforme determina o Art 7º. da Resolução 204/2005.  
EMPRESA: J. F. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CLINICOS E HOSPITALARES LTDA  
ENDEREÇO: AV. MARINGÁ 813 - SALA 102  
BAIRRO: JD DOM BOSCO CEP: 86060000 - LONDRINA/PR  
CNPJ: 11.993.063/0001-02  
PROCESSO: 25023.170107/2010-16  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: O Indeferimento se dá Pelo não cumprimento da Notificação de Exigência Nº 121332/11, exarada em 20/01/2011, conforme determina o Art 7º. da Resolução 204/2005.  
EMPRESA: CARDIOSERVICE COMERCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA  
ENDEREÇO: AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 4009 - EDF. EMPIRE CENTER S/205  
BAIRRO: PITUBA CEP: 40280000 - SALVADOR/BA  
CNPJ: 13.434.626/0001-58  
PROCESSO: 25351.010508/2011-25  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Considerando a natureza dos produtos, os quais não são destinados ao público em geral e sim a serviços de saúde ou profissionais, e tendo em vista as definições de comércio varejista e de comércio atacadista conforme Resolução CONCLA nº 3, de 16/05/2007, informamos que a partir do momento que a empresa solicitou ampliação de atividade para Distribuir Produtos para Saúde, automaticamente ela deixa de ser Varejista, passando então à Distribuidor Atacadista. Também não foi apresentado o relatório de inspeção conclusivo emitido pela Vigilância Sanitária Local atestando o funcionamento da empresa.  
EMPRESA: BRASILTRANS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA  
ENDEREÇO: Av. Senador Salgado Filho, 7161  
BAIRRO: UBERABA CEP: 81580000 - CURITIBA/PR  
CNPJ: 06.083.685/0001-63  
PROCESSO: 25351.309094/2010-28  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Pelo não cumprimento da Exigência Técnica 997397/10 encaminhada em 09/06/2010, de acordo com o estabelecido no art. 7º da resolução RDC nº 204/05.  
EMPRESA: IPAMED PRODUTOS ODÓNTOS MÊDICOS LTDA  
ENDEREÇO: AV. CASTELO BRANCO, 286, LOJA D  
BAIRRO: HORTO CEP: 35160294 - IPATINGA/MG  
CNPJ: 03.018.125/0001-37  
PROCESSO: 25351.719171/2010-32  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: A relação dos produtos comercializados pela empresa indica fornecimento para estabelecimentos assistenciais de saúde, configurando atividade de comércio atacadista, não estando compreendidos no CNAE constante no CNPJ da em-

presa, o horário de prestação de assistência técnica é inadequado e o relatório de inspeção não se refere ao comércio varejista.  
EMPRESA: DENTAL TOOLS LTDA ME  
ENDEREÇO: RUA NEREU RAMOS 1433 E SALA 4 ED. BRASIL  
BAIRRO: CENTRO CEP: 89801022 - CHAPECÓ/SC  
CNPJ: 12.362.360/0001-12  
PROCESSO: 25351.058357/2011-34  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Considerando a natureza dos produtos, os quais não são destinados ao público em geral e sim a serviços de saúde ou profissionais de Saúde e tendo em vista as definições de comércio varejista e de comércio atacadista conforme Resolução CONCLA nº 3, de 16/05/2007, a atividade pretendida não se caracteriza como comércio varejista. A empresa deverá peticionar solicitação de concessão de Autorização de Funcionamento para a atividade de distribuição de Produtos para a Saúde (correlatos).  
EMPRESA: L. S. DE S. SILVA  
ENDEREÇO: AV. NOE MENDES CASA 11/A QUADRA 284  
BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE II CEP: 64077100 - TERESINA/PI  
CNPJ: 08.374.271/0001-19  
PROCESSO: 25351.109065/2010-36  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: não cumprimento da Notificação de Exigência Nº 940092/10, exarada em 10/03/2010.  
EMPRESA: DENTAL BELA COMERCIO DE MATERIAL ODONTOLOGICO LTDA - ME  
ENDEREÇO: RUA DO OUVIDOR 130 2 ANDAR SOBRELOJA 213  
BAIRRO: CENTRO CEP: 20040030 - RIO DE JANEIRO/RJ  
CNPJ: 12.304.105/0001-13  
PROCESSO: 25351.805384/2010-44  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Considerando a natureza dos produtos, os quais não são destinados ao público em geral e sim a serviços de saúde ou profissionais, e tendo em vista as definições de comércio varejista e de comércio atacadista conforme Resolução CONCLA nº 3, de 16/05/2007, a atividade pretendida não se caracteriza como comércio varejista. A empresa deverá peticionar solicitação de Autorização de Funcionamento para a atividade de distribuição.  
EMPRESA: RS MÉDICA LTDA  
ENDEREÇO: EDMUNDO BASTIAN, 116  
BAIRRO: CRISTO REDENTOR CEP: 91040050 - PORTO ALEGRE/RS  
CNPJ: 05.157.606/0001-59  
PROCESSO: 25025.035890/2010-55  
MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Considerando a natureza dos produtos, os quais não são destinados ao público em geral e sim a serviços de saúde ou profissionais, e tendo em vista as definições de comércio varejista e de comércio atacadista conforme Resolução CONCLA nº 3, de 16/05/2007, a atividade pretendida não se caracteriza como comércio varejista. A empresa deverá peticionar solicitação de Autorização de Funcionamento para a atividade de distribuição.

#### RESOLUÇÃO-RE Nº 1.011, DE 10 DE MARÇO DE 2011

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 26 de agosto de 2010, do Presidente da República, publicado no DOU de 27 de agosto de 2010, o inciso VIII do art. 15, o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 29, de 11 de janeiro de 2011, considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 354, de 2006, resolve:

Art. 1º Conceder Alteração na Autorização de Funcionamento de Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA

ANEXO

EMPRESA: BIOSANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA  
ENDEREÇO: AVENIDA THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1327  
BAIRRO: DIST. INDL. HUGO PARIN CEP: 84990000 - ARAPOTI/PR  
CNPJ: 06.143.681/0001-23  
PROCESSO: 25023.000023/2005-08 AUTORIZ/MS: K695LHM6WW27 (8.02860.0)  
ATIVIDADE/CLASSE  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
FABRICAR: CORRELATOS  
IMPORTAR: CORRELATOS  
TRANSPORTAR: CORRELATOS  
EMPRESA: CAITHEC INDUSTRIAL LTDA EPP  
ENDEREÇO: R DOS VEREADORES, 87  
BAIRRO: ITROUPAVA CEP: 89160000 - RIO DO SUL/SC  
CNPJ: 08.053.383/0001-78  
PROCESSO: 25024.001243/2006-11 AUTORIZ/MS: U35780312707 (8.04033.6)  
ATIVIDADE/CLASSE  
ARMAZENAR: CORRELATO  
DISTRIBUIR: CORRELATO  
EMBALAR: CORRELATO  
EXPEDIR: CORRELATO



FABRICAR: CORRELATO  
 REEMBALAR: CORRELATO  
 EMPRESA: PROCIFARMED PRODUTOS CIRÚRGICOS E FARMACÊUTICOS LTDA  
 ENDEREÇO: RUA BARTOLOMEU PAES, Nº501  
 BAIRRO: VILA ANASTÁCIO CEP: 05092000 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 64.639.719/0001-50  
 PROCESSO: 25351.626509/2007-11 AUTORIZ/MS:  
 XLX3Y7W16584 (8.04165.2)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EXPEDIR: CORRELATO  
 EMPRESA: GIROMED CIRURGICA LTDA  
 ENDEREÇO: R DARIO FREIRE MEIRELLES, 845  
 BAIRRO: CAMPO DOS AMARAIAS CEP: 13082045 - CAMPINAS/SP  
 CNPJ: 74.442.468/0001-72  
 PROCESSO: 25351.063502/2005-13 AUTORIZ/MS:  
 4W34LYL7LX18 (8.02407.6)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EXPEDIR: CORRELATO  
 TRANSPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: NIDEX EYECARE DO BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS OPTICOS LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA JABAQUARA, 2819 - CONJUNTO 29  
 BAIRRO: MIRANDÓPOLIS CEP: 04045004 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 09.632.380/0001-51  
 PROCESSO: 25351.026788/2010-14 AUTORIZ/MS:  
 P2L8696W7979 (8.06250.8)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 IMPORTAR: CORRELATOS  
 EMPRESA: PHARMA LINK ADMINISTRADORA DE REDES E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305  
 BAIRRO: CAMPO DOS AMARAIAS CEP: 13082040 - CAMPINAS/SP  
 CNPJ: 05.347.060/0001-07  
 PROCESSO: 25351.058261/2010-19 AUTORIZ/MS:  
 PLY4L95MW65X (8.06144.2)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 IMPORTAR: CORRELATOS  
 TRANSPORTAR: CORRELATOS  
 EMPRESA: SILICONE : INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILICONE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS, CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA  
 ENDEREÇO: RUA JOSE MENDES SOBRINHO 536  
 BAIRRO: CIC CEP: 81350320 - CURITIBA/PR  
 CNPJ: 07.439.473/0001-39  
 PROCESSO: 25023.021005/2006-32 AUTORIZ/MS:  
 P4L65232WLH3 (8.03598.2)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EMBALAR: CORRELATO  
 EXPEDIR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 FABRICAR: CORRELATO  
 TRANSPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: BIONEXT PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA MAGALHÃES CASTRO 286  
 BAIRRO: BUTANTA CEP: 05502000 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 05.423.767/0001-47  
 PROCESSO: 25351.206801/2005-41 AUTORIZ/MS:  
 UHH44W1Y3549 (8.02551.2)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 FABRICAR: CORRELATO  
 EMPRESA: CASA BRASIL IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA  
 ENDEREÇO: RUA DR. QUIRINO, Nº 1562  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 13015082 - CAMPINAS/SP  
 CNPJ: 09.334.788/0001-47  
 PROCESSO: 25351.810889/2008-45 AUTORIZ/MS:  
 UY789WL63990 (8.04928.9)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 IMPORTAR: CORRELATOS  
 TRANSPORTAR: CORRELATOS  
 EMPRESA: STRATA MEDICAL DO BRASIL LTDA  
 ENDEREÇO: AV GUPE Nº 10767 - GALPÃO 17 SALA 03  
 BAIRRO: JARDIM BELVAL CEP: 06422120 - BARUERI/SP  
 CNPJ: 05.156.131/0001-86  
 PROCESSO: 25351.011430/2003-59 AUTORIZ/MS:  
 POW4W518X7M4 (8.01564.1)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO, Nº 3862  
 BAIRRO: VIVENDAS DO BOSQUE CEP: 79021003 - CAMPO GRANDE/MS

CNPJ: 33.761.636/0001-05  
 PROCESSO: 25351.059715/2010-66 AUTORIZ/MS:  
 4WH125HW9612 (8.05953.1)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EXPEDIR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: EXPORT TRADING S/A  
 ENDEREÇO: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS Nº 3.290  
 BAIRRO: RIO BRANCO CEP: 93320020 - NOVO HAMBURGO/RS  
 CNPJ: 05.351.252/0001-89  
 PROCESSO: 25351.194875/2008-70 AUTORIZ/MS:  
 UYY497MHYWY7 (8.04401.7)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EXPEDIR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: ROSS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 505  
 BAIRRO: FRANCISCO BERNARDINO CEP: 36083750 - JUIZ DE FORA/MG  
 CNPJ: 08.747.635/0001-69  
 PROCESSO: 25351.358925/2007-72 AUTORIZ/MS:  
 U4M7YX7W9634 (8.04003.2)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EXPEDIR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: VISIONMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  
 ENDEREÇO: RUA ARTHUR AZEVEDO, 1767, CJ. 65/67  
 BAIRRO: PINHEIROS CEP: 05404014 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 02.960.756/0001-08  
 PROCESSO: 25351.016659/2003-80 AUTORIZ/MS:  
 G1W2MLX5L654 (8.01702.8)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: ODHON INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA - EPP  
 ENDEREÇO: RUA MIGUEL PETRONI, 1826  
 BAIRRO: JARDIM BANDEIRANTES CEP: 13562190 - SÃO CARLOS/SP  
 CNPJ: 10.285.608/0001-63  
 PROCESSO: 25351.158008/2009-88 AUTORIZ/MS:  
 PX5920HL3XXY (8.05145.0)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 FABRICAR: CORRELATOS  
**EMPRESA: STARKEY DO BRASIL LTDA**  
**ENDEREÇO: RUA FERNÃO POMPEU DE CAMARGO Nº 832**  
**BAIRRO: JARDIM LEONOR CEP: 13041025 - CAMPINAS/SP**  
**CNPJ: 04.216.059/0001-72**  
**PROCESSO: 25351.057032/2003-89 AUTORIZ/MS:**  
**P5Y32W0XL65M (8.01791.5)**  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 EXPEDIR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 FABRICAR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA  
 ENDEREÇO: AV. SÃO PEDRO, Nº 409  
 BAIRRO: SAO GERALDO CEP: 90230120 - PORTO ALEGRE/RS  
 CNPJ: 08.232.826/0001-98  
 PROCESSO: 25025.054869/2008-89 AUTORIZ/MS: KL77WX-  
 XY6435 (8.05411.8)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 EMPRESA: JULIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA  
 ENDEREÇO: RUA MOJU, Nº 204, SALA 01  
 BAIRRO: SÃO GERALDO CEP: 31050680 - BELO HORIZONTE/MG  
 CNPJ: 26.291.237/0001-62  
 PROCESSO: 25351.483874/2009-92 AUTORIZ/MS:  
 9H717Y762H39 (8.06344.3)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 EMPRESA: VITABAHIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA  
 ENDEREÇO: RUA MINISTRO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 222 - Q H - L 55A - V. DAS CASTANHEIRAS  
 BAIRRO: BURÁQUINHO CEP: 42700000 - LAURO DE FREITAS/BA  
 CNPJ: 07.046.809/0001-01  
 PROCESSO: 25022.002775/2006-96 AUTORIZ/MS:  
 U866L86W5X81 (8.03458.9)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO

DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EXPEDIR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA - EPP  
 ENDEREÇO: RUA BARONESA DE BELA VISTA 346  
 BAIRRO: VILA CONGONHAS CEP: 04612001 - SÃO PAULO/SP  
 CNPJ: 66.969.262/0001-77  
 PROCESSO: 25000.017977/95-40 AUTORIZ/MS: 1.02870.7  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 FABRICAR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA  
 ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO PIOVESAN Nº 155  
 BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL BETEL CEP: 86075142 - LONDRINA/PR  
 CNPJ: 00.339.246/0001-92  
 PROCESSO: 25023.170125/97-00 AUTORIZ/MS: 1.03338.7  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATO  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 TRANSPORTAR: CORRELATO  
 EMPRESA: MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP  
 ENDEREÇO: RUA PAULO DE FRONTIM 275  
 BAIRRO: VILA VIRGINIA CEP: 1403043 - RIBEIRÃO PRETO/SP  
 CNPJ: 58.061.557/0001-12  
 PROCESSO: 25004.005129/95 AUTORIZ/MS: 1.03093.1  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 DISTRIBUIR: CORRELATO  
 EMBALAR: CORRELATO  
 EXPORTAR: CORRELATO  
 FABRICAR: CORRELATO  
 IMPORTAR: CORRELATO  
 PRODUZIR: CORRELATO  
 EMPRESA: RODOVIÁRIO RAMOS LTDA  
 ENDEREÇO: RODOVIA BR 324 S/Nº, Km 7,5  
 BAIRRO: PIRAJÁ CEP: 41290550 - SALVADOR/BA  
 CNPJ: 25.100.223/0001-51  
 PROCESSO: 633490272 AUTORIZ/MS: 8.01063.0  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: CORRELATO

## RESOLUÇÃO-RE Nº 1.012, DE 10 DE MARÇO DE 2011

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 26 de agosto de 2010, do Presidente da República, publicado no DOU de 27 de agosto de 2010, o inciso VIII do art. 15, o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria n.º 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria n.º 29, de 11 de janeiro de 2011, considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA

## ANEXO

EMPRESA: L. M. DE SOUSA RODRIGUES - ME  
 ENDEREÇO: RUA RIO BRANCO, 185  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 15800230 - CATANDUVA/SP  
 CNPJ: 11.578.756/0001-39  
 PROCESSO: 25351.031301/2011-06 AUTORIZ/MS:  
 G78X3X3HW896 (8.07235.3)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 ARMAZENAR: CORRELATOS  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EXPEDIR: CORRELATOS  
 EMPRESA: DIAGGOIAS DIAGNÓSTICOS CIENTÍFICOS LTDA ME  
 ENDEREÇO: AV. CASTELO BRANCO, Nº 1101, QUADRA 10, LOTE 90  
 BAIRRO: SETOR COIMBRA CEP: 74455050 - GOIÂNIA/GO  
 CNPJ: 04.679.172/0001-94  
 PROCESSO: 25351.736731/2010-07 AUTORIZ/MS: U1442647L98  
 (8.07225.9)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 DISTRIBUIR: CORRELATOS  
 EMPRESA: MARCIANO ENCOMENDAS URGENTES LTDA - ME  
 ENDEREÇO: AV. ETIÓPIA, 539  
 BAIRRO: VL MORELATTO CEP: 06408030 - BARUERI/SP  
 CNPJ: 10.174.344/0001-70  
 PROCESSO: 25351.044549/2011-07 AUTORIZ/MS:  
 P049826HXX2M (8.07234.0)  
 ATIVIDADE/CLASSE  
 TRANSPORTAR: CORRELATOS  
 EMPRESA: MIGMAG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

## ANEXO IV –DECLARAÇÕES

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES.**

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024/SES/MT.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGADOC Nº SES-PRO-2023/00100**

Starkey do Brasil Ltda, CNPJ Nº. 04.216.059/0001-72, sediada na Rua Fernão Pompeu de Camargo, nº 832, bairro Jardim Leonor, CEP 13041-025, Campinas/SP, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da presente licitação, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

- Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;
- Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Declaração de que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- Declaração da própria empresa de que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Estadual exercendo funções de gerência ou administração, conforme art. 1º, inciso X da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ou servidor da Credenciante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.
- Declaração de que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com a Credenciante.
- Declaração para fins do disposto no inciso VI, art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.

Campinas, 09 de julho de 2024.

TATIANA CAMILA DA ROSA  
TOBIAS:226[REDACTED]2893

Assinado de forma digital por TATIANA CAMILA DA ROSA TOBIAS:226[REDACTED]402893  
Dados: 2024.07.09 14:27:01 -03'00'

**Assinatura do representante legal da pessoa jurídica**

Nome: Tatiana Camila da Rosa Tobias

RG 29.[REDACTED]66-8 e CPF: 226[REDACTED]28-93

---

**Starkey do Brasil Ltda - CNPJ 04.216.059/0001-72**

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 832

Jd. Leonor, Campinas/SP, 13041-025

0800 772 0654



---

**Starkey do Brasil Ltda - CNPJ 04.216.059/0001-72**

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 832

Jd. Leonor, Campinas/SP, 13041-025

0800 772 0654



## ANEXO II – CARTA DE CREDENCIAMENTO

A

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024/SES/MT.

Starkey do Brasil Ltda, devidamente inscrita sob o CNPJ Nº. 04.216.059/0001-72, com sede na Rua Fernão Pompeu de Camargo, nº 832, bairro Jardim Leonor, CEP 13041-025, Campinas/SP, representada neste ato por seu representante legal Procuradora, Tatiana C R Tobias, vem requerer a Vossa Senhoria sua habilitação no Credenciamento nº 03/2024, com vistas o **Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas para fornecimento de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) customizado (intraauriculares, intracanaís, microcanaís), AASI retroauriculares e Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM)**”.

Declaramos que aceitamos os valores e condições estabelecidas conforme Edital.

Campinas, 09 de julho de 2024.

TATIANA CAMILA DA ROSA  
TOBIAS:22[REDACTED]02893

Assinado de forma digital por TATIANA  
CAMILA DA ROSA TOBIAS:22[REDACTED]2893  
Dados: 2024.07.09 14:29:05 -03'00'

**Assinatura do representante legal da pessoa jurídica**

Nome: Tatiana Camila da Rosa Tobias

RG 29.[REDACTED]66-8 e CPF: 22[REDACTED].028-93

ANEXO V – REQUERIMENTO PARA CREDENCIAR NO CHAMAMENTO PÚBLICO

A

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024/SES/MT.

Starkey do Brasil Ltda, devidamente inscrita sob o CNPJ Nº. 04.216.059/0001-72, com sede na Rua Fernão Pompeu de Camargo, nº 832, bairro Jardim Leonor, CEP 13041-025, Campinas/SP, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, residente e domiciliado em Valinhos/SP, através do presente instrumento, vêm requerer o credenciamento para o **CHAMAMENTO PÚBLICO nº. \_03/2024**, visando a **“Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas para fornecimento de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) customizado (intraauriculares, intracanaís, microcanaís), AASI retroauriculares e Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM).**

Declaro que assumo o compromisso de prestar os serviços nas condições e preços preestabelecidos pela SES/MT, para atender o Contrato de Credenciamento.

Campinas, 09 de julho de 2024.

TATIANA CAMILA DA ROSA  
TOBIAS:2[REDACTED]893

Assinado de forma digital por  
TATIANA CAMILA DA ROSA  
TOBIAS:2[REDACTED]893  
Dados: 2024.07.09 14:31:02  
-03'00'

**Assinatura do representante legal da pessoa jurídica**

Nome: Tatiana Camila da Rosa Tobias

RG 29.[REDACTED].266-8 e CPF: 2[REDACTED]8-93

	Savant AI			
<b>Características:</b>	AI 1000			
Plataforma: Thrive	●			
Aplicativo: Thrive	●			
Aplicativo: Thrive Care	●			
Canais   Bandas	10			
Largura de banda	8 kHz			
4 Programas de conforto	●			
Rebaixamento de frequência	●			
Cancelamento de feedback	●			
Modo Edge: Controle por toque				
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive				
Compatibilidade OrCam				
Voice AI*				
REM Medida de Orelha Real	●			
<b>Healthables:</b>				
Monitoramento de atividade	●			
Monitoramento de engajamento				
Alerta de queda	●			
<b>Sistema de telessaúde:</b>				
TeleHear	●			
<b>Gerenciador de som:</b>				
Melhoria de fala espacial				
<i>Fala em ruído</i>	1	2	3	4
<i>Máquina</i>	1	2	3	4
<i>Vento</i>	1	2	3	4
<i>Silêncio</i>	1	2	3	4
<i>Transientes</i>	1	2	3	4
<b>Assistentes pessoais:</b>				
Assistente Thrive c/ comando de voz				
Tradução**				
Transcrição				
Autoverificação	●			
Controle por toque	●			
Auto On/Off	●			
Lembretes	●			
Mãos livres*	●			
Encontre meu celular				
<b>Tecnologia de telefone:</b>				
Telefone orelha-a-orelha				
<b>Melhoria de música:</b>				
Memória de música				
<b>Direcionalidade:</b>				
Adaptativo				
Dinâmico	●			
Omnidirecional	●			
Direcional	●			
<b>Tecnologia de zumbido:</b>				
Zumbido Multiflex	●			
Zumbido Multiflex Pro				
<b>Compatibilidade com acessórios:</b>				
Acessórios 2.4 GHz	●			

\*Disponível somente para sistemas iOS.  
\*\*Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Savant AI



CIC


Microcanal sem fio

Tecnologias disponíveis

Savant AI 1000

Faixa de adaptação

- CIC 40
- CIC 50
- CIC 60
- CIC 70

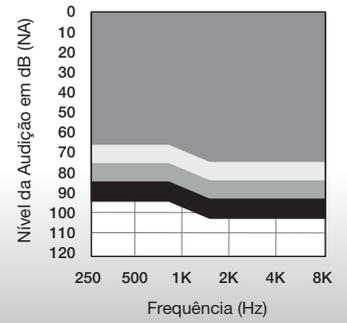

**Guia de cores\*\***

Cores do faceplate



Cores da cápsula



**Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz**

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

**Recursos para o paciente**

- Tecnologia de zumbido
- Conectividade sem fio

**Tecnologia Savant AI**

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	40 de ganho	50 de ganho	60 de ganho	70 de ganho	Matrizes: 110/40, 115/50, 120/60, 130/70	Tamanho da bateria: 312
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------------------

**Medidas**

	ANSI/IEC 2cc	IEC OES						
	Acoplador	Acoplador	Acoplador	Acoplador	Acoplador	Acoplador	Acoplador	Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	110	120	115	125	120	130	130	137
MAF NPSS90 (dB NPS)	106	N/A	109	N/A	113	N/A	123	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	113	N/A	117	N/A	122	N/A	131
Pico de ganho (dB)	40	50	50	62	60	70	70	78
MAF GAM (dB)	36	N/A	46	N/A	53	N/A	63	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	44	N/A	55	N/A	62	N/A	71

**Faixa de frequência (Hz)**

	<100-7800	<100-8000	<100-7800	<100-7800	<100-7000	<100-7200	<100-5500	<100-6000
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	N/A	1.6	46	55
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A						
Ganho no teste de referência (dB)	28	37	32	42	36	48	46	55
Entrada de ruído equivalente (dB)	25	N/A	25	N/A	25	N/A	25	N/A

**Distorção harmônica**

500 Hz (%)	2	2	2	2	2	2	2	2
800 Hz (%)	2	2	2	2	2	2	2	2
1600 Hz (%)	1	2	1	2	1	2	2	2
3200 Hz (%)	1	1	1	1	1	1	1	1

**Sensibilidade da bobina de indução**





HFA SPLITS (ANSI) (dB NPS)	N/A							
MASL (IEC) (dB NPS)	N/A							
SEBI	N/A							

**Vida da bateria estimada em 16hs/dia**

312 Zinco Ar (dias)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	3-6*	3-6*
---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Estímulo para terapia do zumbido**

Saída Máx RMS (dB NPS)	87	87	87	87	87	87	87	87
Nível da Saída Máx RMS Medido (dB NPS)	87	87	87	87	87	87	87	87
Saída Máx de 1/3 da Oitava (dB NPS)	87	87	87	87	87	87	87	87

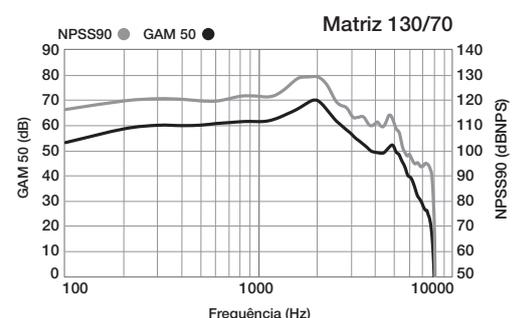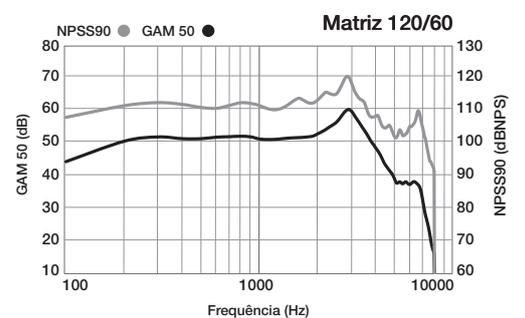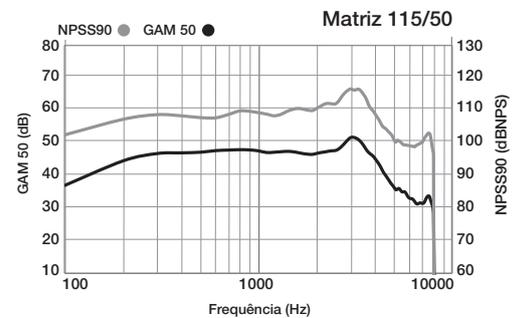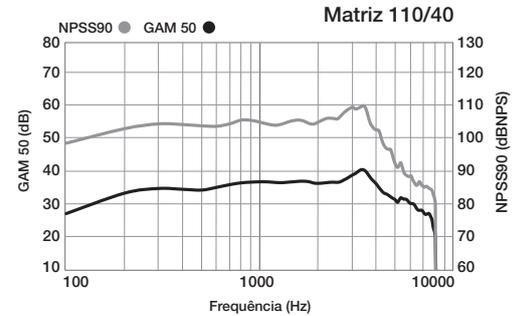

\*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.  
\*\*Consulte disponibilidade de cores.

	Savant AI			
	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
<b>Características:</b>				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●
Canais   Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
Modo Edge: Controle por toque	●			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●	
Compatibilidade OrCam	●			
Voice AI*	●			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
<b>Healthables:</b>				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●
Alerta de queda	●	●	●	●
<b>Sistema de telessaúde:</b>				
TeleHear	●	●	●	●
<b>Gerenciador de som:</b>				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
<i>Fala em ruído</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Máquina</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Vento</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Silêncio</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Transientes</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Música automática</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<b>Assistentes pessoais:</b>				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●	
Tradução**	●			
Transcrição	●	●		
Autoverificação	●	●	●	●
Controle por toque	●	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●	●
Lembretes	●	●	●	●
Mãos livres*	●	●	●	●
Encontre meu celular	●	●	●	
<b>Tecnologia de telefone:</b>				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●	
<b>Melhoria de música:</b>				
Memória de música	●	●	●	
<b>Direcionalidade:</b>				
Adaptativo	●	●	●	●
Dinâmico	●	●	●	●
Omnidirecional	●	●	●	●
Direcional	●	●	●	●
<b>Tecnologia de zumbido:</b>				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
<b>Compatibilidade com acessórios:</b>				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●

\*Disponível somente para sistemas iOS.  
\*\*Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Savant AI



CIC


Microcanal sem fio

Tecnologias disponíveis

Savant AI 1200

Faixa de adaptação

- CIC 40
- CIC 50
- CIC 60
- CIC 70

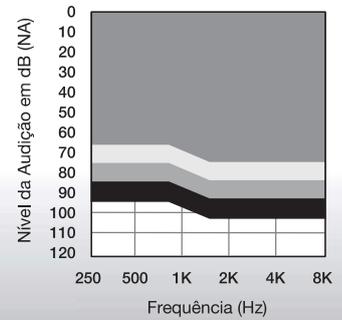

**Guia de cores\*\***

Cores do faceplate



Cores da cápsula



**Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz**

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

**Recursos para o paciente**

- Tecnologia de zumbido
- Conectividade sem fio

**Tecnologia Savant AI**

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	40 de ganho	50 de ganho	60 de ganho	70 de ganho	Matrizes: 110/40, 115/50, 120/60, 130/70 Tamanho da bateria: 312
--	-------------	-------------	-------------	-------------	---

**Medidas**

	ANSI/IEC 2cc	IEC OES						
	Acoplador	Acoplador	Acoplador	Acoplador	Acoplador	Acoplador	Acoplador	Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	110	120	115	125	120	130	130	137
MAF NPSS90 (dB NPS)	106	N/A	109	N/A	113	N/A	123	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	113	N/A	117	N/A	122	N/A	131
Pico de ganho (dB)	40	50	50	62	60	70	70	78
MAF GAM (dB)	36	N/A	46	N/A	53	N/A	63	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	44	N/A	55	N/A	62	N/A	71

**Faixa de frequência (Hz)**

	<100-7800	<100-8000	<100-7800	<100-7800	<100-7000	<100-7200	<100-5500	<100-6000
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	N/A	1.6	46	55
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A						
Ganho no teste de referência (dB)	28	37	32	42	36	48	46	55
Entrada de ruído equivalente (dB)	25	N/A	25	N/A	25	N/A	25	N/A

**Distorção harmônica**

500 Hz (%)	2	2	2	2	2	2	2	2
800 Hz (%)	2	2	2	2	2	2	2	2
1600 Hz (%)	1	2	1	2	1	2	2	2
3200 Hz (%)	1	1	1	1	1	1	1	1

**Sensibilidade da bobina de indução**

HFA SPLITS (ANSI) (dB NPS)	N/A							
MASL (IEC) (dB NPS)	N/A							
SEBI	N/A							


**Vida da bateria estimada em 16hs/dia**

312 Zinco Ar (dias)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	3-6*	3-6*
---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Estímulo para terapia do zumbido**

Saída Máx RMS (dB NPS)	87	87	87	87	87	87	87	87
Nível da Saída Máx RMS Medido (dB NPS)	87	87	87	87	87	87	87	87
Saída Máx de 1/3 da Oitava (dB NPS)	87	87	87	87	87	87	87	87

\*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.  
\*\*Consulte disponibilidade de cores.

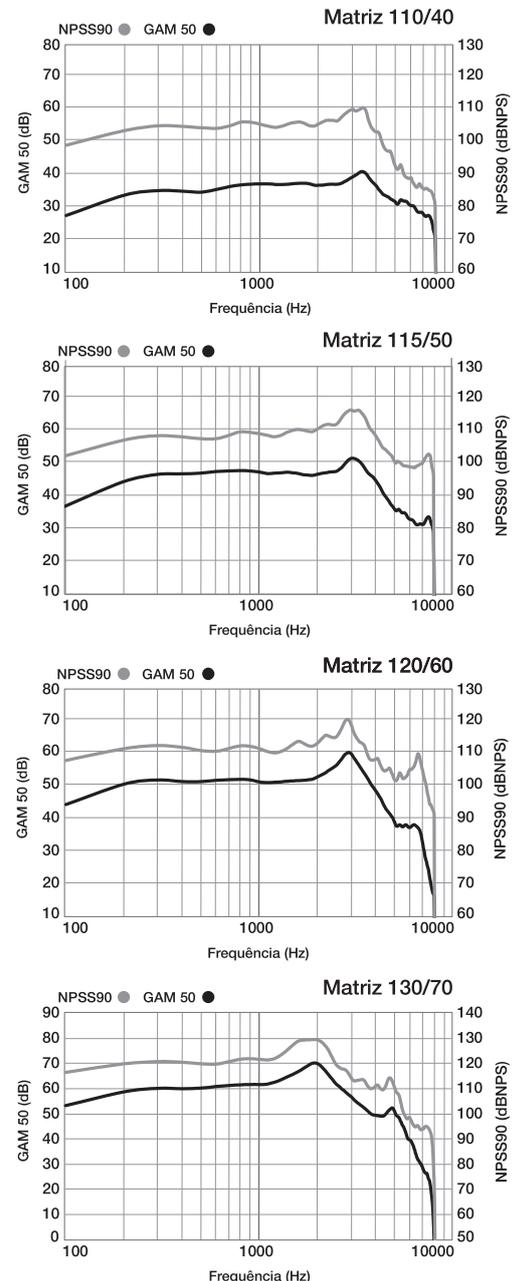

	Savant AI			
	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
<b>Características:</b>				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●
Canais   Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
Modo Edge: Controle por toque	●			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●	
Compatibilidade OrCam	●			
Voice AI*	●			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
<b>Healthables:</b>				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●
Alerta de queda	●	●	●	●
<b>Sistema de telessaúde:</b>				
TeleHear	●	●	●	●
<b>Gerenciador de som:</b>				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
<i>Fala em ruído</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Máquina</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Vento</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Silêncio</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Transientes</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Música automática</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<b>Assistentes pessoais:</b>				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●	
Tradução**	●			
Transcrição	●	●		
Autoverificação	●	●	●	●
Controle por toque	●	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●	●
Lembretes	●	●	●	●
Mãos livres*	●	●	●	●
Encontre meu celular	●	●	●	
<b>Tecnologia de telefone:</b>				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●	
<b>Melhoria de música:</b>				
Memória de música	●	●	●	
<b>Direcionalidade:</b>				
Adaptativo	●	●	●	●
Dinâmico	●	●	●	●
Omnidirecional	●	●	●	●
Direcional	●	●	●	●
<b>Tecnologia de zumbido:</b>				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
<b>Compatibilidade com acessórios:</b>				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●

\*Disponível somente para sistemas iOS.  
\*\*Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Savant AI




**CIC**  
Microcanal  
sem fio

Tecnologias  
disponíveis

Savant AI 2400 | 2000 | 1600

Faixa de adaptação

- CIC 40
- CIC 50
- CIC 60
- CIC 70

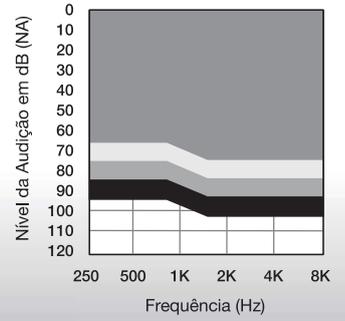

## Guia de cores\*\*

Cores do faceplate



Cores da cápsula



## Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

## Recursos para o paciente

- Tecnologia de zumbido
- Conectividade sem fio

## Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	40 de ganho	50 de ganho	60 de ganho	70 de ganho	Matrizes: 110/40, 115/50, 120/60, 130/70 Tamanho da bateria: 312
--	-------------	-------------	-------------	-------------	---

### Medidas

	ANSI/IEC 2cc	IEC OES						
	Acoplador	Acoplador	Acoplador	Acoplador	Acoplador	Acoplador	Acoplador	Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	110	120	115	125	120	130	130	137
MAF NPSS90 (dB NPS)	106	N/A	109	N/A	113	N/A	123	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	113	N/A	117	N/A	122	N/A	131
Pico de ganho (dB)	40	50	50	62	60	70	70	78
MAF GAM (dB)	36	N/A	46	N/A	53	N/A	63	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	44	N/A	55	N/A	62	N/A	71

### Faixa de frequência (Hz)

	<100-9400	<100-9700	<100-8500	<100-8900	<100-7000	<100-7200	<100-5500	<100-6000
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	N/A	1.6	46	55
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A						
Ganho no teste de referência (dB)	28	37	32	42	36	48	46	55
Entrada de ruído equivalente (dB)	25	N/A	25	N/A	25	N/A	25	N/A

### Distorção harmônica

500 Hz (%)	2	2	2	2	2	2	2	2
800 Hz (%)	2	2	2	2	2	2	2	2
1600 Hz (%)	1	2	1	2	1	2	2	2
3200 Hz (%)	1	1	1	1	1	1	1	1

### Sensibilidade da bobina de indução

HFA SPLITS (ANSI) (dB NPS)	N/A							
MASL (IEC) (dB NPS)	N/A							
SEBI	N/A							

### Vida da bateria estimada em 16hs/dia





312 Zinco Ar (dias)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	3-6*	3-6*
---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

### Estímulo para terapia do zumbido

Saída máx RMS (dB NPS)	87	87	87	87	87	87	87	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87	87	87	87	87	87	87	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87	87	87	87	87	87	87	87

\*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

\*\*Consulte disponibilidade de cores.

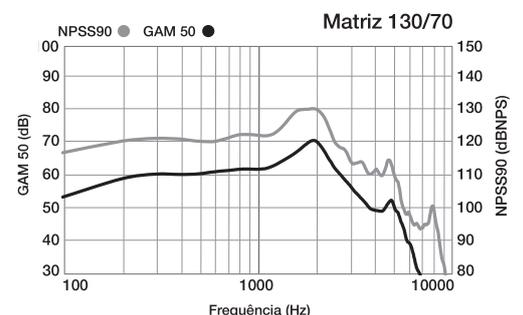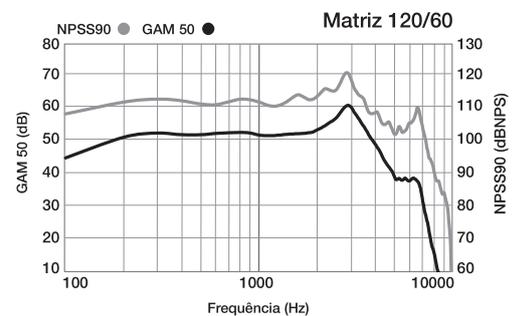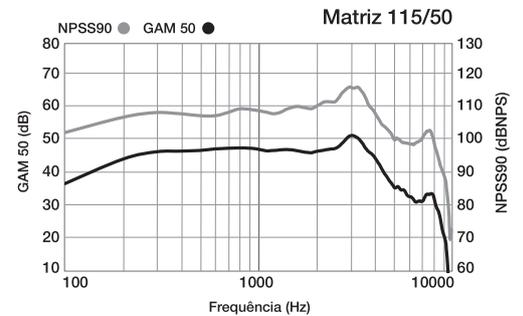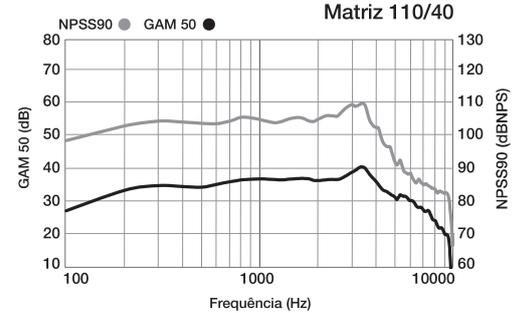

	Savant AI
<b>Características:</b>	AI 1000
Plataforma: Thrive	●
Aplicativo: T2 Remoto	●
Canais   Bandas	10
Largura de banda	8 kHz
4 Programas de conforto	●
Rebaixamento de frequência	●
Cancelamento de feedback	●
REM Medida de Orelha Real	●
<b>Gerenciador de som:</b>	
Melhoria de fala espacial	
<i>Fala em ruído</i>	1 2 3 4
<i>Máquina</i>	1 2 3 4
<i>Vento</i>	1 2 3 4
<i>Silêncio</i>	1 2 3 4
<i>Transientes</i>	1 2 3 4
<b>Melhoria de música:</b>	
Memória de música	
<b>Direcionalidade:</b>	
Omnidirecional	●
<b>Tecnologia de zumbido:</b>	
Zumbido Multiflex	●
Zumbido Multiflex Pro	
<b>Compatibilidade com acessórios:</b>	
Speed Port   HI-PRO	●

Savant AI




**CIC**  
Microcanal  
com fio

Tecnologias  
disponíveis

Savant AI 1000

Faixa de adaptação

- CIC 40
- CIC 50
- CIC 60
- CIC 70

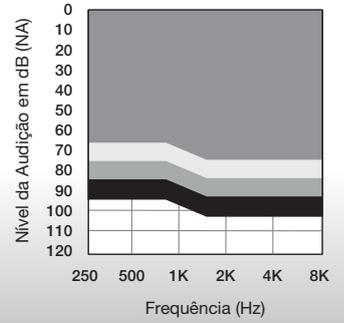

**Guia de cores\***

Cores do faceplate



Cores da cápsula



**Recursos para o paciente**

- Tecnologia de zumbido

	<b>Ganho CIC</b>	<b>Matrizes: 110/40, 115/50, 120/60, 130/70</b> <b>Tamanho da bateria: 10</b>
--	----------------------	--

**Medidas**

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	110-130	118-130
MAF NPSS90 (dB NPS)	106-124	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	110-130
Pico de ganho (dB)	40-70	51-71
MAF GAM (dB)	36-63	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	44-68

**Faixa de frequência (Hz)**

	<100-7800	<100-8000
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	29-47	35-55
Entrada de ruído equivalente (dB)	<25	<25

**Distorção harmônica**

	<3	<3
500 Hz (%)	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3

**Sensibilidade da bobina de indução**

	N/A	N/A
HFA SPLITS (ANSI) (dB NPS)	N/A	N/A
MASL (IEC) (dB NPS)	N/A	N/A
SEBI	N/A	N/A

**ANSI/IEC**





	1.1-1.3	1.1-1.3
Corrente da Bateria (mA)	1.1-1.3	1.1-1.3
Corrente em Repouso (mA)	1.0-1.1	1.0-1.1

**Vida da bateria estimada em 16hs/dia**

	7-10	7-10
312 Zinco Ar (dias)	7-10	7-10
10 Zinco Ar (dias)	4-7	4-7

**Estímulo para terapia do zumbido**

Saída máx RMS (dB NPS)	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87

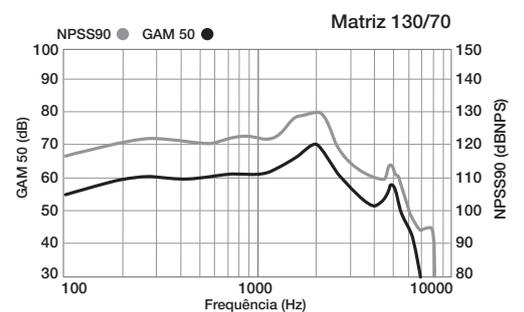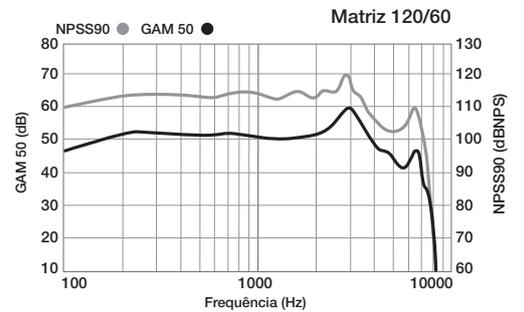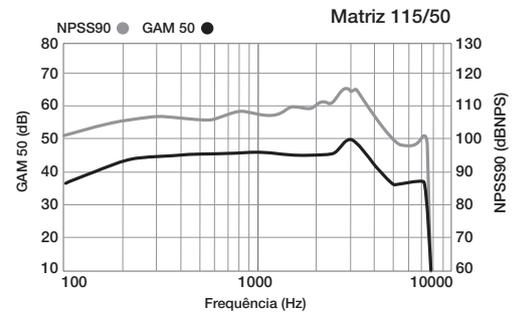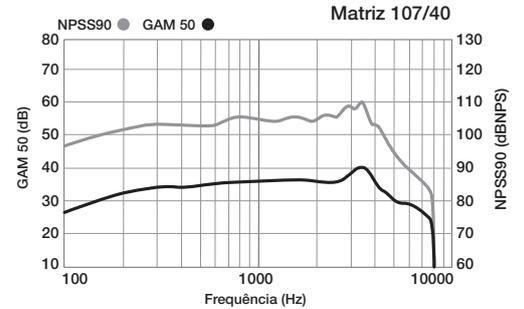

\*Consulte disponibilidade de cores.

Savant AI				
	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
<b>Características:</b>				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: T2 Remoto	●	●	●	●
Canais   Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
<b>Gerenciador de som:</b>				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
<i>Fala em ruído</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Máquina</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Vento</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Silêncio</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Transientes</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Musica automática</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<b>Melhoria de música:</b>				
Memória de música	●	●	●	
<b>Direcionalidade:</b>				
Omnidirecional	●	●	●	●
<b>Tecnologia de zumbido:</b>				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
<b>Programador:</b>				
Speed Port   HI-PRO	●	●	●	●

Savant AI



# CIC


Microcanal com fio

Tecnologias disponíveis

Savant AI 1200

## Faixa de adaptação

- CIC 40
- CIC 50
- CIC 60
- CIC 70

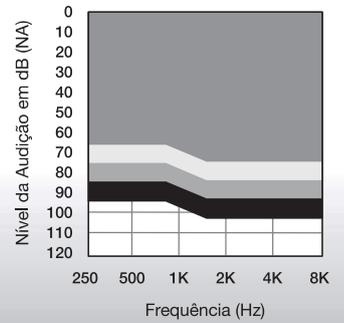

## Guia de cores\*

### Cores do faceplate



### Cores da cápsula



## Recursos para o paciente

- Tecnologia de zumbido

	Ganho CIC	Matrizes: 110/40, 115/50, 120/60, 130/70 Tamanho da bateria: 10
--	-----------	--

### Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	110-130	118-130
MAF NPSS90 (dB NPS)	106-124	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	110-130
Pico de ganho (dB)	40-70	51-71
MAF GAM (dB)	36-63	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	44-68

### Faixa de frequência (Hz)

	<100-7800	<100-8000
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	29-47	35-55
Entrada de ruído equivalente (dB)	<25	<25

### Distorção harmônica

	<3	<3
500 Hz (%)	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3

### Sensibilidade da bobina de indução

	N/A	N/A
HFA SPLITS (ANSI) (dB NPS)	N/A	N/A
MASL (IEC) (dB NPS)	N/A	N/A
SEBI	N/A	N/A

### ANSI/IEC





	1.1-1.3	1.1-1.3
Corrente da Bateria (mA)	1.1-1.3	1.1-1.3
Corrente em Repouso (mA)	1.0-1.1	1.0-1.1

### Vida da bateria estimada em 16hs/dia

	7-10	7-10
312 Zinco Ar (dias)	7-10	7-10
10 Zinco Ar (dias)	4-7	4-7

### Estímulo para terapia do zumbido

	87
Saída máx RMS (dB NPS)	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87

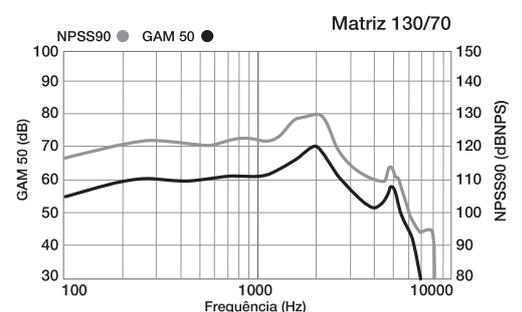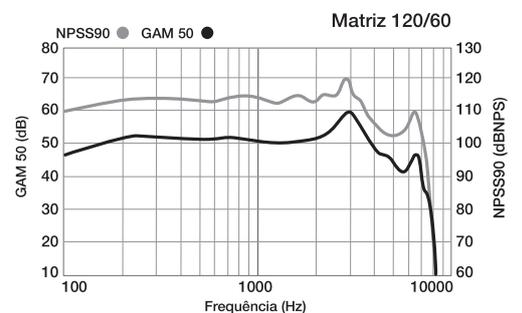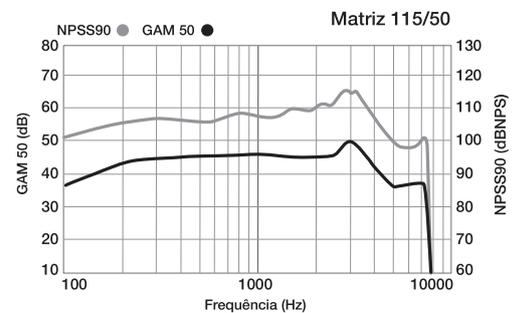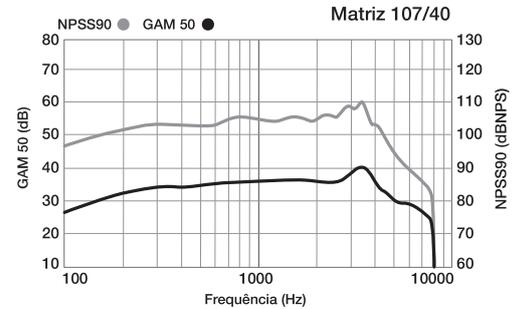

\*Consulte disponibilidade de cores.

Savant AI				
	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
<b>Características:</b>				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: T2 Remoto	●	●	●	●
Canais   Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
<b>Gerenciador de som:</b>				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
<i>Fala em ruído</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Máquina</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Vento</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Silêncio</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Transientes</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Musica automática</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<b>Melhoria de música:</b>				
Memória de música	●	●	●	
<b>Direcionalidade:</b>				
Omnidirecional	●	●	●	●
<b>Tecnologia de zumbido:</b>				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
<b>Programador:</b>				
Speed Port   HI-PRO	●	●	●	●

Savant AI




# CIC

Microcanal  
com fio

## Faixa de adaptação

- CIC 40
- CIC 50
- CIC 60
- CIC 70

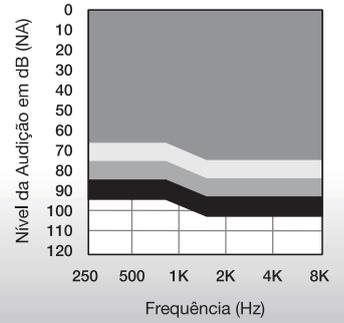

Tecnologias disponíveis

Savant AI 2400 | 2000 | 1600

### Guia de cores\*

Cores do faceplate



Cores da cápsula



### Recursos para o paciente

- Tecnologia de zumbido

## Ganho CIC

Matrizes: 110/40, 115/50, 120/60, 130/70  
Tamanho da bateria: 10

### Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	110-130	118-130
MAF NPSS90 (dB NPS)	106-124	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	110-130
Pico de ganho (dB)	40-70	51-71
MAF GAM (dB)	36-63	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	44-68

### Faixa de frequência (Hz)

	<100-9400	<100-9700
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	29-47	35-55
Entrada de ruído equivalente (dB)	<25	<25

### Distorção harmônica

	<3	<3
500 Hz (%)	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3

### Sensibilidade da bobina de indução

	N/A	N/A
HFA SPLITS (ANSI) (dB NPS)	N/A	N/A
MASL (IEC) (dB NPS)	N/A	N/A
SEBI	N/A	N/A

### ANSI/IEC





	1.1-1.3	1.1-1.3
Corrente da Bateria (mA)	1.1-1.3	1.1-1.3
Corrente em Repouso (mA)	1.0-1.1	1.0-1.1

### Vida da bateria estimada em 16hs/dia

	7-10	7-10
312 Zinco Ar (dias)	7-10	7-10
10 Zinco Ar (dias)	4-7	4-7

### Estímulo para terapia do zumbido

	87
Saída máx RMS (dB NPS)	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87

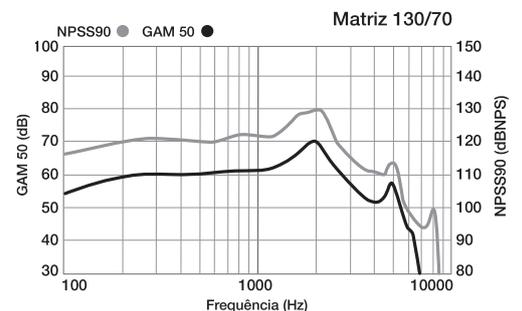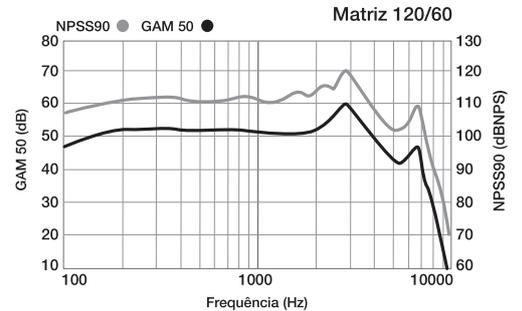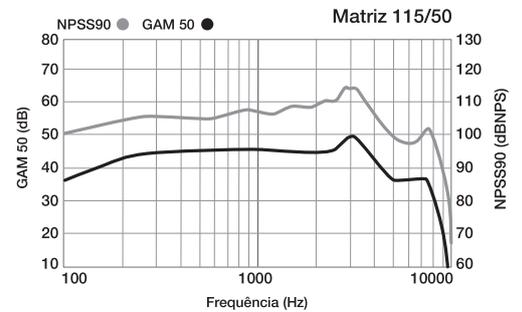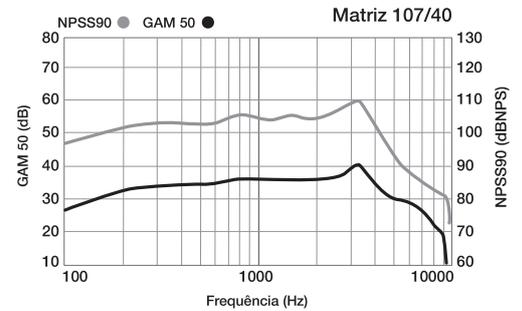

\*Consulte disponibilidade de cores.

# BTE 13

Retroauricular

	Savant AI			
<b>Características:</b>	AI 1000			
Plataforma: Thrive	●			
Aplicativo: Thrive	●			
Aplicativo: Thrive Care	●			
Canais   Bandas	10			
Largura de banda	8 kHz			
4 Programas de conforto	●			
Rebaixamento de frequência	●			
Cancelamento de feedback	●			
Sistema CROS	●			
Modo Edge: Controle por toque				
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive				
Compatibilidade OrCam				
Voice AI*				
REM Medida de Orelha Real	●			
<b>Healthables:</b>				
Monitoramento de atividade	●			
Monitoramento de engajamento				
Alerta de queda	●			
<b>Sistema de telessaúde:</b>				
TeleHear	●			
<b>Gerenciador de som:</b>				
Melhoria de fala espacial				
<i>Fala em ruído</i>	1	2	3	4
<i>Máquina</i>	1	2	3	4
<i>Vento</i>	1	2	3	4
<i>Silêncio</i>	1	2	3	4
<i>Transientes</i>	1	2	3	4
<b>Assistentes pessoais:</b>				
Assistente Thrive c/ comando de voz				
Tradução**				
Transcrição				
Autoverificação	●			
Controle por toque	●			
Auto On/Off	●			
Lembretes	●			
Mãos livres*	●			
Encontre meu celular				
<b>Tecnologia de telefone:</b>				
Telefone orelha-a-orelha				
<b>Melhoria de música:</b>				
Memória de música				
<b>Direcionalidade:</b>				
Adaptativo				
Dinâmico	●			
Omnidirecional	●			
Direcional	●			
<b>Tecnologia de zumbido:</b>				
Zumbido Multiflex	●			
Zumbido Multiflex Pro				
<b>Compatibilidade com acessórios:</b>				
Acessórios 2.4 GHz	●			

\*Disponível somente para sistemas iOS.  
 \*\*Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Savant AI




# BTE 13

Retroauricular

Faixa de adaptação

● BTE 13 70

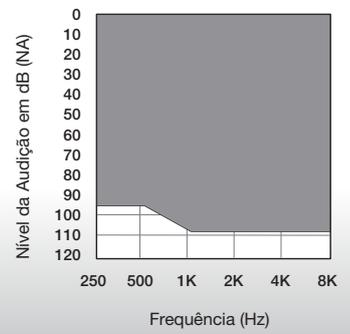

Tecnologias disponíveis

Savant AI 1000

## Guia de cores\*\*

Cores padrão



Branco brilhante com prata   Preto   Ardósia   Prata   Espresso   Bronze   Champanhe

## Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

## Recursos para o paciente

- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS\*\*\*

## Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	Gancho		Tamanho 3, Ocluído Tubo fino		Matriz: 130/70 Tamanho da bateria: 13
--	--------	--	---------------------------------	--	--

### Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	130	136	124	129
MAF NPSS90 (dB NPS)	122	N/A	112	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	134	N/A	114
Pico de ganho (dB)	70	76	68	73
MAF GAM (dB)	62	N/A	57	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	73	N/A	61
<b>Faixa de frequência (Hz)</b>	<100-7600	<100-7600	<100-4600	<100-6800
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	45	59	35	39
Entrada de ruído equivalente (dB)	24	18	29	29

### Distorção harmônica

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

### Sensibilidade da bobina de indução



	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	101	N/A	91	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	88	N/A
SEBI	0	N/A	1	N/A
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*

### Vida da bateria estimada em 16hs/dia

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
13 Zinco Ar (dias)	7-11*	7-11*	7-11*	7-11*

### Estímulo para terapia do zumbido

Saída máx RMS (dB NPS)	87	87
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87	87
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87	87

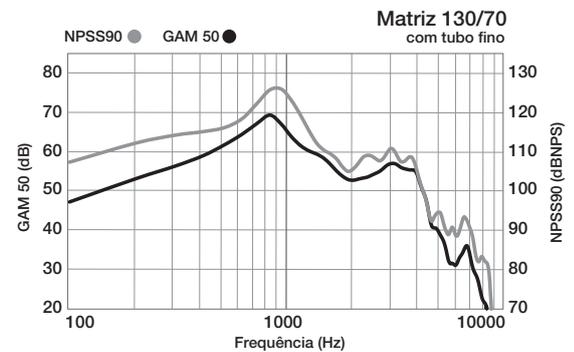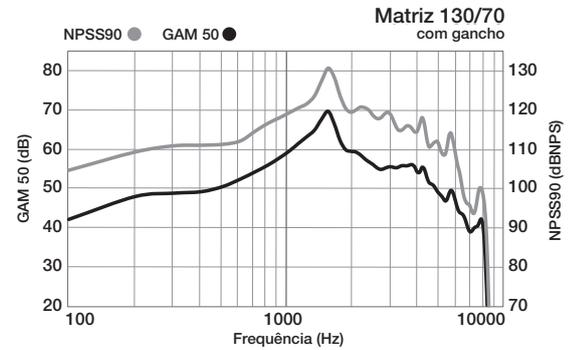

\*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

\*\*Consulte disponibilidade de cores.

\*\*\*Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

# BTE 13 PP

Retroauricular

NUEAR

	Savant AI
<b>Características:</b>	AI 1000
Plataforma: Thrive	●
Aplicativo: Thrive	●
Aplicativo: Thrive Care	●
Canais   Bandas	10
Largura de banda	8 kHz
4 Programas de conforto	●
Rebaixamento de frequência	●
Cancelamento de feedback	●
Modo Edge: Controle por toque	
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	
Compatibilidade OrCam	
Voice AI*	
REM Medida de Orelha Real	●
<b>Healthables:</b>	
Monitoramento de atividade	●
Monitoramento de engajamento	
Alerta de queda	●
<b>Sistema de telessaúde:</b>	
TeleHear	●
<b>Gerenciador de som:</b>	
Melhoria de fala espacial	
<i>Fala em ruído</i>	1 2 3 4
<i>Máquina</i>	1 2 3 4
<i>Vento</i>	1 2 3 4
<i>Silêncio</i>	1 2 3 4
<i>Transientes</i>	1 2 3 4
<b>Assistentes pessoais:</b>	
Assistente Thrive c/ comando de voz	
Tradução**	
Transcrição	
Autoverificação	●
Controle por toque	●
Auto On/Off	●
Lembretes	●
Mãos livres*	●
Encontre meu celular	
<b>Tecnologia de telefone:</b>	
Telefone orelha-a-orelha	
<b>Melhoria de música:</b>	
Memória de música	
<b>Direcionalidade:</b>	
Adaptativo	
Dinâmico	●
Omnidirecional	●
Direcional	●
<b>Tecnologia de zumbido:</b>	
Zumbido Multiflex	●
Zumbido Multiflex Pro	
<b>Compatibilidade com acessórios:</b>	
Acessórios 2.4 GHz	●

\*Disponível somente para sistemas iOS.  
\*\*Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Savant AI




# BTE 13 PP

## Retroauricular

Faixa de adaptação

● BTE 13 80

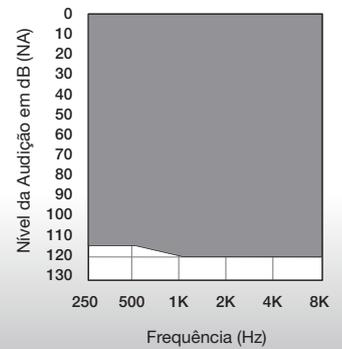

Tecnologias disponíveis

Savant AI 1000

### Guia de cores\*\*

Cores padrão



Branco brilhante com prata   Preto   Ardósia   Prata   Espresso   Bronze   Champanhe

### Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

### Recursos para o paciente



- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio

### Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	Gancho		Tamanho 3, Ocluído Tubo fino	
	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
<b>Medidas</b>				
Pico NPSS90 (dB NPS)	140	147	133	139
MAF NPSS90 (dB NPS)	133	N/A	119	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	141	N/A	128
Pico de ganho (dB)	80	86	78	84
MAF GAM (dB)	73	N/A	60	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	81	N/A	70
<b>Faixa de frequência (Hz)</b>				
Freq. no teste de referência (kHz)	<100-5200	<100-6400	<100-5200	<100-7000
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	54	64	44	52
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	37	34
<b>Distorção harmônica</b>				
500 Hz (%)	<5	<5	<1	<1
800 Hz (%)	<2	<1	<1	<2
1600 Hz (%)	<1	<1	<2	<3
3200 Hz (%)	<1	<1	<2	<2
<b>Sensibilidade da bobina de indução</b>				
MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	110	N/A	98	N/A
SSRET	-4	N/A	-6	N/A
MFA-NPSIV	110	N/A	100	N/A
SEBI	-4	N/A	-4	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	80	N/A
<b>ANSI/IEC</b>				
Corrente da bateria (mA)	2.9*	2.4*	2.9*	2.4*
Corrente em repouso (mA)	2.0*	2.0*	2.0*	2.0*
<b>Vida da bateria estimada em 16hs/dia</b>				
13 Zinco Ar (dias)	6-9*	7-10*	6-9*	7-10*
<b>Estímulo para Terapia do Zumbido</b>				
Saída máx RMS (dB NPS)	92		92	
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	92		92	
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	92		92	

**Matriz: 140/80**  
Tamanho da bateria: 13

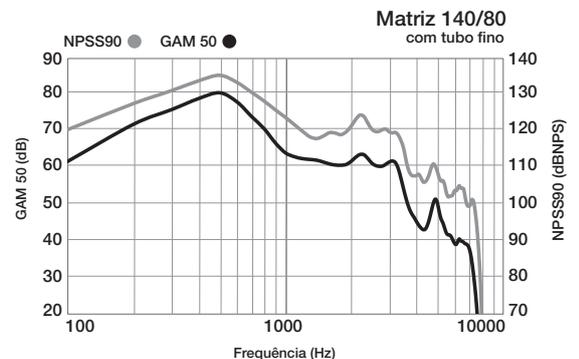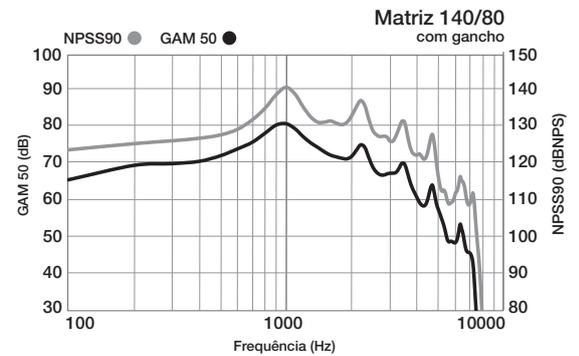

\*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

\*\*Consulte disponibilidade de cores.

# RIC 312

Receptor no canal

NUEAR

	Savant AI
<b>Características:</b>	AI 1000
Plataforma: Thrive	●
Aplicativo: Thrive	●
Aplicativo: Thrive Care	●
Canais   Bandas	10
Largura de banda	8 kHz
4 Programas de conforto	●
Rebaixamento de frequência	●
Cancelamento de feedback	●
Sistema CROS	●
Modo Edge: Controle por toque	
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	
Compatibilidade OrCam	
Voice AI*	
REM Medida de Orelha Real	●
<b>Healthables:</b>	
Monitoramento de atividade	●
Monitoramento de engajamento	
Alerta de queda	●
<b>Sistema de telessaúde:</b>	
TeleHear	●
<b>Gerenciador de som:</b>	
Melhoria de fala espacial	
<i>Fala em ruído</i>	1 2 3 4
<i>Máquina</i>	1 2 3 4
<i>Vento</i>	1 2 3 4
<i>Silêncio</i>	1 2 3 4
<i>Transientes</i>	1 2 3 4
<b>Assistentes pessoais:</b>	
Assistente Thrive c/ comando de voz	
Tradução**	
Transcrição	
Autoverificação	●
Controle por toque	●
Auto On/Off	●
Lembretes	●
Mãos livres*	●
Encontre meu celular	
<b>Tecnologia de telefone:</b>	
Telefone orelha-a-orelha	
<b>Melhoria de música:</b>	
Memória de música	
<b>Direcionalidade:</b>	
Adaptativo	
Dinâmico	●
Omnidirecional	●
Direcional	●
<b>Tecnologia de zumbido:</b>	
Zumbido Multiflex	●
Zumbido Multiflex Pro	
<b>Compatibilidade com acessórios:</b>	
Acessórios 2.4 GHz	●

\*Disponível somente para sistemas iOS.  
\*\*Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Savant AI




# RIC 312

Receptor no canal

## Faixa de adaptação

- RIC 312 40
- RIC 312 50
- RIC 312 60

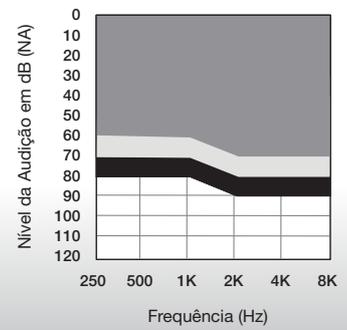

Tecnologias disponíveis

Savant AI 1000

### Guia de cores\*\*

Cores padrão



### Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

### Recursos para o paciente




- Tecnologia de zumbido
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS\*\*\*

### Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	40 de ganho		50 de ganho		60 de ganho		Matrizes: 107/40, 115/50, 120/60	Tamanho da bateria: 312
--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	----------------------------------	-------------------------

Medidas	ANSI/IEC 2cc Acoplador		IEC OES Acoplador		ANSI/IEC 2cc Acoplador		IEC OES Acoplador	
	40	50	40	50	60	40	50	60
Pico NPSS90 (dB NPS)	115	127	115	127	120	131		
MAF NPSS90 (dB NPS)	109	N/A	109	N/A	117	N/A		
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	119	N/A	119	N/A	127		
Pico de ganho (dB)	50	63	50	63	60	71		
MAF GAM (dB)	45	N/A	45	N/A	56	N/A		
Ganho total FTR (dB)	N/A	55	N/A	55	N/A	65		
<b>Faixa de frequência (Hz)</b>	<100-7700	<100-6900	<100-7700	<100-7800	<100-7700	<100-7800		
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	N/A	1.6		
Frequências MAF (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A		
Ganho no teste de referência (dB)	32	44	32	44	40	52		
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	26	26	26	26		
<b>Distorção harmônica</b>								
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3		
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3		
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3		
<b>Sensibilidade da bobina de indução</b>								
MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
NSMA (IEC) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
SEBI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*	2.1*	2.0*		
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*	1.8*	1.9*		
<b>Vida da bateria estimada em 16hs/dia</b>								
312 Zinco Ar (dias)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*		
<b>Estímulo para terapia do zumbido</b>								
Saída máx RMS (dB NPS)	87		87		87			
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87		87		87			
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87		87		87			

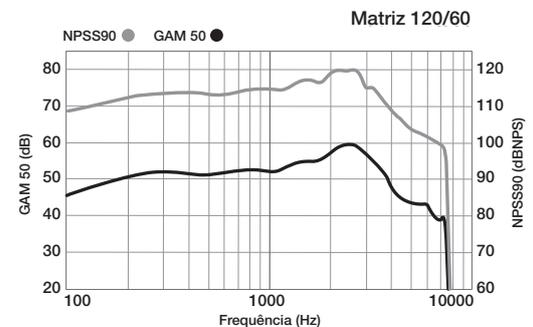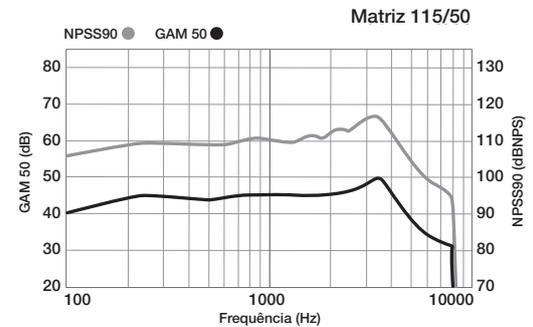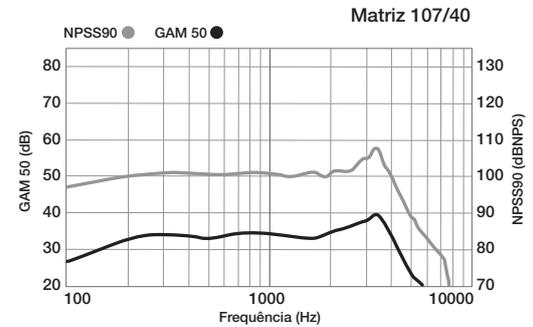

\*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

\*\*Consulte disponibilidade de cores.

\*\*\*Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

# BTE 13

## Retroauricular

	Savant AI			
	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
<b>Características:</b>				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●
Canais   Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
Sistema CROS	●	●	●	●
Modo Edge: Controle por toque	●			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●	
Compatibilidade OrCam	●			
Voice AI*	●			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
<b>Healthables:</b>				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●
Alerta de queda	●	●	●	●
<b>Sistema de telessaúde:</b>				
TeleHear	●	●	●	●
<b>Gerenciador de som:</b>				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
<i>Fala em ruído</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Máquina</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Vento</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Silêncio</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Transientes</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Música automática</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<b>Assistentes pessoais:</b>				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●	
Tradução**	●			
Transcrição	●	●		
Autoverificação	●	●	●	●
Controle por toque	●	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●	●
Lembretes	●	●	●	●
Mãos livres*	●	●	●	●
Encontre meu celular	●	●	●	
<b>Tecnologia de telefone:</b>				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●	
<b>Melhoria de música:</b>				
Memória de música	●	●	●	
<b>Direcionalidade:</b>				
Adaptativo	●	●	●	●
Dinâmico	●	●	●	●
Omnidirecional	●	●	●	●
Direcional	●	●	●	●
<b>Tecnologia de zumbido:</b>				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
<b>Compatibilidade com acessórios:</b>				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●

\*Disponível somente para sistemas iOS.  
 \*\*Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Savant AI




# BTE 13

Retroauricular

Faixa de adaptação

● BTE 13 70

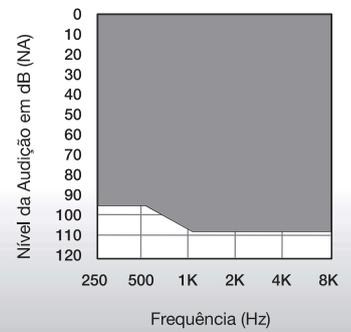

Tecnologias disponíveis

Savant AI 1200

## Guia de cores\*\*

Cores padrão



Branco brilhante com prata Preto Ardósia Prata Espresso Bronze Champanhe

## Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

## Recursos para o paciente

- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS\*\*\*

## Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	Gancho		Tamanho 3, Ocluído Tubo fino		Matriz: 130/70 Tamanho da bateria: 13
--	--------	--	---------------------------------	--	--

### Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	130	136	124	129
MAF NPSS90 (dB NPS)	122	N/A	112	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	134	N/A	114
Pico de ganho (dB)	70	76	68	73
MAF GAM (dB)	62	N/A	57	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	73	N/A	61
<b>Faixa de frequência (Hz)</b>	<100-7600	<100-7600	<100-4600	<100-6800
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	45	59	35	39
Entrada de ruído equivalente (dB)	24	18	29	29

### Distorção harmônica

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

### Sensibilidade da bobina de indução



	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	101	N/A	91	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	88	N/A
SEBI	0	N/A	1	N/A
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*

### Vida da bateria estimada em 16hs/dia

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
13 Zinco Ar (dias)	7-11*	7-11*	7-11*	7-11*

### Estímulo para terapia do zumbido

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Saída máx RMS (dB NPS)	87		87	
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87		87	
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87		87	

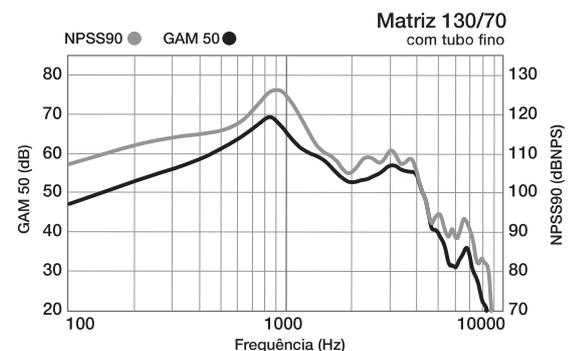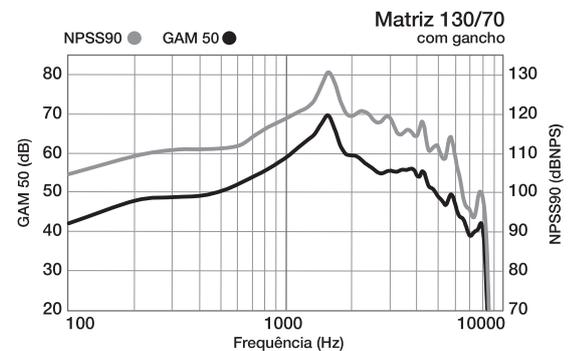

\*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

\*\*Consulte disponibilidade de cores.

\*\*\*Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

# BTE 13 PP

Retroauricular

**NUEAR**

	Savant AI			
	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
<b>Características:</b>				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●
Canais   Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
Modo Edge: Controle por toque	●			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●	
Compatibilidade OrCam	●			
Voice AI*	●			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
<b>Healthables:</b>				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●
Alerta de queda	●	●	●	●
<b>Sistema de telessaúde:</b>				
TeleHear	●	●	●	●
<b>Gerenciador de som:</b>				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
<i>Fala em ruído</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Máquina</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Vento</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Silêncio</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Transientes</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Música automática</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<b>Assistentes pessoais:</b>				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●	
Tradução**	●			
Transcrição	●	●		
Autoverificação	●	●	●	●
Controle por toque	●	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●	●
Lembretes	●	●	●	●
Mãos livres*	●	●	●	●
Encontre meu celular	●	●	●	
<b>Tecnologia de telefone:</b>				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●	
<b>Melhoria de música:</b>				
Memória de música	●	●	●	
<b>Direcionalidade:</b>				
Adaptativo	●	●	●	●
Dinâmico	●	●	●	●
Omnidirecional	●	●	●	●
Direcional	●	●	●	●
<b>Tecnologia de zumbido:</b>				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
<b>Compatibilidade com acessórios:</b>				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●

\*Disponível somente para sistemas iOS.  
 \*\*Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Savant AI




# BTE 13 PP

Retroauricular

Faixa de adaptação

● BTE 13 80

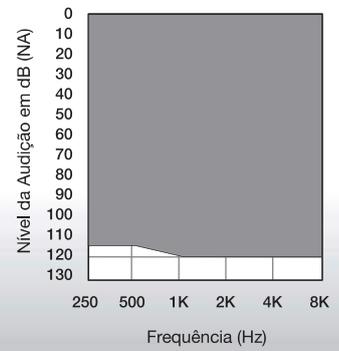

Tecnologias disponíveis

Savant AI 1200

## Guia de cores\*\*

Cores padrão



## Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador



## Recursos para o paciente

- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio

## Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

Medidas	Gancho		Tamanho 3, Ocluído Tubo fino	
	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	140	147	133	139
MAF NPSS90 (dB NPS)	133	N/A	119	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	141	N/A	128
Pico de ganho (dB)	80	86	78	84
MAF GAM (dB)	73	N/A	60	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	81	N/A	70
<b>Faixa de frequência (Hz)</b>	<100-5200	<100-6400	<100-5200	<100-7000
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	54	64	44	52
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	37	34
<b>Distorção harmônica</b>				
500 Hz (%)	<5	<5	<1	<1
800 Hz (%)	<2	<1	<1	<2
1600 Hz (%)	<1	<1	<2	<3
3200 Hz (%)	<1	<1	<2	<2
<b>Sensibilidade da bobina de indução</b>				
MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	110	N/A	98	N/A
SSRET	-4	N/A	-6	N/A
MFA-NPSIV	110	N/A	100	N/A
SEBI	-4	N/A	-4	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	80	N/A
ANSI/IEC				
Corrente da bateria (mA)	2.9*	2.4*	2.9*	2.4*
Corrente em repouso (mA)	2.0*	2.0*	2.0*	2.0*
<b>Vida da bateria estimada em 16hs/dia</b>				
13 Zinco Ar (dias)	6-9*	7-10*	6-9*	7-10*
<b>Estímulo para Terapia do Zumbido</b>				
Saída máx RMS (dB NPS)	92		92	
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	92		92	
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	92		92	

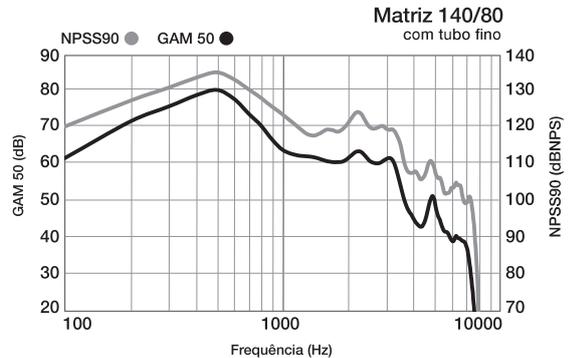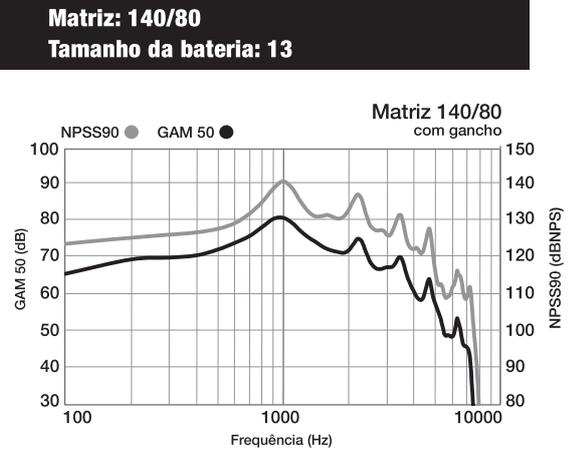

\*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.  
\*\*Consulte disponibilidade de cores.

# RIC 312

## Receptor no canal

**NUEAR**

### Savant AI

	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
<b>Características:</b>				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●
Canais   Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
Sistema CROS	●	●	●	●
Modo Edge: Controle por toque	●			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●	
Compatibilidade OrCam	●			
Voice AI*	●			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
<b>Healthables:</b>				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●
Alerta de queda	●	●	●	●
<b>Sistema de telessaúde:</b>				
TeleHear	●	●	●	●
<b>Gerenciador de som:</b>				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
<i>Fala em ruído</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Máquina</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Vento</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Silêncio</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Transientes</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Música automática</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<b>Assistentes pessoais:</b>				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●	
Tradução**	●			
Transcrição	●	●		
Autoverificação	●	●	●	●
Controle por toque	●	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●	●
Lembretes	●	●	●	●
Mãos livres*	●	●	●	●
Encontre meu celular	●	●	●	
<b>Tecnologia de telefone:</b>				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●	
<b>Melhoria de música:</b>				
Memória de música	●	●	●	
<b>Direcionalidade:</b>				
Adaptativo	●	●	●	●
Dinâmico	●	●	●	●
Omnidirecional	●	●	●	●
Direcional	●	●	●	●
<b>Tecnologia de zumbido:</b>				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
<b>Compatibilidade com acessórios:</b>				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●

\*Disponível somente para sistemas iOS.  
 \*\*Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Savant AI




# RIC 312

Receptor no canal

## Faixa de adaptação

- RIC 312 40
- RIC 312 50
- RIC 312 60

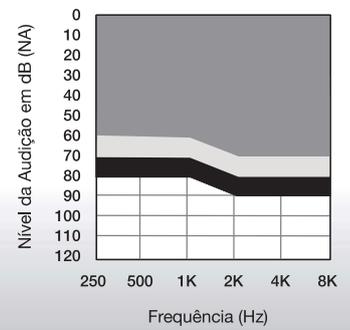

Tecnologias disponíveis

Savant AI 1200

### Guia de cores\*\*

Cores padrão



### Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

### Recursos para o paciente




- Tecnologia de zumbido
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS\*\*\*

### Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	40 de ganho		50 de ganho		60 de ganho		Matrizes: 107/40, 115/50, 120/60	Tamanho da bateria: 312
--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	----------------------------------	-------------------------

Medidas	ANSI/IEC 2cc Acoplador		IEC OES Acoplador		ANSI/IEC 2cc Acoplador		IEC OES Acoplador	
	40	50	40	50	60	40	50	60
Pico NPSS90 (dB NPS)	115	127	115	127	120	131		
MAF NPSS90 (dB NPS)	109	N/A	109	N/A	117	N/A		
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	119	N/A	119	N/A	127		
Pico de ganho (dB)	50	63	50	63	60	71		
MAF GAM (dB)	45	N/A	45	N/A	56	N/A		
Ganho total FTR (dB)	N/A	55	N/A	55	N/A	65		
<b>Faixa de frequência (Hz)</b>	<100-7700	<100-6900	<100-7700	<100-7800	<100-7700	<100-7800		
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	N/A	1.6		
Frequências MAF (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A		
Ganho no teste de referência (dB)	32	44	32	44	40	52		
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	26	26	26	26		
<b>Distorção harmônica</b>								
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3		
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3		
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3		
<b>Sensibilidade da bobina de indução</b>								
MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
NSMA (IEC) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
SEBI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*	2.1*	2.0*		
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*	1.8*	1.9*		
<b>Vida da bateria estimada em 16hs/dia</b>								
312 Zinco Ar (dias)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*		
<b>Estímulo para terapia do zumbido</b>								
Saída máx RMS (dB NPS)	87		87		87			
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87		87		87			
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87		87		87			

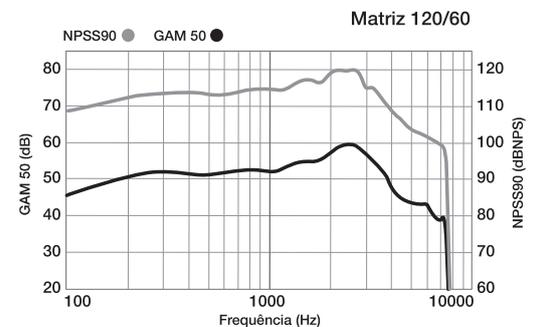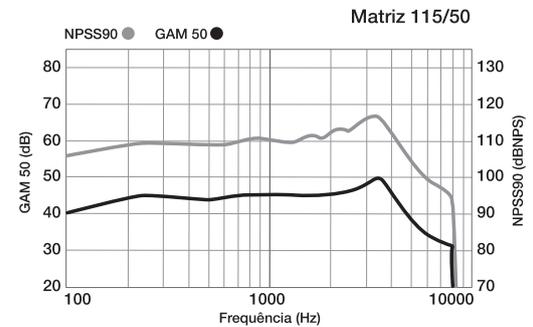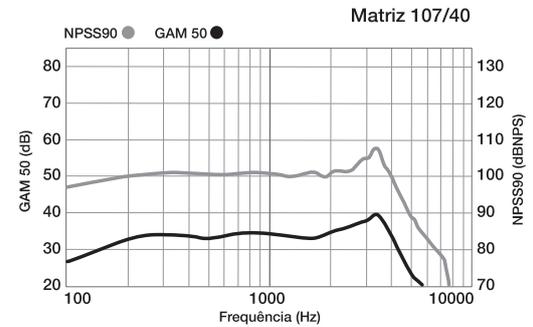

\*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

\*\*Consulte disponibilidade de cores.

\*\*\*Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

# BTE 13

## Retroauricular

	Savant AI			
	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
<b>Características:</b>				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●
Canais   Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
Sistema CROS	●	●	●	●
Modo Edge: Controle por toque	●			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●	
Compatibilidade OrCam	●			
Voice AI*	●			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
<b>Healthables:</b>				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●
Alerta de queda	●	●	●	●
<b>Sistema de telessaúde:</b>				
TeleHear	●	●	●	●
<b>Gerenciador de som:</b>				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
<i>Fala em ruído</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Máquina</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Vento</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Silêncio</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Transientes</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Música automática</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<b>Assistentes pessoais:</b>				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●	
Tradução**	●			
Transcrição	●	●		
Autoverificação	●	●	●	●
Controle por toque	●	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●	●
Lembretes	●	●	●	●
Mãos livres*	●	●	●	●
Encontre meu celular	●	●	●	
<b>Tecnologia de telefone:</b>				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●	
<b>Melhoria de música:</b>				
Memória de música	●	●	●	
<b>Direcionalidade:</b>				
Adaptativo	●	●	●	●
Dinâmico	●	●	●	●
Omnidirecional	●	●	●	●
Direcional	●	●	●	●
<b>Tecnologia de zumbido:</b>				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
<b>Compatibilidade com acessórios:</b>				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●

\*Disponível somente para sistemas iOS.  
 \*\*Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Savant AI




# BTE 13

Retroauricular

## Faixa de adaptação

● BTE 13 70

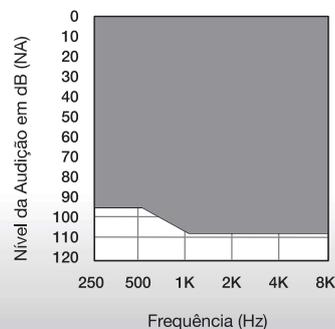

Tecnologias disponíveis

Savant AI 2400 | 2000 | 1600

### Guia de cores\*\*

Cores padrão



Branco brilhante com prata Preto Ardósia Prata Espresso Bronze Champanhe

### Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

### Recursos para o paciente

- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS\*\*\*

### Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	Gancho		Tamanho 3, Ocluído Tubo fino		Matriz: 130/70 Tamanho da bateria: 13
--	--------	--	---------------------------------	--	--

### Medidas

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Pico NPSS90 (dB NPS)	130	136	124	129
MAF NPSS90 (dB NPS)	122	N/A	112	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	134	N/A	114
Pico de ganho (dB)	70	76	68	73
MAF GAM (dB)	62	N/A	57	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	73	N/A	61
<b>Faixa de frequência (Hz)</b>	<100-7600	<100-7800	<100-4600	<100-6800
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	45	59	35	39
Entrada de ruído equivalente (dB)	24	18	29	29

### Distorção harmônica

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

### Sensibilidade da bobina de indução



	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	101	N/A	91	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	88	N/A
SEBI	0	N/A	1	N/A
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*

### Vida da bateria estimada em 16hs/dia

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
13 Zinco Ar (dias)	7-11*	7-11*	7-11*	7-11*

### Estímulo para terapia do zumbido

	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
Saída máx RMS (dB NPS)	87		87	
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87		87	
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87		87	

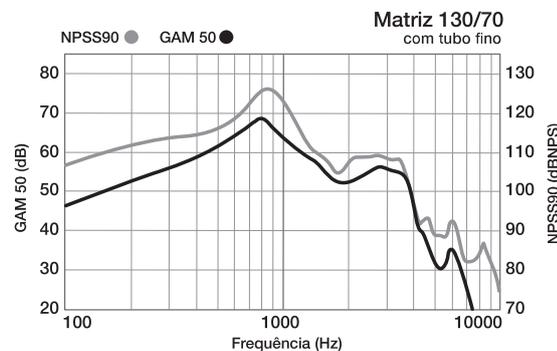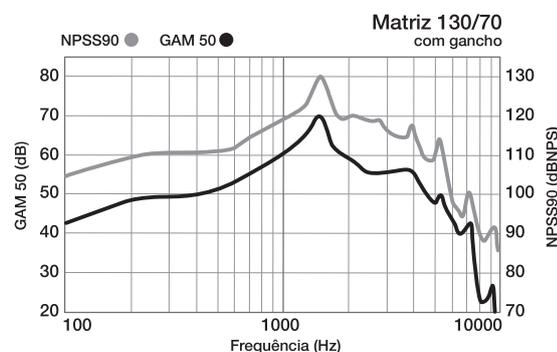

\*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

\*\*Consulte disponibilidade de cores.

\*\*\*Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.

# BTE 13 PP

Retroauricular

**NUEAR**

	Savant AI			
	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
<b>Características:</b>				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●
Canais   Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
Modo Edge: Controle por toque	●			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●	
Compatibilidade OrCam	●			
Voice AI*	●			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
<b>Healthables:</b>				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●
Alerta de queda	●	●	●	●
<b>Sistema de telessaúde:</b>				
TeleHear	●	●	●	●
<b>Gerenciador de som:</b>				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
<i>Fala em ruído</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Máquina</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Vento</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Silêncio</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Transientes</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Música automática</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<b>Assistentes pessoais:</b>				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●	
Tradução**	●			
Transcrição	●	●		
Autoverificação	●	●	●	●
Controle por toque	●	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●	●
Lembretes	●	●	●	●
Mãos livres*	●	●	●	●
Encontre meu celular	●	●	●	
<b>Tecnologia de telefone:</b>				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●	
<b>Melhoria de música:</b>				
Memória de música	●	●	●	
<b>Direcionalidade:</b>				
Adaptativo	●	●	●	●
Dinâmico	●	●	●	●
Omnidirecional	●	●	●	●
Direcional	●	●	●	●
<b>Tecnologia de zumbido:</b>				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
<b>Compatibilidade com acessórios:</b>				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●

\*Disponível somente para sistemas iOS.  
 \*\*Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Savant AI




# BTE 13 PP

Retroauricular

Faixa de adaptação

● BTE 13 80

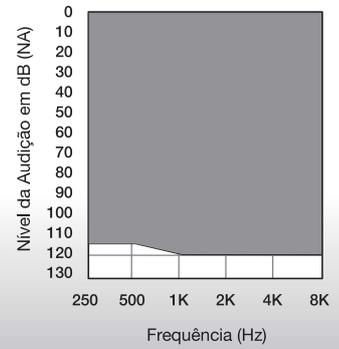

Tecnologias disponíveis

Savant AI 2400 | 2000 | 1600

## Guia de cores\*\*

Cores padrão



## Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador



## Recursos para o paciente

- Tecnologia de zumbido
- Bobina telefônica
- Conectividade sem fio

## Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	Gancho		Tamanho 3, Ocluído Tubo fino	
	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador	ANSI/IEC 2cc Acoplador	IEC OES Acoplador
<b>Medidas</b>				
Pico NPSS90 (dB NPS)	140	147	133	139
MAF NPSS90 (dB NPS)	133	N/A	119	N/A
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	141	N/A	128
Pico de ganho (dB)	80	86	78	84
MAF GAM (dB)	73	N/A	60	N/A
Ganho total FTR (dB)	N/A	81	N/A	70
<b>Faixa de frequência (Hz)</b>	<100-5200	<100-6400	<100-5200	<100-7000
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
Frequências MAF (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A
Ganho no teste de referência (dB)	54	64	44	52
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	37	34
<b>Distorção harmônica</b>				
500 Hz (%)	<5	<5	<1	<1
800 Hz (%)	<2	<1	<1	<2
1600 Hz (%)	<1	<1	<2	<3
3200 Hz (%)	<1	<1	<2	<2
<b>Sensibilidade da bobina de indução</b>				
MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	110	N/A	98	N/A
SSRET	-4	N/A	-6	N/A
MFA-NPSIV	110	N/A	100	N/A
SEBI	-4	N/A	-4	N/A
NSMA (IEC) (dB NPS)	92	N/A	80	N/A
ANSI/IEC				
Corrente da bateria (mA)	2.9*	2.4*	2.9*	2.4*
Corrente em repouso (mA)	2.0*	2.0*	2.0*	2.0*
<b>Vida da bateria estimada em 16hs/dia</b>				
13 Zinco Ar (dias)	6-9*	7-10*	6-9*	7-10*
<b>Estímulo para Terapia do Zumbido</b>				
Saída máx RMS (dB NPS)	92		92	
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	92		92	
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	92		92	

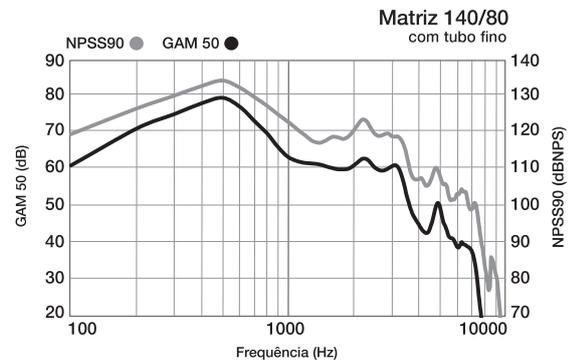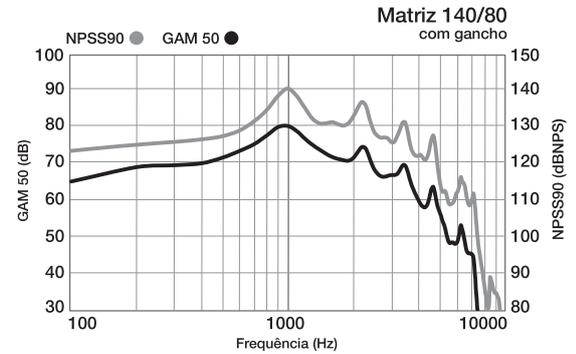

\*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

\*\*Consulte disponibilidade de cores.

# RIC 312

Receptor no canal

	Savant AI			
	Premium AI 2400	Avançado AI 2000	Intermediário AI 1600	Básico AI 1200
<b>Características:</b>				
Plataforma: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive	●	●	●	●
Aplicativo: Thrive Care	●	●	●	●
Canais   Bandas	24	20	16	12
Largura de banda	10 kHz	10 kHz	10 kHz	8 kHz
4 Programas de conforto	●	●	●	●
Rebaixamento de frequência	●	●	●	●
Cancelamento de feedback	●	●	●	●
Sistema CROS	●	●	●	●
Modo Edge: Controle por toque	●			
Modo Edge: Acesso pelo aplicativo Thrive	●	●	●	
Compatibilidade OrCam	●			
Voice AI*	●			
REM Medida de Orelha Real	●	●	●	●
<b>Healthables:</b>				
Monitoramento de atividade	●	●	●	●
Monitoramento de engajamento	●	●	●	●
Alerta de queda	●	●	●	●
<b>Sistema de telessaúde:</b>				
TeleHear	●	●	●	●
<b>Gerenciador de som:</b>				
Melhoria de fala espacial	●	●	●	
<i>Fala em ruído</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Máquina</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Vento</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Silêncio</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Transientes</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<i>Música automática</i>	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
<b>Assistentes pessoais:</b>				
Assistente Thrive c/ comando de voz	●	●	●	
Tradução**	●			
Transcrição	●	●		
Autoverificação	●	●	●	●
Controle por toque	●	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●	●
Lembretes	●	●	●	●
Mãos livres*	●	●	●	●
Encontre meu celular	●	●	●	
<b>Tecnologia de telefone:</b>				
Telefone orelha-a-orelha	●	●	●	
<b>Melhoria de música:</b>				
Memória de música	●	●	●	
<b>Direcionalidade:</b>				
Adaptativo	●	●	●	●
Dinâmico	●	●	●	●
Omnidirecional	●	●	●	●
Direcional	●	●	●	●
<b>Tecnologia de zumbido:</b>				
Zumbido Multiflex	●	●	●	●
Zumbido Multiflex Pro	●			
<b>Compatibilidade com acessórios:</b>				
Acessórios 2.4 GHz	●	●	●	●

\*Disponível somente para sistemas iOS.  
 \*\*Para sistemas Android é necessário um Acessório de conectividade.

Savant AI




# RIC 312

Receptor no canal

## Faixa de adaptação

- RIC 312 40
- RIC 312 50
- RIC 312 60

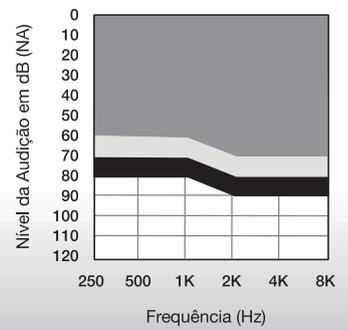

Tecnologias disponíveis

Savant AI 2400 | 2000 | 1600

### Guia de cores\*\*

Cores padrão



### Compatibilidade com acessórios 2.4 GHz

- Controle remoto
- Microfone de mesa
- Programador

### Recursos para o paciente




- Tecnologia de zumbido
- Conectividade sem fio
- Sistema CROS\*\*\*

### Tecnologia Savant AI

- Tecnologia auditiva Healthable com sensores integrados e inteligência artificial

	40 de ganho		50 de ganho		60 de ganho		Matrizes: 107/40, 115/50, 120/60	Tamanho da bateria: 312
--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	----------------------------------	-------------------------

Medidas	ANSI/IEC 2cc Acoplador		IEC OES Acoplador		ANSI/IEC 2cc Acoplador		IEC OES Acoplador	
	40	50	40	50	60	40	50	60
Pico NPSS90 (dB NPS)	115	127	115	127	120	131		
MAF NPSS90 (dB NPS)	109	N/A	109	N/A	117	N/A		
FTR NPSS90 (dB NPS)	N/A	119	N/A	119	N/A	127		
Pico de ganho (dB)	50	63	50	63	60	71		
MAF GAM (dB)	45	N/A	45	N/A	56	N/A		
Ganho total FTR (dB)	N/A	55	N/A	55	N/A	65		
<b>Faixa de frequência (Hz)</b>	<100-9600	<100-9600	<100-9600	<100-9600	<100-9200	<100-9600		
Freq. no teste de referência (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	N/A	1.6		
Frequências MAF (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A		
Ganho no teste de referência (dB)	32	44	32	44	40	52		
Entrada de ruído equivalente (dB)	26	26	26	26	26	26		
<b>Distorção harmônica</b>								
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3		
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3		
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3		
<b>Sensibilidade da bobina de indução</b>								
MAF NPSSIT (ANSI) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
NSMA (IEC) (dB NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
SEBI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
ANSI/IEC Corrente da bateria (mA)	1.9*	1.8*	1.9*	1.8*	2.1*	2.0*		
Corrente em repouso (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*	1.8*	1.9*		
<b>Vida da bateria estimada em 16hs/dia</b>								
312 Zinco Ar (dias)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*		
<b>Estímulo para terapia do zumbido</b>								
Saída máx RMS (dB NPS)	87		87		87			
Nível da saída máx RMS medido (dB NPS)	87		87		87			
Saída máx de 1/3 da oitava (dB NPS)	87		87		87			

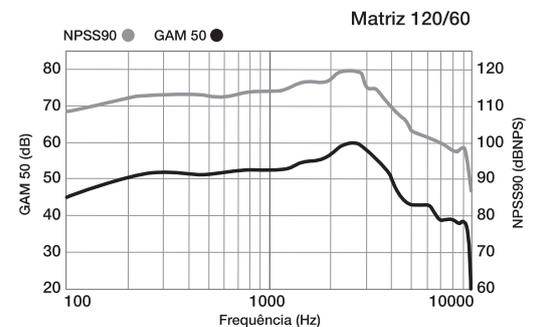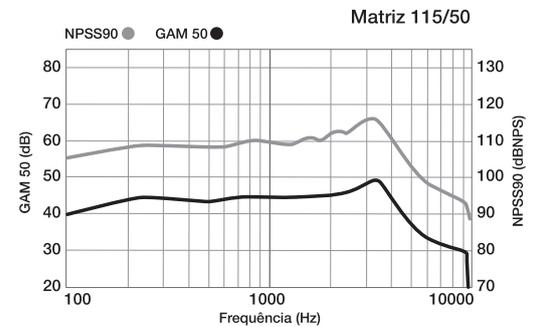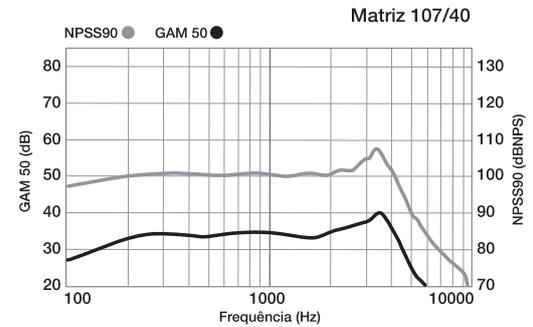

\*Os resultados variam de acordo com o uso sem fio.

\*\*Consulte disponibilidade de cores.

\*\*\*Disponível apenas para os modelos BTE 13, RIC 312 e RIC R.



# Sistema CROS

RIC R, RIC 312 & BTE 13

O sistema NuEar CROS inclui produtos especificamente projetados para pacientes que precisam de som direcionado para uma orelha com melhor audição. A solução CROS da NuEar transmite o som sem fio de um microfone colocado na orelha não funcional do paciente para um receptor instalado na orelha com melhor audição do paciente. Os dispositivos também podem ser configurados como uma solução BiCROS para um paciente que precisa de amplificação em sua orelha com melhor audição.

Savant AI 2400 | 2000 | 1600 | 1200

## Características Especiais

- Transmissão sem fio clara e consistente usando 2.4 GHz + tecnologia NFMI
- Sistema Operacional Preciso 2 traz audibilidade e compreensão da fala para pacientes em qualquer ambiente
- Direcionalidade de Imersão Precisa no transmissor CROS
- Padrão com bobina telefônica nos receptores Savant AI
- Compatível com os acessórios sem fio 2.4 GHz

## Informação de Rádio

Tipo de antena:	Bobina envolta sobre núcleo de ferrite
Frequência de operação:	10.281 MHz NFMI
Largura de banda ocupada (99% BW):	400 kHz
Modulação:	8 DPSK
Frequência de alcance:	30 cm
Opções de uso:	Receptor no Canal e Retroauricular
Exemplo de utilização:	Transmissão de sinal de áudio para o aparelho auditivo da outra orelha

## Informação Geral

Condições de transporte e armazenamento para Produtos Zinco Ar:

40°C (-40°F) a + 60°C (140°F) e 10% -95% rH. Seus aparelhos auditivos são projetados para operar além da faixa de temperatura confortável para você, de muito frio até 50°C (122°F).

Condições de transporte e armazenamento para o RIC R:

Seus aparelhos auditivos e carregador devem ser armazenados dentro das faixas de temperatura e umidade de -10°C (14°F) a + 45°C (113°F) e 10% -95% rH. A faixa de temperatura de carregamento está entre 0°C e 40°C. Seus aparelhos auditivos são projetados para operar além da faixa de temperatura confortável para você, de muito frio até 40°C (104°F). Na temperatura operacional máxima de 40°C (104°F), a temperatura da caixa do aparelho auditivo pode atingir 42°C (108°F).

Padrões de Segurança:

Atende à norma de segurança IEC 60601-2-66 e ao padrão EMC IEC 60601-1-2.

## Compatibilidade

Savant AI RIC R CROS é compatível com Savant AI RIC R

Savant AI RIC 312 CROS é compatível com Savant AI RIC 312

Savant AI BTE 13 CROS é compatível com Savant AI BTE 13

## Informação da Bateria

Modelo	Tamanho da Bateria	Código IEC	Código ANSI	Duração da Bateria
Savant AI RIC R CROS	N/A	N/A	N/A	14h
Savant AI RIC 312 CROS	312	PR41	7002ZD	3 a 5 dias*
Savant AI BTE 13 CROS	13	PR48	7002ZD	4 a 6 dias

\*Estimativas para um receptor de 50dB

## Informação de Áudio

Qualidade de Áudio: 20 kHz frequência de amostragem

## Padrões Aplicados

USA	Canada
RIC 312 FCC ID: EOA-24CIRCA312	RIC 312 IC: 6903A-24CIRCAR312
RIC R FCC ID: EOA-24CIRCARCHG	RIC R IC: 6903A-24CIRCACHG
BTE 13 FCC ID: EOA-24CIRCAB13	BTE 13 IC: 6903A-24CIRCAB13